

INTERNATIONALE HAARMEDIZIN

Katalog für Haartransplantation und medizinische Ästhetik



INTERNATIONAL HAIR MEDICAL

www.internationalhairmedical.com

Since 2020

*Mit unserem breiten Servicenetzwerk auf der
ganzen Welt bieten wir schnellen und
zuverlässigen Service*

GSM-Tel. (+90) 539 662 8924 / (+90) 533 894 8843

Mailen Sie info@internationalhairmedical.com

ihm@internationalhairmedical.com Webadresse

www.internationalhairmedical.com Adresse: Beylikdüzü,

Istanbul. Vp. 34528





Internationale Haarmedizin

UNSER UNTERNEHMEN

Als Blackandgold Medikal Health Group beliefern wir unsere geschätzten Kunden mit unserem professionellen Personal mit vielen medizinischen Produkten, insbesondere Haartransplantation und Dermokosmetik, mit Qualität/schnellen und erschwinglichen Preisen.

Ziel ist die Spezialisierung auf Vertrieb, Marketing und technischen Service auf dem Markt, in dem das Unternehmen vertreten ist.

Dank seiner Zuverlässigkeit, Erfahrung, seinem technischen Wissensstand und seinem Kundendienst ist es ihm gelungen, zum bevorzugten Unternehmen zu werden.

CE-ZERTIFIKAT / EG-ZERTIFIKAT / MARKENPATENT - ISO - TSE-KONFORMITÄT SZERTIFIKATE SIND ERHÄLTICH

Unsere Institution; Es ist für die Herstellung und den Verkauf von Haartransplantationsmaterialien und medizinisch-ästhetischen Produkten autorisiert und zugelassen.

Unsere Einrichtung und unsere Mitarbeiter verfügen über Vertriebs- und Niederlassungsberechtigungs nachweise.

Alle von uns verkauften Produkte sind UTS-registriert.

Mit den relevanten Dokumenten und notwendigen Meldungen arbeitet unsere Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem Produktverfolgungssystem und den relevanten Richtlinien des Gesundheitsministeriums im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit und Produktsicherheit.

Jedes Produkt, das Sie von der Black and Gold Medikal Health Group kaufen, wird einer Qualitätsprüfung unterzogen, Genehmigungs- und Genehmigungsdokumente werden eingeholt, notwendige Benachrichtigungen werden vorgenommen und Ihnen, unseren geschätzten Benutzern, dann zur Freude und Nutzung angeboten.

100 % der von uns verwendeten medizinisch-chirurgischen Instrumente werden aus medizinischem Stahl hergestellt. Die Richtigkeit wird durch unsere beigefügten Unterlagen bestätigt.

UNSERE VISION

Durch die Entwicklung hochwertiger, innovativer und unterschiedlicher Produkte für die GESUNDHEIT, die für uns alle der wichtigste Interessenvertreter ist, bieten wir einen Serviceansatz für die Umwelt und die Gesellschaft, insbesondere für Sie, unsere geschätzten Benutzer, ohne Grenzen.

UNSERE AUFGABE

Unser Ziel ist es, unsere Arbeit als zuverlässigstes Unternehmen der Welt fortzusetzen, indem wir die Innovationen und Technologien der Branche im Bereich Haartransplantation und medizinische Ästhetik ständig verfolgen und zu unserer Lösung benutzerorientierte, umweltfreundliche Produkte von höchster Qualität anbieten -orientierte Kunden.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 13485:2016

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 13485:2016 Medikal Kalite Yönetim Sistemi gerektiren yönetim gereklilikleri için
AQC tarafından onaylanmıştır.
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 13485:2016 and
it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014520

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.



INTERNATIONAL HAIR MEDICAL
www.internationalhairmedical.com

Since 2020



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 9001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 9001:2015 standardına gereklilikleri yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 9001:2015 and
it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014521

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

ATTESTATIONS OF CONFORMITY
certifies that the company



SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

has been verified and recognized as
manufacturer of

**800watt Hair Transplantation Training Set, Graft Shocking Laser Set,
Hair Line Laser, Needle Free Anesthesia Device, Pore Punch Separator or Straight,
Implantation Forceps, Extraction Forceps, Graft Impactor Pen, Fine Micro Motor,
Hair Analyzer Camera Microscope, Slide Handle, Hair Blade, Hair Transplantation
Chair, Loop Sizer, Sterilizer Forceps, Scissor, Hair Drip Box Set, Operation
LED Lamp, Hair Transplant Dressing Cream Set, Graft Tissue Transfer Barum**

according to the rules of
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and
of the Council of 5 April 2017 on medical devices

Certificate-no: 014522

The range of validity and details of the inspection can be taken from our
Report no. CP-301023

CE marking can be affixed on the product after the preparation of the necessary technical
documentation and the conformity declaration as well as the production control guaranteed
by the manufacturer and the provision of the other directive fulfilled if any

First Registration Date : 30.10.2023 Expiry Date : 30.10.2024
Certificate Date : 30.10.2023 Period of Registration : 3 years



Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 45001:2018

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 45001:2018 standardına gereklilikleri yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 45001:2018 and
it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014518

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan Çevre yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 14001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 14001:2015 standardına gereklilikleri yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 14001:2015 and
it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014519

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.





Internationale Haarmedizin

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR BLADE

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 12235

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : GRAFT SHOOKING LASER SET

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 3485

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : DIE IMPLANTER PEN

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : V022 2582

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE PUNCH(SERRATED OR STRAIGHT)

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35289

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR TRANSPLANTATION CHAIR

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 38447

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : LOOP EYES

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : V022 44400

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE MICRO MOTOR

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 43915

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : EXTRACTION FORCEPS

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35798

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATIRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR ANALYSER CAMERA MICROSCOP

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Karar 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35798

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORMITY ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / APPLIED STANDARDS : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

Internationale Haarmedizin

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NAİL DRILL BOX SET
GÖKİN SINIFI / (GİRİŞ SINIFI) : SINIF I (Ek 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 3509S

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişimisi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/BAŞLANGIÇ YERİ, EN ISO 14155:2020
START OF CE MARKING : 30.10.2023
DATE (İNGİZLANDIĞI YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE) : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NEEDLE FREE ANESTHESIA DEVICE
GÖKİN SINIFI / (GİRİŞ SINIFI) : SINIF I (Ek 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 11500

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişimisi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR
EN ISO 14971:2019, EN 11135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/BAŞLANGIÇ YERİ, EN ISO 14155:2020
START OF CE MARKING : 30.10.2023
DATE (İNGİZLANDIĞI YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE) : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NAİL DRILL BOX SET
GÖKİN SINIFI / (GİRİŞ SINIFI) : SINIF I (Ek 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 3509S

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişimisi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/BAŞLANGIÇ YERİ, EN ISO 14155:2020
START OF CE MARKING : 30.10.2023
DATE (İNGİZLANDIĞI YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE) : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE PUNCH/SERRATED OR STRAIGHT
GÖKİN SINIFI / (GİRİŞ SINIFI) : SINIF I (Ek 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35289

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişimisi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/BAŞLANGIÇ YERİ, EN ISO 14155:2020
START OF CE MARKING : 30.10.2023
DATE (İNGİZLANDIĞI YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE) : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR TRANSPLANTATION CHAIR
GÖKİN SINIFI / (GİRİŞ SINIFI) : SINIF I (Ek 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 38447

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişimisi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/BAŞLANGIÇ YERİ, EN ISO 14155:2020
START OF CE MARKING : 30.10.2023
DATE (İNGİZLANDIĞI YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE) : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : LOOP EYES
GÖKİN SINIFI / (GİRİŞ SINIFI) : SINIF I (Ek 8 Karar 1'e göre)
ÜRÜN SINIFI / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : Y022 44480

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : _____

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemin girişimisi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR
EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/BAŞLANGIÇ YERİ, EN ISO 14155:2020
START OF CE MARKING : 30.10.2023
DATE (İNGİZLANDIĞI YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE) : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

Registration Certificate
ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA
ATTESTATIONS OF CONFORMITY
certifies that the company
SATURIN MEDICAL
has been verified and recognized as manufacturer of
SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.
This certificate has been awarded to the company
Uygulanmakta olan yemin sistemini
To certify that the implemented management system complies with
ISO 13485:2016
Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla bu aşağıdaki kapsama verilmektedir.
For the activities described below
HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND COSMETICS PRODUCTS
Bu belge, firma ISO 13485:2016 standardına göre değerlendirilmiştir ve uygun olduğu beyan edilmiştir.
(This certificate is valid only as long as the equipment is in compliance with ISO 13485:2016 and placed in compliance with it.)
Sertifika No (Certificate No): 014522
The range of validity and details of the inspection can be taken from our Register, CP: 241123
CE marking can be affixed on the product after the presentation of the necessary technical documentation and the conformity declaration as well as the production control guarantee. By the manufacturer and the presence of the other directive fulfilled if any.
Date Register/Date of Issue: 30.10.2023 / 30.10.2023
Date of Registration: 30.10.2023 / 30.10.2023
Executive Manager


Registration Certificate
ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA
Bu belge, firma ISO 14001:2015 standardına göre değerlendirilmiştir ve uygun olduğu beyan edilmiştir.
(This certificate is valid only as long as the equipment is in compliance with ISO 14001:2015 and placed in compliance with it.)
Sertifika No (Certificate No): 014520
Bu belge, firma ISO 14001:2015 standardına göre değerlendirilmiştir ve uygun olduğu beyan edilmiştir.
(This certificate is valid only as long as the equipment is in compliance with ISO 14001:2015 and placed in compliance with it.)
Sertifika No (Certificate No): 014521
Date Register/Date of Issue: 30.10.2023 / 30.10.2023
Date of Registration: 30.10.2023 / 30.10.2023
Executive Manager

Registration Certificate
ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA
Bu belge, firma ISO 9001:2015 standardına göre değerlendirilmiştir ve uygun olduğu beyan edilmiştir.
(This certificate is valid only as long as the equipment is in compliance with ISO 9001:2015 and placed in compliance with it.)
Sertifika No (Certificate No): 014521
Date Register/Date of Issue: 30.10.2023 / 30.10.2023
Date of Registration: 30.10.2023 / 30.10.2023
Executive Manager

Registration Certificate
ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA
Bu belge, firma ISO 9001:2015 standardına göre değerlendirilmiştir ve uygun olduğu beyan edilmiştir.
(This certificate is valid only as long as the equipment is in compliance with ISO 9001:2015 and placed in compliance with it.)
Sertifika No (Certificate No): 014521
Date Register/Date of Issue: 30.10.2023 / 30.10.2023
Date of Registration: 30.10.2023 / 30.10.2023
Executive Manager

WAR PUNCH MOTORIZE

Düz Fue Motorize Punch



- Es wird erstklassiger deutscher Stahl verwendet.
- Verschiedene Durchmesser- und Längenmaße verfügbar.
- Registriert bei UBB, genehmigt vom Gesundheitsministerium
- Bietet minimalinvasive Chirurgie
- Die besonders scharfe Spitzenstruktur sorgt für die geringste Empfindlichkeit im Gewebe
- Es gewährleistet eine einfache und sanfte Entfernung der Transplantatfollikel



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	D625	D63	D635	D64	D65
0.6-5	D6525	D653	D6535	D654	D655
0.7	D725	D73	D735	D74	D75
0.7,5	D7525	D753	D7535	D754	D755
0.8	D825	D83	D835	D84	D85
0.8,5	D8525	D853	D8535	D854	D855
0.9	D925	D93	D935	D94	D95
0.9,5	D9525	D953	D9535	D954	D955
1	D125	D13	D135	D14	D15
1,1	D1125	D113	D1135	D114	D115
1,2	D1225	D123	D1235	D124	D125
1,3	D1325	D133	D1335	D134	D135



IHM

INTERNATIONAL HAIR MEDICAL



TIRTIKLI / YILDIZ Fue Motorize Punch



- Es wird erstklassiger deutscher Stahl verwendet.
- Erhältlich in 6 gezahnten und 8 gezahnten Modellen
- Blattverzahnung und Sägeverzahnung verfügbar
- Verschiedene Durchmesser- und Längenmaße verfügbar.
- Registriert bei UBB, genehmigt vom Gesundheitsministerium
- Bietet minimalinvasive Chirurgie
- Die besonders scharfe Spitzenstruktur sorgt für die geringste Wundheilungszeit und Gewebeverletzung
- Es gewährleistet eine sichere und präzise Entfernung der T...



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	T625	T63	T635	T64	T65
0.6-5	T6525	T653	T6535	T654	T655
0.7	T725	T73	D735	T74	T75
0.7,5	T7525	T753	T7535	T754	T755
0.8	T825	T83	T835	T84	T85
0.8,5	T8525	T853	T8535	T854	T855
0.9	T925	T93	T935	T94	T95
0.9,5	T9525	T953	T9535	T954	T955
1	T125	T13	T135	T14	T15
1,1	T1125	T113	T1135	T114	T115
1,2	T1225	T123	T1235	T124	T125
1,3	T1325	T133	T1335	T134	T135




XS (Extra-Safe) Fue Punch Motorisiert



- Es wird erstklassiger deutscher Stahl verwendet.
- Es handelt sich um ein Modell mit einer stärker nach außen gebogenen Spitze.
- Verschiedene Durchmesser- und Längenmaße verfügbar.
- Registriert bei UBB, genehmigt vom Gesundheitsministerium
- Bietet minimalinvasive Chirurgie
- Die besonders scharfe Spitzenstruktur sorgt für die geringste Empfindlichkeit im Gewebe
- Es gewährleistet eine einfache und sanfte Entfernung der Transplantatfollikel.

ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	XS625	XS63	XS635	XS64	XS65
0.6-5	XS6525	XS653	XS6535	XS654	XS655
0.7	XS725	XS73	XS735	XS74	XS75
0.7,5	XS7525	XS753	XS7535	XS754	XS755
0.8	XS825	XS83	XS835	XS84	XS85
0.8,5	XS8525	XS853	XS8535	XS854	XS855
0.9	XS925	XS93	XS935	XS94	XS95
0.9,5	XS9525	XS953	XS9535	XS954	XS955
1	XS125	XS13	XS135	XS14	XS15
1,1	XS1125	XS113	XS1135	XS114	XS115
1,2	XS1225	XS123	XS1235	XS124	XS125
1,3	XS1325	XS133	XS1335	XS134	XS135





Fue Punch motorisiert für langes Haar

- Es wird erstklassiger deutscher Stahl verwendet.
- Die Spitze ist speziell mit Rillen versehen, um zu verhindern, dass langes Haar bricht.
- Verschiedene Durchmesser- und Längenmaße verfügbar.
- Registriert bei UBB, genehmigt vom Gesundheitsministerium
- Bietet minimalinvasive Chirurgie
- Die besonders scharfe Spitzenstruktur sorgt für die geringste Empfindlichkeit im Gewebe
- Es gewährleistet eine einfache und sanfte Entfernung der Transplantatfollikel.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	US625	US63	US635	US64	US65
0.6-5	US6525	US653	US6535	US654	US655
0.7	US725	US73	US735	US74	US75
0.7,5	US7525	US753	US7535	US754	US755
0.8	US825	US83	US835	US84	US85
0.8,5	US8525	US853	US8535	US854	US855
0.9	US925	US93	US935	US94	US95
0.9,5	US9525	US953	US9535	US954	US955
1	US125	US13	US135	US14	US15
1,1	US1125	US113	US1135	US114	US115
1,2	US1225	US123	US1235	US124	US125
1,3	US1325	US133	US1335	US134	US135



0.08 mm

Tip Length 5 mm

36 mm



IHM Fue Motorize



IHM 25 RED Doppelhandstück ck

1 Standardhandstück
1 Metallhandstück Rechts-
Linkslauf
35000 U/min. Kompatibel mit 110
- 220 W



Doppelhandstück

Ergonomischer Einsatz.
Leichtes Handstück. Leises
Handstück.
Ersatzhandstück



IHM25 ROT

Das Metallhandstück leckt nicht.
Langlebiges, einfach zu bedienendes,
handpassendes Handstück, extrem
leise und leicht. Es ermöglicht Ihnen,
gesündere Transplantatwurzeln zu
extrahieren und ermüdet Sie nicht.



IHM 25 PINK Doppelhandstück ck

1 Standardhandstück
1 Metallhandstück Rechts-
Linkslauf
35000 U/min. Kompatibel mit 110
- 220 W



Doppelhandstück

Ergonomischer Einsatz.
Leichtes Handstück. Leises
Handstück.
Ersatzhandstück



IHM25 PINK

Das Metallhandstück leckt nicht.
Langlebiges, einfach zu bedienendes,
handpassendes Handstück, extrem
leise und leicht. Es ermöglicht Ihnen,
gesündere Transplantatwurzeln zu
extrahieren und ermüdet Sie nicht.




Marathon H37 L

Standardhandstück
 35.000 U/min Rechts-Linkslauf
 Kohlebefeuchtet, luftgekühlt Hand-
 und Fußsteuerung möglich
 Kompatibel mit 110 - 220 W



H 37 L

Farbe: Grau Herkunft: Korea
 Gewicht: 236 Gr Kühlung:
 Luftkühlung Kohlesystem



Marathon H 37 L

Hand- und Fußsteuerung möglich
 35000 U/min. Einstellbare
 Rotationsgeschwindigkeit.
 Rechts- und Linksarbeitszyklus





Starke 210

Standardhandstück
35.000 U/min Rechts-Linkslauf
Kohlebefeuert, luftgekühlt Hand-
und Fußsteuerung möglich
Kompatibel mit 110 - 220 W



Starke 210

Farbe: Weiß Herkunft: Korea
Gewicht: 236 Gr Kühlung:
Luftkühlung Kohlesystem



MIKROMOTOR FUE MOTOR

Saç-qaş aktımı için cihaz
40000 abarot

Starke 210

Hand- und Fußsteuerung möglich
35000 U/min. Einstellbare
Rotationsgeschwindigkeit.
Rechts- und Linksarbeitszyklus





Escort 2 Pro SH20N

Handstück mit Metallspitze
35000 U/min Rechts-Links-
Rotation Luftgekühlte Hand- und
Fußsteuerung möglich
Kompatibel mit 110 - 220 W



SH 300

Farbe: Weiß Herkunft: Korea
Gewicht: 190 Gr Kühlung:
Luftkühlung



Complete set



Champion SH20N

Hand- und Fußsteuerung möglich
35000 U/min. Einstellbare
Rotationsgeschwindigkeit.
Rechts- und Linksarbeitszyklus





IHM GRİ

KOD: MBOX.IHM-GRİ

Handstück mit Metallspitze
30.000 U/min Rechts-Links-
Rotation Luftgekühlte Hand- und
Fußsteuerung möglich
Kompatibel mit 110 - 220 W



IHM GRİ

KOD: MBOX.IHM-SYH

Handstück mit Standardspitze
35000 U/min Rechts-Links-
Rotation Luftgekühlte Hand- und
Fußsteuerung möglich
Kompatibel mit 110 - 220 W



IHM BLUE

KOD: MBOX.IHM-MV

Handstück mit Standardspitze
35000 U/min Rechts-Links-
Rotation Luftgekühlte Hand- und
Fußsteuerung möglich
Kompatibel mit 110 - 220 W



IHM RED

CODE: MBOX.IHM-KRMZ

Handstück mit Metallspitze
30.000 U/min Rechts-Links-
Rotation Luftgekühlte Hand- und
Fußsteuerung möglich
Kompatibel mit 110 - 220 W

SCHWARZE METALLTEILER

KOD: MBOX.IHM-MTL

Handstück mit Standardspitze
30.000 U/min Rechts-Links-
Rotation Luftgekühlte Hand- und
Fußsteuerung möglich
Kompatibel mit 110 - 220 W



SCHWARZBLAUES GRIFFSTÜCK

KOD: MBOX.IHM-MV-01

Handstück mit Standardspitze
35000 U/min Rechts-Links-
Rotation Luftgekühlte Hand- und
Fußsteuerung möglich
Kompatibel mit 110 - 220 W





M BOX KORE

CODE: MBOXK

Handstück mit Metallspitze
35.000 U/min Rechts-Links-
Rotation Luftgekühlte Hand- und
Fußsteuerungsoption
Ergonomische
Handgriffempfindlichkeit
Kompatibel mit 110-220 W

M BOX METALL PIYASEMEN

Farbe: Weiß - Blau - Rot - Schwarz.
Herkunft: Korea. Gewicht: 170 g.
Kühlung: Luftkühlung

CODE: MBOXM



M BOX - Korea

Hand- und Fußsteuerung möglich
35000 U/min. Einstellbare
Rotationsgeschwindigkeit.
Rechts- und Linksarbeitszyklus

WEISS + BLAU + ROT + SCHWARZ
CODE: MBOX.B MBOXM MBOXK MBOXS



K38

Portable type
Digital speed window

MH20

Max. 30,000rpm
130g

Wiederaufladbarer tragbarer Fue-Mikromotor

Artikelnummer:
MH20K38

Handstück mit Metallspitze
35.000 U/min. Rechts-Links-
Drehung. Bis zu 6 Stunden
Betriebszeit bei voller Ladung.
Digitalanzeige-Anzeige.
Verbindung zur Gürtelmontage.
Kompatibel mit 110-220 W

Wiederaufladbarer tragbarer Mikromotor

Farbe: Weiß - Grün - Rot - Schwarz.
Herkunft: Korea. Gewicht: 170 g.
Kühlung: Luftkühlung



Tragbarer Fue-Mikromotor

CODE: MMŞRJ-01

Digitale Anzeigeanzeige
35000 U/min. Einstellbare
Rotationsgeschwindigkeit.
Rechts- und Linksarbeitszyklus





HMI Digitaler Fue-Mikromotor

CODE: BLCK-01 D

Handstück mit Metallspitze
35000 U/min. Rechts-Links-
Drehung, digitale Anzeige
190-Gramm-Handstück, Hand-
und Fußsteuerung möglich,
kompatibel mit 110 - 220 W

HMI Digitaler Fue-Mikromotor

Farbe: Weiß Herkunft: Korea Gewicht:
190 Gr Kühlung: Luftkühlung Digital
Panel



HMI Digitaler Fue-Mikromotor

**Profosyonel Fue
Mikromotor**





HMI Digital FUE Micro Motor S200

CODE: BLCK-01 D

Handstück mit Metallspitze 35000 U/min. Rechts-Links-Drehung, digitale Anzeige 190-Gramm-Handstück, Hand- und Fußsteuerung möglich, kompatibel mit 110 - 220 W

HMI Digital FUE Micro Motor S200

Farbe: Weiß Herkunft: Korea Gewicht: 190 Gr Kühlung: Luftkühlung Digital Panel



Hand Control Knob
Knee Control Cover
Digital RPM&Error Disply
On /Off Switch

- Hand
Knee
Foot
- Fwd
Rev
- Standby
Working


HMI Digital FUE Micro Motor S200

Profosyonel FUE Mikromotor





KOD:OSLSYN-D.01



Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Mikromotor

Der professionellste Mikromotor, den Chiropro Plus kennt 50.000 U/min Rechts-Links-Rotation OSKULATION - Vorwärts-Rückwärts 360 Grad. Ideal für lange Haarwurzeln. Es gibt mehrere Kopfoptionen

Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Mikromotor

Autoklavierbares Kabel- und Handstückset

Chirurgisches Profi-Set



Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Mikromotor

Bietet die Möglichkeit, den Arbeitsbereich mit flüssigem Serum zu waschen





Marathon – Starkes
Universal-Handstück mit 3-
poligem Eingang, runder
Buchse, kompatibel mit
allen Motoren

35.000 U/min Rechts-Links-Rotation,
luftgekühltes Kohlemodell
260 Gr

Ersatzhandstück in
Universalgröße

H 37 L-Modell



marathon



H 37 L-Modell

Farbe: Schwarz - Blau





S 30 PİYASEMEN



- Dimensions : L129 x Ø22 (mm)
- Speed : 0 - 30,000 rpm
- Max. Torque : 2.9 Ncm
- Weight : 143g
- Cord length : 1.5m

CODE: Y.PYSMN.M-01

35.000 U/min Rechts-Links-Rotation,
luftgekühltes Kohlemodell
260 Gr

S 30 PİYASEMEN



S 30 PİYASEMEN



Farbe: Grau





Autoklavierbare Handstückspitze



40.000 U/min Rechts-Links-Rotation,
luftgekühltes Kohlemodell
95 Gr



Autoklavierbare, sterilisierte Handstückspitze aus Metall

Farbe: Mädchen





Autoklavierbares Handstückkabel



40.000 U/min Rechts-Links-Rotation,
luftgekühltes Kohlemodell
95 Gr



Autoklavierbares Handstückkabel



Farbe: Mädchen





N 30 Stiftung



CODE: YP.N30

30000 U/min Rechts-Links-Rotation
Luftgekühlt Kompatibel mit allen
Motoren mit 160 Gr+ Universaleinlass

NBOX IHM ERSATZHANDSTÜCK ROT

KOD: YP.MBOX-BLACK.KRMZ

30000 U/min Rechts-Links-Rotation
Luftgekühlt Kompatibel mit allen
Motoren mit 160 Gr+ Universaleinlass



NBOX IHM ERSATZSTÜCK SCHWARZ

KOD: YP.MBOX-BLACK.SYH

30000 U/min Rechts-Links-Rotation
Luftgekühlt Kompatibel mit allen
Motoren mit 160 Gr+ Universaleinlass





Denk darüber nach

Die dicke Struktur der Gold Series-Graft-Entnahme- und Entfernungszange mit Spitze kann speziell hergestellt werden. Es ist so konzipiert, dass die Transplantatfollikel nicht beschädigt werden.



IHM Toplama Penseti



Gold Serisi Toplama Penseti Size Tablosu

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755

Goldgewinnung





DHI - CHOI-STIFT AUFLEGEN / PLATZIEREN

Gold Series DHI PEN SERIES FORCET Ermöglicht die einfache Einführung des Transplantats in den Stift. Mit seinem ergonomischen Griff bietet es eine einfache Handhabung und ermüdet die Hand nicht.



UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755



Gold Thi Implanter Pen Array / Einführzange



Goldtransplantationszange

Unsere Transplantationszangen der Gold-Serie bestehen zu 100 % aus medizinischem Edelstahl. Personalisierte Spitzengriffoption. Spitzenstruktur Spitzenlänge Spitzenwinkeloptionen sind verfügbar. Pinzetten der Gold-Serie gehören zu unserer Marke.

KRÄFTE BEOBACHTEN Gold-Serie

GOLD-SERIE

- Spitzenlänge
- Spitzenwinkel
- Härtegrad: Grip
- Spitzenstruktur

Hat Optionen


UÇ			AÇI		
	40°	45°	50°	55°	
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455	
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555	
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655	
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755	
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD	
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT	





Gold- Transplantationspinzette mit perforiertem Griff

Unsere Transplantationszangen der Gold-Serie bestehen zu 100 % aus medizinischem Edelstahl. Personalisierte Spitzengriffoption. Spitzenstruktur Spitzenlänge Spitzenwinkeloptionen sind verfügbar. Pinzetten der Gold-Serie gehören zu unserer Marke.



KRÄFTE BEOBACHTEN Perforierter Griff


GOLD-SERIE

- Spitzenlänge
- Spitzenwinkel
- Härtegrad: Grip
- Spitzenstruktur

Hat Optionen

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT






Keramikmodell- Transplantationspinzette

Unsere Auswahlreihe aus der Keramikserie

Griff: Keramikbeschichteter Griff;

- Verursacht kein Schwitzen
- Es ist antistatisch und erzeugt keinen Strom
- Die vergoldete Spitze klebt nicht am Transplantat
- Bietet eine einfache und gesunde Pflanzmöglichkeit



UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT








Titanmodell- Transplantationspinzette



Es handelt sich um ein Titanmodell.
Es ist leichter und langlebiger



UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT






Titan-
Mondzangen-
Serie

Code: TAP-01

Es handelt sich um eine Titanserie. Es ist für eine langjährige Nutzung geeignet. Es ist sterilisierbar. Es handelt sich um ein medizinisch wiederverwendbares Produkt. Es wird für allgemeine Zwecke bei der Transplantation, Entnahme, Ausrichtung oder Platzierung des Dhi-Stifts verwendet.

IST ZANGE



BLACK&GOLD IST
BLEISTIFTE






Gold-Array-Zange

Es handelt sich um die Gold-Serie.
Es ist für die Anordnung und Trennung von Follikeln in Stirntransplantaten konzipiert. Es verfügt über eine dünne Spitzenstruktur, die das Gewebe nicht beschädigt. Es besteht zu 100 % aus rostfreiem medizinischem Stahl.

Sofastuhl

Array-Zange der GOLD-Serie mit gerader Nadelspitze





Stiftförmiger Schiebegriff

Code: STH-K

- Es handelt sich um die Gold-Serie
- Es hat eine Diamantspitze. Es rutscht nicht.
- Hält Gleitmesser aller Größen
- Es ist 15 cm lang
- Es wiegt 50gr
- Sorgt mit seinem Kompressionsclip für sicheren Halt
- Es verfügt über eine Diamantspitze, die eine Kompression in einem Winkel ermöglicht.
- Bietet ergonomische und einfache Bedienung

VERSCHIEBBARER GRIFF

Code: STH-DK

- Es handelt sich um die Gold-Serie.
- Es hält alle Arten von Slide-Blättern fest, auch dickere Slides, und lässt sie nie wieder los.
- Es hat einen Kopf mit Diamantspitze
- Wird in der plastischen Chirurgie und Haartransplantationschirurgie verwendet
- Der horizontale Griff ist ein großartiges Design für diejenigen, die eine Arbeitsgewohnheit haben.



STANDART-SCHIEBEGRIFF

CODE: STH-SM




- Diamantkopf der Goldserie
- Schiebeklinge für alle Größen
- Es ist 14 cm - 15 cm lang
- Scrollt nicht
- Wird in der Haarchirurgie und plastischen Chirurgie verwendet
- Es besteht zu 100 % aus medizinischem Edelstahl



MANUELLER FUE- STANZE und NADELGRIFF Code: MFPH-02

- Es handelt sich um die Gold-Serie
- Universalgröße war Punch Tutar
- Universalgröße für die Nadelspitze
- Es verfügt über einen verstellbaren Kompressionskopf
- Manuelle Transplantatentnahme
- Es wird bei manuellen perkutanen Kanalöffnungsoperationen durch Einführen einer Nadel verwendet.
- Der gezahnte Griff sorgt für einfachen und rutschfesten Halt
- Es besteht zu 100 % aus rostfreiem medizinischem Stahl



MESSER - NADELGRIFF Code: MFPH-01

- ALUMINIUMKÖRPER
- Verstellbarer Kompressionskopf
- 4-Winkel-Kompressionskopf
- Nicht rostende medizinische Materialien
- Es wird bei Operationen verwendet, bei denen eine Nadel und ein Messer gehalten werden.
- Haartransplantation - Tätowierung - Perkutanes Einstechen und plastische Chirurgie sind die Hauptanwendungsgebiete.



BİSTÜRİ HANDLE CODE: BSTR-15


- 100 % MEDIZINSTAHL
- ES IST KOMPATIBEL MIT DEN SKALIERKLINGEN NUMMER 11-15
- Da es sich um einen Stifttyp handelt, bietet er eine sehr komfortable und komfortable Arbeitsmöglichkeit





SAPHIR-HALTER

Der Titan-Modell-Saphirhalter ist mit allen Nummern kompatibel. Es handelt sich um ein Modell in Universalgröße



SAPHIRKLINGEN

- SAPHIRKLINGEN SIND ORIGINALMODELLE.
- UNIVERSAL IST MIT ALLEN STIFTEN KOMPATIBEL
- AUTOKLAVIERBAR - STERILISIERT
- ANTI ALLERGISCH
- MINIMALES GEWEBETRAUMA MIT MINIMALEM SCHNITT
- VIEL SCHNELLERE ERHOLUNG
- NUMMERN SIND FÜR SIE VERFÜGBAR



GRÖSSE:

1 - 1,1 - 1,2 - 1,3 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7






**SP 90
SPEZIALKLINGE
STERIL**



**SP 90 KLEINE
KLINGE**

- 0,8mm**
- 0,9 mm**
- 1,0 mm**
- 1,1 mm**
- 1,2 mm**
- 1,3 mm**
- 1,4 mm**
- 1,5 mm 1,6 mm 1,7 mm**



Nutklingen



VORGESCHNITTENES SLID

Es wird mit Spezialmaschinen geschnitten und ist absolut glatt und scharf.

Packungsinhalt: 25 Stück

GRÖSSE


08 - 1 - 1,1

1,2 - 1,3 - 1,4

1,5 - 1,6 - 1,7



OKT'nin 10 Avantajı

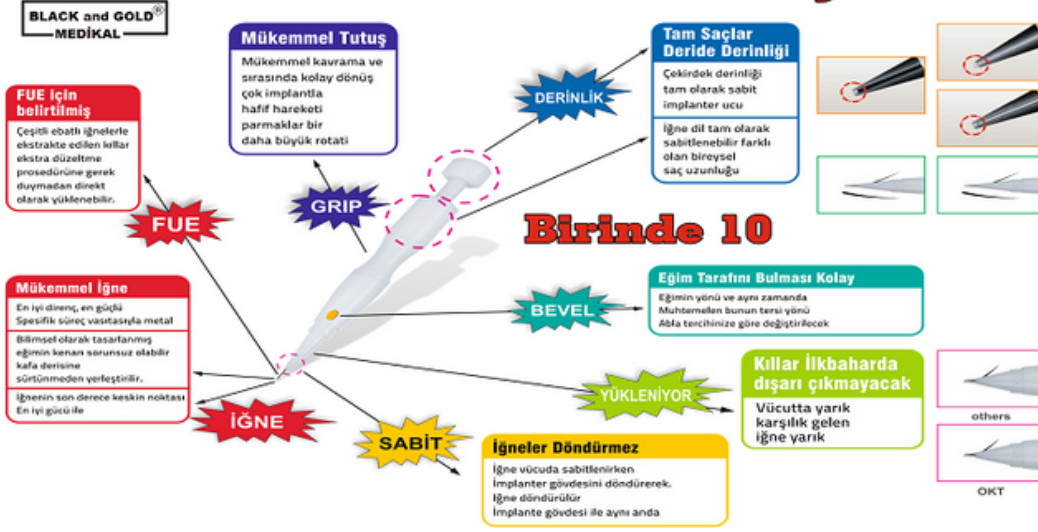

OKT Choi Implanter Pen


- Es handelt sich um einen medizinischen Haartransplantationsstift
- Wird bei der natürlichen Haartransplantation verwendet
- Bietet eine dichtere und häufigere Pflanzmöglichkeit
- Das Pflanzen ist einfacher
- Möglichkeit, beim Platzieren jeder Wurzel eine Richtung vorzugeben
- kann sterilisiert werden
- Es ist ein vernünftiges Produkt
- Lediglich die Nadeln werden gewechselt, wenn sie stumpf werden.
- Erhältlich in 10er-Kartons
- Es gibt verschiedene Zahlen
- Haartransplantation
- Sakal Ekiimi
- Augenbrauentransplantation

OKT Dhi-Implantate

Die Einstellung erfolgt durch Drehen des Kreises im Nadelspitzenbereich.
Drehen nach links: Nadelspitze VERLÄNGERT.
Drehen nach rechts: VERKÜRZT die Nadelspitze



MAVII - 0,9 mm ROT - 1,02 mm



OKT DHI KALEM NUMARALARI

BLAU: Geeignet für Einzel- und Doppeltransplantate

Es wird zur Haarstraffung, Bart- und Augenbrauentransplantation verwendet.

ROT: Geeignet für 1-2 -3-4 -5 Grafts

Es wird im Intensivanbau eingesetzt.

Hinweis: Meistens besteht ein Set aus 4 Blauen + 6 Roten.

HERKUNFT: KOREA



MAVII: 0,8 mm



INCURAM Implanter Pen

- Es handelt sich um einen medizinischen Haartransplantationsstift
- Wird bei der natürlichen Haartransplantation verwendet
- Bietet eine dichtere und häufigere Pflanzmöglichkeit
- Das Pflanzen ist einfacher
- Möglichkeit, beim Platzieren jeder Wurzel eine Richtung vorzugeben
- kann sterilisiert werden
- Es ist ein vernünftiges Produkt
- Lediglich die Nadeln werden gewechselt, wenn sie stumpf werden.
- Erhältlich in 10er-Kartons
- Es gibt verschiedene Zahlen
- Haartransplantation
- Sakal Ekiimi
- Augenbrauentransplantation

Sorglos gegenüber

Implantaten wird durch Drehen des Kreises im Nadelspitzengriffbereich.
Drehen nach links: Nadelspitze VERLÄNGERT. Drehen nach rechts: VERKÜRZT die Nadelspitze

ROT: 0,9 mm



WEISS: 1 mm





INCURAM Implanter Pen

- Es handelt sich um einen medizinischen Haartransplantationsstift
- Wird bei der natürlichen Haartransplantation verwendet
- Bietet eine dichtere und häufigere Pflanzmöglichkeit
- Das Pflanzen ist einfacher
- Möglichkeit, beim Platzieren jeder Wurzel eine Richtung vorzugeben
- kann sterilisiert werden
- Es ist ein vernünftiges Produkt
- Lediglich die Nadeln werden gewechselt, wenn sie stumpf werden.
- Erhältlich in 10er-Kartons
- Es gibt verschiedene Zahlen
- Haartransplantation
- Sakal Ekimi
- Augenbrauentransplantation



Ersatznadel Incuram BLAU: 0,8 mm



Ersatznadel Incuram ROT: 0,8 mm





Ersatznadel Incuram: Weiß 1 mm

**INCURAM
Implanter Pen
Ersatznadel**




Ersatznadel Incuram SCHWARZ: 1,1 mm



1,1 mm 1,0 mm 0,9 mm 0,8 mm

Packungsinhalt: 10 Stück, sterilisierbar, zur Wiederverwendung geeignet, Incuram-Nadelspitze aus medizinischem Stahl. Herkunft: Korea.

HINWEIS: Am häufigsten werden Weiß und Blau verwendet




CHIRURGISCHE SCHERE

- MEDIZINISCHER STAHL
 - GOLD-SERIE
 - DIAMANTSPITZE
 - DÜNN AUF EINER SEITE
 - Die andere Seite ist STANDARD
 - SCHLITTENSCHNEIDEN
 - DRESSING
 - CHIRURGISCH
- Es wird auf den Feldern verwendet

SLID-SCHNEIDMASCHINEN

- MEDIZINISCHES EDELSTAHLKÖRPER
- DOPPELSEITIGER DIAMANTKOPF
- Glatter Schnitt
- Auf die gewünschte Anzahl zuschneiden
- SCHNEIDEN IM GEWÜNSCHTEN WINKEL
- Sie können Ihr eigenes Dia entwerfen und es auf jede gewünschte Größe und Länge zuschneiden.
- ES KANN MINDESTENS 5.000.000 GLATTE SCHIEBERKLINGEN SCHNEIDEN.





BLUE ICE GRAFT-IMPFEINHEIT


- INNERES FACHVOLUMEN VON 10 PETRIELEN
- KÜHLFACH 4-12 GRAD-BEREICH
- ANPASSUNG DES GEWEBEBEFEUCHTIGKEITSVERHÄLTNISSSES
- ANPASSUNG DES PH-VERHÄLTNISSSES DES GEWEBES
- VERHÜTUNG VON INFEKTIONEN MIT DEM DESINFEKTIONSSCHRANK
- Transplantatschockierung und Impfung + Mesotheapie, Transplantatspende mit der Impfmaschine

DAS WICHTIGSTE: ALLE DIESE VERFAHREN; ES BIETET DIE MÖGLICHKEIT DER VERWALTUNG UND ÜBERWACHUNG ÜBER DAS DIGITALE PANEL

ES IST EIN FÜR KLINISCHE TESTS ZUGELASSENES GERÄT MIT ISO + CE+ EC+ GSI + EU-KONFORMITÄT SZERTIFIKAT

- GROSSES INNENVOLUMEN
- DIGITALE STEUERUNG ALLER VORGÄNGE
- WARNSYSTEM BEI NEGATIVEN EREIGNISSEN MIT AUDIOALARM

Mit diesem Gerät entnommene Transplantate stellen sicher, dass sie unter ihren natürlichen Bedingungen gesund überleben können, genau wie lebendes Gewebe. Es unterstützt die Steigerung der Überlebensraten, indem es die abgenutzten Follikel schockiert und sich während der Prozesse in müde Transplantate verwandelt. Es unterstützt die viel schnellere Heilung der erzeugten Transplantate und ihre Haftung am Gewebe. Es bietet das gesündeste, zuverlässigste und natürlichste Haartransplantationsverfahren.




MASSE

60 x 60 x 30 cm
16 KG GESAMT AGIRLIK
110/220 W funktionierende UVC-Desinfektion

PACKUNGSIHALT

- Handbuch
- Gewährleistungszertifikat
- Pfropfmaschine
- Haupteinheit
- Handbuch
- Leitfaden zur Produktbeschreibung





DERMOJET

Schmerzlose Injektion und Anästhesie



Kann sterilisiert werden. Es verfügt über eine 5-cm³-Medizinkammer, es gibt keine Verbrauchsmaterialien, es ist ein medizinisches Produkt, man gibt das Medikament hinein und verwendet es, es gibt keine Nadel, es funktioniert mit Druck.
 Beim Ziehen und Loslassen der Krone entsteht ein eigener Druck.



Schmerzloses Anästhesiegerät

ERGONOMISCHE ANWENDUNG,
 KEINE ANGST VOR NADELN,
 KEINE SCHMERZEN,
 ZEITSPARUNG DURCH SCHNELLE ANWENDUNG, KEINE BLUTUNGEN, BIETET EINEN KOMFORTABLEN EINSATZ





Vibrationsanästhesiestift

6000 pro Minute
VIBRATIONSWELLE



- Bietet 6000 Vibrationen pro Minute
- Betrieb mit Batterie
- Die Aktivierung erfolgt durch Berühren des bereichsnahen Bereichs unmittelbar vor der Injektion. Da das menschliche Gehirn Vibrationen schneller und früher wahrnimmt, stellt es sicher, dass der Patient den Nadeleinstich nicht spürt.
- In gewisser Weise werden wir unser Gehirn täuschen.

Vibriierendes
Anästhesiegerät

- ANÄSTHESIE-ANWENDUNGEN
- EINSPRITZANWENDUNGEN
- Impfanträge
- ANWENDUNGEN VON FÜLLSTOFFEN
- BOTOX-ANWENDUNGEN

Hauptinsatzgebiete



Gold Vibration
Anästhesiestift



FACHMANN
Code: Mcrskp.01



MIKROSKOP FÜR DIE VORBEREITUNG DES PLANTATS + FOLLIKULÄRUNG

Produktbeschreibung :

- 1. Bildschirmanzeige:** Ausgestattet mit einem 7-Zoll-LCD-Bildschirm, einem 26-Megapixel-CMOS-Sensor und einer 2100-fachen digitalen Vergrößerung, die Bilder mit guter Ebenheit und Kontrastklarheit liefert.
- 2. Mikroskop:** Das Mikroskop verfügt über eine um 45 Grad geneigte Kopflinse und einen um 360 Grad drehbaren Okulartubus, der einen 6,5:1-Zoom unterstützt, eine präzise Ausrichtung gewährleistet und die visuelle Ermüdung verringert.
- 3. Feine Verarbeitung:** Alle optischen Glaskomponenten verfügen über Präzisionsglaslinsen, Aluminiumlegierungsmaterial mit hoher Härte, einen einstellbaren Pupillenabstand, unterstützen eine hochauflösende Multimedia-Schnittstelle und einen USB-Videoausgang.
- 4. Ringlicht:** Ausgestattet mit einem kompakten Mikroskop-Ringlicht, sorgt es für eine intensive und konzentrierte schattenfreie Beleuchtung mit einstellbarer Beleuchtungsrichtung und -intensität und kann über einen langen Zeitraum verwendet werden.
- 5. Breite Anwendung:** Medizinische Analyseverfahren + Haartransplantations-Transplantatrennverfahren + Transplantatfollikelextraktion und Untersuchungsverfahren




Merkmale:

Artikeltyp: Trinokulares Stereomikroskop. **Material:** Aluminiumlegierung, ABS. **Eigenschaften des Trinokularmikroskops:** Kopf: 360° drehbares trinokulares konfokales Mikroskop mit 45° Neigung Okular: 30 mm/1,18 Zoll ultraweites Sichtfeld WF10X/20 mit stark vergrößernder Linse + Objektiv: 0,7-4,5-fach Zoombereich: 6,5:1 + Trinokular-Verbindungspunkt: Ca. 23 mm/0,91 Zoll optischer Anschluss Pupillenabstand: Ca. 2 1/8 Zoll bis 3 Zoll (54-76 mm) + Sichtfeld: Ca. 1 1/4 Zoll (33 mm) Arbeitsabstand: 7X-45X (100 mm/3,94 Zoll), 7X-90X (40 mm/1,57 Zoll) 2,0-fache Objektivlinse Kopfmontage: Ca. 3 Zoll (76 mm) Durchmesser + Montagepassung: ca. 1 7/8 Zoll (48 mm Innengewinde) Durchmesser **Eigenschaften der 7-Zoll-Mikroskopkamera:** Bildsensor: 26 MP CMOS-Sensor mit hoher Auflösung

Lieferumfang;

MIKROSKOP + LED-BELEUCHTUNGSKOPF + LCD-DIGITALBILDSCHIRM + ARBEITSUNTERLAGE AUS SILIKON MIT KRATZFEST + VERBINDUNGSKABEL + MIKROSKOP-KAMERAANSCHLUSS + VERBINDUNGSKABEL + ADAPTER

Maße: 25 x 30 x 30 cm. **Kartongröße**
8 kg Kartongewicht



Transplantat- und Follikelanalyse-Mikroskop

Code: **MCRSKP.02**

1 FÜR HAARTRANSPLANTATIONSSCHIRURGIE;

- **Transplantattrennung**
- **Follikelbildung**
- **Wurzelzivilisation**
- **HAAR FOLGT DER ANALYSE**

Das digitale Mikroskop mit LED-Licht-Arbeitstisch und Bildschirm wird Ihr größter Assistent bei solchen Operationen sein

3D-HD-Digitalmikroskop



BIETET 3D-EFFEKT-ANZEIGE. Verstellbares Zubehör: Halterung, LCD-Bildschirm und Dual-LED-Beleuchtung können frei eingestellt werden

Bildverarbeitung und IR-Fernbedienung Hochwertiges Objektiv und empfindlicher CMOS-Sensor + Das Bild wird schnell auf dem Bildschirm angezeigt und hat eine gute Tiefe. + Der UV-Filter auf der Linse trägt außerdem dazu bei, Reflexionen zu reduzieren.

Integrierte 8 einstellbare LED-Leuchten: Mit Ausnahme der 2 LED-Leuchten auf beiden Seiten des Ständers sorgen die integrierten Leuchten in der Linse dafür, dass die Beleuchtung ausreichender ist. Sie können die Blende aller LED-Leuchten frei einstellen.

Aufnahme und Aufnahme: Sie können Bilder und Videos mit der Fernbedienung oder der Bildschirmtaste aufnehmen (Videos und Bilder können auf einer Micro-SD-Karte gespeichert werden, die maximal 32 G unterstützt). Details: Bildsensor: 2-Megapixel-HD-Sensor Videoausgang: FHD1920x1080 30FPS; HD1280x720 30FPS Videoformat: MOV Vergrößerung: Bis zu 100-fach Fotoauflösung: 1920X1080 Fotoformat: JPG Fokusbereich: 6CM-18CM Bildrate: Max. 30 f/s Speicher: Mikroskop-SD-Karte, bis zu 32 G Stromversorgung: 5 V DC Lichtquelle: 8 integrierte LEDs und 2 LEDs am Ständer Bildschirmgröße: 7 Zoll Standgröße: 20 cm * 12 cm * 19 cm Zertifizierung: CE / FCC / RoHS-Paket beinhaltet: Mikroskop x 1 Metallständer x 1 + Anleitung x 1 IR-Fernbedienung x 1 + Schalterkabel x 1 Netzteil x 1 + UV-Filter x 1 Objektivdeckel x 1 Verpackungsdaten 32 * 22 * 10 cm / 1,55 kg



Professionelles Analyseset Code: AK.01

Drahtlose WLAN-Verbindung zwischen TELEFON + TABLET + MONITOR-COMPUTER und FERNSEHER. Die Verbindung ist hergestellt

Sie können Ihre Patientenakten automatisch speichern. Sie können Fotos und Videos mit einem einzigen Klick auf dem Tablet oder der Kamera aufnehmen. Es verfügt über die Einstellungen LICHT + ZOOM + FOKUS.

Kommt mit Installationssoftware



Beschreibung des professionellen Haar- und Hautanalysators

- 10,1-Zoll-TABLET + kabellose Tastatur + spezielle Schutzhülle + externer Speicher
- Fotoaufnahmefunktion, sofortige Anzeige mit einem Klick
- Vorher-Nachher-Aufnahmefunktion
- Kabelloses, anpassbares und zoombares 1600-Pixel-Bildschirmdisplay
- Drahtlose WLAN-Smart-Kamera
- Stehendes Stativ mit verstellbarem Tablet-Halter (höhen- und 360-Grad-verstellbar)
- Mit Genpa Türkiye-Garantie + Blackandgold Medical Assurance



Es bietet Ihren Patienten die Möglichkeit, Haar- und Hautanalysen durch den direkten Einsatz von Tablets wesentlich einfacher durchzuführen.

Es bietet die Möglichkeit, während der Analyse Foto- und Videoaufnahmen zu machen.

Es zeigt klare Ergebnisse hinsichtlich Richtung, Dichte, Anzahl der Transplantate und Transplantateigenschaften der Haarfollikel.

Wenn die Person an einer medizinischen Erkrankung der Kopfhaut leidet, wird sie den Spezialisten beraten.

Es hilft, den Hautfettanteil visuell zu messen. Es visualisiert die Hautstruktur deutlich und liefert ein detailliertes Bild.


Maße der Box: 20 x 20 x 10 cm. Gewicht: 650 g



USB-Analysekamera

Code: AK.02

USB verbunden
1600 x HAAR- und HAUT-
Analysekamera



USB-Telefon-, Tablet- und Computerverbindung

Haar- und Hautanalysator 1000 x - 1600 x USB-Digitaltelefon-kompatibles Anschlussgerät ist im Set erhältlich.

- Haar- und Hautanalysator 1000 X USB Digital
- Bildübertragung über USB
- Einfache Einstellung




Haar- und Hautanalysekamera

ERLÄUTERUNG ;


- Handbuch
- Ladeadapter
- 1600X-Kamera
- Verbindungsadapter für Telefon und Tablet

Maße: 15 x 10 x 7 cm Kartongröße
340g Gewicht



DERMOTOSKOP mit LED-Licht

Code: DRM-01



SCALALI HERRLICH

Code: DRM-02

Dermatologische beleuchtete Scala-Lupe zur Verwendung in der Hautanalyse. Beschreibung: 15 x 5 x 5 cm, 250 g



El Tipi DERMOTOSKOP

Code: DRM - 03



Vergrößerungsverhältnis 40X - Messgenauigkeit: 0,05 mm Skalengenauigkeit Beleuchtung: Weiße LED-Lichtfarbe: Weiß Verwendung:

Es dient der Durchführung regionaler Tiefenanalysen in der Dermatologie und Plastischen Chirurgie. Es wird zur Tiefenanalyse tiefer Formationen in der Haut, der Fettschicht und der Haut verwendet.

Gesamtdurchmesser der Skala: Gesamtdurchmesser 4 mm. Maße: 140 x 45 x 23 mm. 350 g Lieferumfang

1 Lupe, 1 Ledertragetasche, Netzteil + 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).



LASERBEARBEITUNGSBRILLE N

Code: LGZLK-01



Produktbeschreibung ;

Es handelt sich um eine Reihe von Brillen, die in Lasergeräten verwendet werden, die in Haartransplantationszentren und in den Bereichen Ästhetik - medizinische Ästhetik eingesetzt werden.

Haartransplantationszentren

Medizinische ästhetische Abteilungen

Laser Salon Haarentfernung Schutzbrille

200-1200 nm

200 nm - 1200 nm

LASERVERARBEITUNGSBRILLEN-SET

Code: LGZLK-02

Laserprozess-Brillenset

Produktbeschreibung ;

Es handelt sich um eine Reihe von Brillen, die in Lasergeräten verwendet werden, die in Haartransplantationszentren und in den Bereichen Ästhetik - medizinische Ästhetik eingesetzt werden.

Im Set sind 2 Brillen enthalten, eine für den Patienten und eine für den Anwender.

Haartransplantationszentren, Abteilungen für medizinische Ästhetik, Lasersalon-Epilation

Schutzbrille 200-1200 nm-200 nm - 1200 nm



PATIENTENBRILLE FÜR LASERVERFAHREN

Code: LGZLK-03

Laserbearbeitungs-Patientenbrillen, geeignet für kosmetische und Laserverfahren. Kosmetische Patientenbrillen. Schutzwellenlänge: 190 Nm-2000 Nm. Alle Wellenlängen. Od 5+.

Absorbierende

Kunststoffmaterialien, weit verbreitet in Laser- und kosmischen Feldern.

Absorbieren statische Aufladung, mehr als 99,9 % schädliches UV-Licht

IPL LAZER
DANIŞAN KORUYUCU GÖZLÜK

SIYAH





LOOP-BRILLE

LUP-01

Beleuchtete Vergrößerungsgläser

- Flexible Verbundlinse mit hoher Vergrößerung
- Einstellbares Licht nach oben und unten
- Nach oben und unten verstellbarer Schraubenkopf
- Doppelobjektiv mit 3-fachem Zoomverhältnis
- Leicht verstellbarer und erweiterbarer Kapuzengürtel
- Objektiv: 1,8x, 2,3x, 3,7x, 4,8x



LOOP-BRILLE

LUP-02

Beleuchtete Vergrößerungsbrillen Serie 9

MERKMALE

- Büyütme: 1x, 1,7x, 2X, 2,5x, 4,5x
- Material: Bauchmuskeln, Acryl, Jead-Tragelupe
- Zwei Super-LED-Lampen + Batterie: 2 AAA

VERWENDEN ;


- beleuchtete, kopfartige Vergrößerungslinsen 5
- Es können 2 Objektive gleichzeitig verwendet werden
- Gleichzeitig kann die Vergrößerung bis das 8-fache erreichen.
- ABS-Material und klare Acryllinse.
- Der Kopfbügel ist leicht verstellbar.



LOOP-BRILLE

LUP-03

3-facher Zoom. Ergonomische Kopfbandeinstellung. Linsenwinkeleinstellung





LOOP-BRILLE

LUP-04

Hutartige LED-beleuchtete Lupenbrille, 9-facher Zoom, 5-fach-Zoom, 5-fach-Zoom, Kopflampe, beleuchtete Lupe, 2 LED-5-fach-Hutlupe (9-facher Zoom).

Dank der schichtweisen Vergrößerungsfunktion können Sie die Objekte in allen Details sehen.

Dank 5 verschiedenen Objektivs können Sie Objektiv ganz nach Ihren Bedürfnissen verwenden.

Objektive verfügen über 1,0-fache, 1,5-fache, 2-fache, 2,5-fache und 3,5-fache Zoomfunktionen.

Es bietet zusätzlichen Zoom, da es die Möglichkeit bietet, dem Hut mehrere Objektive hinzuzufügen.

Flexible kombinierte Linse, hohes Vergrößerungsverhältnis, nach oben und unten verstellbares Licht, verstellbares Glas an zwei verschiedenen Punkten, nach oben und unten. Branchen und Einsatzgebiete:

- Haartransplantationskliniken - Spezialisten für Haartransplantationen
- Schönheitszentren

Technische Spezifikationen:

- LED-Lampe + Funktioniert mit 3 Fernbedienungsbatterien + Verstellbarer Kopf
- 5 Objektive mit unterschiedlichen Zoomfunktionen

Lieferinhalt :

- 1 Hut + 5 Linsen in der Box + 3 Fernbedienungsbatterien
- Linsenabmessungen: Linsenabmessungen jeweils 10,8 cm Breite und 4 cm Höhe
- Hutabmessungen: Breite: 17,6 cm, Tiefe: veränderbar, Höhe: veränderbar

Es bietet eine ergonomische Bedienung + Es ist ein leichtes und nützliches Modell. Es ist speziell für Haartransplantationen und ähnliche ästhetisch-medizinische Eingriffe geeignet.

LOOP-BRILLE

LUP-05

Beleuchtete Vergrößerungsbrille Serie 5

3 Ersatz-Profi-Vergrößerungslinsen. Wiederaufladbares LED-Modell mit professioneller Beleuchtung. Bietet ergonomische Nutzung. Leichtes und nützliches Modell. Speziell für Haartransplantationen und ähnliche ästhetische medizinische Eingriffe.



LOOP-BRILLE

LUP-06

Kopftyp mit 4 Ersatz-Vergrößerungslinsen + verstellbarem Kopfband, beweglichem Gelenk, verstellbarer Brillenschlaufe.





LOOP-BRILLE

LUP-07

Viel bessere Ausleuchtung durch Dual-LED-Funktion * 5 Ersatzlinsen mit unterschiedlichen Vergrößerungsfunktionen.

* 1,0X - 1,5X - 2,0X - 2,5X - 3,5X Linsengrößen * Elegantes ergonomisches Design, das keine Beschwerden für den Kopf verursacht.

* Spezialanfertigung aus erstklassigem, antiallergischem Titan-Carbon-Material. Der Stift wird mit 3 Batterien betrieben.

Abmessungen Box: 24 x 20 x 7 cm 380 Gr

LOOP-BRILLE

LUP-08

Wesentlich bessere Ausleuchtung durch LED-Funktion * 5 Ersatzlinsen mit unterschiedlichen Vergrößerungsfunktionen.

* 1,0X - 1,5X - 2,0X - 2,5X - 3,5X

Linsengrößen * Elegantes ergonomisches Design, das keine Beschwerden für den Kopf verursacht.

* Spezialanfertigung aus erstklassigem, antiallergischem Titan-Carbon-Material. Es ist das leichteste Modell



GÖZLÜK TİP LED IŞIKLI BÜYÜTEÇ

8X / 15X VE 23 X



LOOP-BRILLE

LUP-09

Kopftyp mit 4 Ersatz-Vergrößerungslinsen + verstellbarem Kopfband, beweglichem Gelenk, verstellbarem Licht

- 10-fache Vergrößerung
- 15-fache Vergrößerung
- 20-fache Vergrößerung
- 25-fache Vergrößerung



BLACK and GOLD[®] MEDİKAL

Adjusting wheel of headband tightness degree

Leather sheath

Shell

Clamping screw cap

Lens

Vertical locking nail

OPTIVISOR
OPTVZR -01
Optivisor Blue
Profi-Lupe mit 5
Ersatzlinsen

Magnifier
1.5X, 2.0X,
2.5X, 3.5X

Batteriebetriebene, fokussierbare LED-Lampe

CODE: BTRYL.01

WIEDERAUFLADBARE
HAARTRANSPLANTATIONSLAMPE LED,
FOKUSSIERBAR

- Es verfügt über ein ergonomisches und stilvolles Design
- Es ist leicht und belastet den Kopf nicht
- LED ist verstellbar und beweglich
- Es verfügt über einen Lithium-Akku und kann durch Aufladen verwendet werden.
- Bietet eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 4-5 Stunden mit einer einzigen Ladung
- Behebt das Stromausfallproblem
- LED-Licht bietet hervorragende professionelle Sichtbarkeit

BLACK and GOLD[®] MEDİKAL

Ayarlanabilir
90°

Yakınlaştırma Uzaklaştırma
Meck gold

Ayar Bandı

Yakınlaştırma Uzaklaştırma Tuşu

Kafa Boyut Ayarlama

Pil Yuvası

Dışbükey Ayna

90° Döndürme

Kablo



BRILLE

KGZLK-01

Schutzbrille. Kann desinfiziert werden. Es ist zur Wiederverwendung geeignet. Es verfügt über einen Seitenschutz. Eine Ohranpassung kann vorgenommen werden.




PROFESSIONELLE LOOP-BRILLE

PRF.LP.01

Professionelle Loop-Brille
Blaue und rote Optionen verfügbar.
Verstellbare Ohrgröße.
Verstellbare OP-Brille.
Haartransplantationsverfahren,
Zahnchirurgie

LICHT: LED CHALIMA ALANI: 20-60
CM
3,5 - 400-fache Vergrößerung





PROFESSIONELLE LOOP-BRILLE

PRF.LP.02

Professionelle Loop-Brille
Professionelle batteriebetriebene LED-Hellblau- und Rot-Optionen verfügbar. Verstellbare Ohrgröße. Verstellbare OP-Brille. Haartransplantationsverfahren, Zahnchirurgie

LICHT: LED CHALIMA ALANI: 20-60 CM

3,5 - 400-fache Vergrößerung





PROFESSIONELLE LOOP-BRILLE

PRF.LP.03

Lichttyp; LED

Lichtintensität; 60.000Lx-Batterie; 2 Schleifenvergrößerungsstufen; 2x-3x-4x Farbtemperatur; 5.500 K Lampenlebensdauer; 50.000 Stunden Arbeitszeit; 4h Gewicht; 280gr

PROFESSIONELLE LOOP-BRILLE

PRF.LP.04

Lichttyp; LED

Lichtintensität; 60.000Lx-Batterie; 1 Schleifenvergrößerungsverhältnis; 2x-3x-4x Farbtemperatur; 5.500 K Lampenlebensdauer; 50.000 Stunden Arbeitszeit; 4h Gewicht; 290gr



PROFESSIONELLE LOOP-BRILLE

PRF.LP.05

Lichttyp; LED

Lichtintensität; 60.000Lx-Batterie; 1 Schleifenvergrößerungsverhältnis; 2x-3x-4x Farbtemperatur; 5.500 K Lampenlebensdauer; 50.000 Stunden Arbeitszeit; 4h Gewicht; 290gr Stirnband Halbmond verstellbar





DERMO LAZER

CODE: HDL.01



Haarlasengerät 650 Nm Haar-Dermo-Lasengerät mit Fuß
Herkunft: Italien GS1+ISO+CE+EC+EU-Konformität + klinisch
zugelassen

- Der Haarlaser regt die Durchblutung an.
- Der Haarlaser Capillary unterstützt die regionale Effizienz, indem er die Kapillarzirkulation erhöht
- Der Haarlaser stimuliert und revitalisiert die Haarfollikel
- Haarlaser stimuliert und aktiviert Wachstumsfaktoren
- Der Haarlaser erhöht die oberflächliche Sauerstoffversorgung, indem er die regionale Sauerstoffretention erhöht.
- Der Haarlaser unterstützt den Übergang von Zelle zu Zelle durch Öffnung der Poren (Erweiterung) und unterstützt die Sauerstoffretention.

Haarlasereinheit

Unter ärztlicher Aufsicht verwendet. Behandlungen gegen Haarausfall. Nach einer Haartransplantation;

- Es beschleunigt die Heilung
- Erhöht die Überlebensrate von Transplantaten
- Beschleunigt die Entstehung neuer Haarfollikel
- Es übersteht die Schock-Abbauphase ohne abzuwerfen.
- Die Symptome des männlichen Haarausfalls treten auch bei Frauen auf
- Schocks stoppen stressbedingten Haarausfall



Haar Dermo Freizeit

Unter ärztlicher Kontrolle und Empfehlung;
Normalerweise 2 Senas pro Woche
Empfohlen wird eine Behandlungsdauer von 6 - 8 Wochen.
Es wird pro Sitzung berechnet.
Jede Sitzung dauert 15 Minuten. Die Senas-Dauer kann am Gerät ausgewählt werden.
5 Der Hauptkörper besteht aus einem Kopf. Es bedeckt den Kopf vollständig.
Es gibt 250 Medical 710 nmlazer LEDs



HAIR LINE DESIGNER LAZER

CODE: HCL.01

MARKIER- UND ZEICHNUNGSLASER

- Körper aus 100 % medizinischem Stahl
- Lithiumbatterie (ca. 3 Monate Nutzung mit einer einzigen Ladung)
- Universeller Ladeanschluss (Laden auch mit Mobiltelefon möglich)
- Medizinischer Laser ist angebracht

Gebrauch von:

Es dient zur kosmetischen Darstellung und zur Bestimmung der anatomischen Mittellinie des Stirnbereichs.

Mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel kann es an jedem Ladegerät aufgeladen werden.


Bietet eine leichte und ergonomische Nutzung.

Die Einstellleiste im Stirnmarkierungsbereich kann erweitert oder reduziert werden.

Längerer direkter Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden.

Die Reinigung sollte mit einem sauberen, feuchten Tuch erfolgen.

Es schadet nicht, es mit Desinfektionsmittel abzuwischen.





NECROSIZ LOTION

NOTFALLKOFFER



Nekrose-Lotion - Nekrose-Lotion Nekrose-Lotion hc Hair Charm Clinical Repair Lotion Black and Gold Nekrose-Lotion Es ist in 125-ml-Tuben erhältlich.

Anwendung: Es wird auf verdächtiges, infiziertes oder nekrotisches Gewebe aufgetragen. (Es muss vorher gereinigt und getrocknet werden) Die Einführung erfolgt durch Abtasten mit der Fingerspitze, ohne zu drücken.

Es bleibt dabei. Da es sich mit Wasser auflöst, erfolgt die normale Wäsche am nächsten Tag (nach 24 Stunden).

Nach dem Waschen ist eine sichtbare Verbesserung spürbar. In schweren Fällen, wie z. B. tiefer Nekrose, infizierter Nekrose oder spät erkannter Nekrose, wird empfohlen, bis zu 1 Woche lang auf die gleiche Weise fortzufahren. Bei verdächtigen oder neu entstandenen Fällen, die sofort bemerkt werden, werden bereits in der ersten Sitzung 99,9 % Ergebnisse erzielt. Und es gibt keinen Transplantatverlust.

- Es hat eine wachsartige Wirkung auf das Gewebe und zieht die Durchblutung der Zellen nach oben.
- Sorgt für eine durchblutungsstärkende Wirkung
- Bietet eine hohe Sauerstoffretention
- Hält es ständig feucht
- Schützt die Zellintegrität und hilft bei der Reparatur beschädigten Gewebes
- Es enthält Inhalte, die darauf abzielen, Infektionen vorzubeugen und bestehende Infektionen zu beheben.
- Es ist durch seine spezielle Formel nicht allergen und das einzige Produkt auf seinem Gebiet.
- **Warnungen:** 4-6 Stunden nach der Anwendung kann es zu kleinen Blutaustritten in der betroffenen Region kommen. (Das liegt daran, dass es die Durchblutung stärkt und den nekrotischen Bereich revitalisiert.)
- Im Anwendungsbereich entsteht ein Erscheinungsbild, das einem gelblichen Ausfluss ähnelt. (Vakuum entfernen die Nekrose und das schmutzige, infizierte, tote Gewebe dort, indem sie Erbrechen auslösen)
- In neu entdeckten Fällen kommt es zu keinem Transplantatverlust, jedoch kann ein gewisser Transplantatverlust (je nach Gebiet) bei Nekrose im Spätstadium oder bei Nekrose bis zum Periost beobachtet werden.



Standardserie

MÜD.L.01

- Mit LED-Licht - 30000 LUX
- 3-stufige Lichteinstellung
- Touch-Screen
- Höhen- und Richtungsverstellung
- LED-Betrieb - Interventionslampe
- Dermokosmetische Verfahren
- Hautpflegeverfahren
- Medizinische Verfahren
- Operation
- Multifunktionale, tragbare Interventions-Prozesslampe mit Rädern, die in Haartransplantationsbereich en bevorzugt wird



INTERVENTIONSLEUCHE MIT SCHLEIFE MIT FUSS

MUD.L.02

- LOOP HERRLICH
- 90 LED-WEISSLICHT
- 35000 LUX LICHT
- ARBEITSBEREICH ZWISCHEN 20-60 CM
- STANDARD MIT RÄDERN
- FUSS UND KÖRPER KÖNNEN ABNEHMT WERDEN
- Kann um 360 Grad gedreht werden



GUSSFUSS PRF MIT 108 LEDS

MUD.L.03

- Haartransplantationslampe Loop 108 LEDs
- Kippsicheres Modell mit Beinen aus Gusseisen
- Es ist die Interventionsleuchte mit dem größten Kopf.
- Produktname: Haartransplantationslampe mit Schleifen-LED-Gusseisensockel 108 LED
- Produktcode: MDLD-02
- Abmessungen: 35 -40 -96 + Gusseisenfuß 60 cm + BREMSRAD
- Besonderheit: Kippsichere Gusseisenbeine + bewegliches Gelenk 108 LEDs
- 35000 LUX LICHT





Spiral-Spot-Serie

MUD.L.04

- Bunte Interventionslampe mit spiralförmigen und kippbaren Beinen
- 24-Watt-LED-Licht - 5.000 Stunden LED-Lebensdauer - Beweglichkeit in jede Richtung dank flexibler Spirale - Mobile Räder - Elektrostatische Lackierung
- Unser Produkt; Die Haartransplantationschirurgie eignet sich für Krankenhäuser, Kliniken, Schönheitszentren und alle Arbeitsbereiche, die fokussiertes Licht benötigen.
- 40000 Lux.
- Schwarz - Blau - Weiß - Gelb - Grau

PROFESSIONELLER ABS-FUSSSPOT-REFLEKTOR

MUD.L.05

- Punktreflektor-Inspektionslampe mit ABS-Kunststofffuß, 50000 LUKS
- 1. Netzanschluss: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,65 A
- 2. Stromverbrauch: 10 W
- 3. Sicherung: F2AL250V
- 4. Ausgang: 15 V = 0,65 A
- 5. Betriebstemperatur: bis zu +5 / +40 C
- 6. Lebensdauer der Glühbirne: 10.000 Stunden
- Produktgrößen:
- Maße: 60 x 60 x 200 cm
- Gewicht: 5 kg



PROFESSIONELLE LED-INTERVENTIONSLEUCHTE

MUD.L.06

- MIT LED-LICHT (GELBE UND WEISSE LED GEMISCHT)
- VERHINDERT REFLEXION UND BLENDUNG
- TOUCH DIGITAL EINSTELLBAR, MIT DISPLAY
- KOPFTEIL IST 360 GRAD BEWEGLICH
- Der Halsteil ist ein bewegliches Gelenk und kann angepasst werden.
- OP-MODELL-FUSSSTRUKTUR MIT RÄDERN IST VERFÜGBAR
- **TECHNISCHE DATEN**
- Dichte 55.000 Lux
- Spotdurchmesser 100-150 mm, Tiefendurchmesser 10-25 cm, Farbtemperatur 3800-4800 K
- Farbwiedergabeindex 91 Ra. Durchschnittliche LED-Lebensdauer >50.000 Stunden
- Anzahl der LEDs 12 Lichtdurchmesser 150 mm Intensitätssteuerung 10~100 Digital Touch
- Stromversorgung 220 V/50 Hz Wechselstrom. Leistungsaufnahme 12 Watt






Professionelle Interventions-Operationslampe Schweiz

MUD.L.07

Muayene Aydınlatma'da
Yeni Nesil LED Teknolojisi

YENİ
ÜRÜN

Derungs



Kullanım Opsiyonları
tavana monte, tekerlekli ayak
raya monte, duvara monte
masaya monte



• muayene odası
• sac ekim odası
• acil servis

• yoğun bakım ünitesi
• neonatoloji
• jinekoloji

• pratisyen
• dermatolog
• kulak burun boğaz

reddot award 2014
winner

- LED-Technologie
- Hohe Beleuchtungsstärke 60'000 lx / 0,5 m
- Die LED-Lebensdauer beträgt bei optimalem Niveau garantiert 60.000 Stunden.
- Leuchtfläche 210 mm
- Präzise Farbwiedergabe Ra > 95, R9 > 90
- Farbtemperaturen (3500K und 4500K) ermöglichen eine individuelle Kontrastdarstellung. Die Beleuchtungsstärke erfolgt in 4 Stufen
- Höchste Lichtqualität dank Diamantoptik
- Antimikrobielle Hygienefunktion an wichtigen Lampenkomponenten
- Einfache Bedieneinheit am Kopf
- Maximaler Arbeitsradius (Kopf um 360° drehbar)
- Hervorragende Ergonomie mit federausgeglichenem Aluminiumarmsystem
- Minimale Wartungskosten durch LED-Technologie
- Entspricht den Normen EN 60601-1 und EN 60601-2-41
- Das Produkt ist mit Silberionen bedeckt. Innerhalb von 8 Stunden.
- Es sterilisiert sich selbst.
- Kann an der Wand montiert, auf Schienen montiert werden und
- Es sind Optionen mit Rollenfuß erhältlich.
- AN DER WAND MONTIERT
- Verfügbare Optionen für die Deckenmontage > (gegen Gebühr)





Professionelle Interventions-Operationslampe

MUD.L.08

Deutschland

• **Technische Spezifikationen von Operationslampen**

- **Zentrale Beleuchtungsintensität (EC):** Um eine gute Sicht zu gewährleisten und eine visuelle Belastung für Chirurgen zu vermeiden, sollte die ideale Lichtintensität zwischen 40.000 und 160.000 Lux liegen, in der Mitte des Lichtstrahls, einen Meter von der Lichtquelle entfernt.
- **Farbtemperatur (K):** Da OP-Leuchten im Allgemeinen dunkelrotes Gewebe beleuchten, muss sichtbares rotes Licht bereitgestellt werden, um den Kontrast und die Gewebedifferenzierung hervorzuheben. Die Farbtemperatur von 4000 K sorgt für ausreichende Helligkeit und ermöglicht dem Chirurgen die Unterscheidung echter Gewebefarben bei minimaler Ermüdung der Augen. Der akzeptable Bereich für OP-Leuchten sollte zwischen 3000 und 6700 K liegen.
- **Beleuchtungstiefe (L1+L2):** Der Abstand zwischen den 20 %-Beleuchtungsintensitätspunkten oberhalb und unterhalb des Mittelpunkts. Vom Punkt maximaler Beleuchtung aus, also in der Mitte des Lichtfeldes 1 Meter von der lichtemittierenden Fläche entfernt, wird das Photometer so lange an das Licht herangeführt, bis die gemessene Lichtintensität auf 20 % des Maximalwertes absinkt. Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt und diesem Punkt wird als L1 definiert. Der ebenfalls gemessene Abstand vom Licht beträgt L2. Die Ausleuchtungstiefe ohne Nachfokussierung ergibt sich aus der Summe der beiden Abstände L1 und L2. In der 2009 veröffentlichten zweiten Ausgabe der IEC-Norm wurde der Schwellenwert von 20 % auf 60 % angepasst. In der Praxis handelt es sich um einen Ausdruck für die optimale Abbildung kleiner, kontrastarmer Objekte in unterschiedlichen Tiefen von Körperhöhlen. Chirurgische Lampenköpfe mit großer Schärfentiefe bieten einen über dem Standard liegenden Arbeitsbereich, ohne den Arbeitsbereich zu verkürzen.
- **CRI-Ra-Wert:** Eine OP-Lampe mit einem hohen CRI-Wert sorgt dafür, dass Farben natürlicher erscheinen. Der Wertebereich variiert zwischen 0 und 100. Tageslicht gilt als 100. CRI-Werte von 85 und größer 85 weisen auf eine gute Farbwiedergabe hin. Kurz gesagt: Je näher der Wert bei 100 liegt, desto natürlicheres und hochwertigeres Licht wird erhalten.
- **CRI R9-Wert:**
- **Reflexionsspektren** sind ein Wert, der besonders für Objekte mit roten Wellenlängen relevant ist. LED-Beleuchtung kann die rote Farbwiedergabe nicht vollständig erreichen. Bei chirurgischen Eingriffen sollte eine Beleuchtung mit einem hohen R9-Wert verwendet werden, die die rote Farbe vollständig zur Geltung bringen kann.
- **Materialtyp:** Als Material für OP-Lampenköpfe muss ein hartes Material ausgewählt werden, das temperatur-, stoß- und kratzfest ist.
- **Durchmesser des Beleuchtungsbereichs (D10):** Er endet dort, wo die Operationslampe 10 % der Lichtintensität erreicht. Wide bezieht sich auf den Durchmesser des Spots.
- **Messung der Lichtverteilung (D50):** Sie endet dort, wo die Operationsleuchte 50 % ihrer Lichtstärke erreicht. „Schmal“ bezieht sich auf den Durchmesser des Flecks.
- **Laminarer Luftstrom:** In Operationssälen und chirurgischen Eingriffen wird ein laminarer Luftstrom bereitgestellt, um zu verhindern, dass sich Bakterien, Viren und Keime im offenen Operationsbereich ansiedeln und Infektionen verursachen. Luftturbulenzen sind keine wünschenswerte Situation, da sie dazu führen können, dass Partikel ungerichtet ausgeblasen werden, was zu einer Infektion des Operationsbereichs führen kann, der steril bleiben muss. Um die Kontamination von OP-Lampen zu minimieren, sollten OP-Kopfkonstruktionen verwendet werden, die für Luftturbulenzen sorgen.
- **Hygiene:** Die verstärkte Isolationsstruktur und das mit antibakterieller Farbe beschichtete Gehäuse von LED-OP-Lampen sollten im Inneren des Geräts keinen Staub, Schmutz und Bakterien enthalten und für die Reinigung mit Desinfektionsmitteln geeignet sein.
- **IP54:** Köpfe von OP-Leuchten müssen staub- und wasserbeständig sein.
- **OP-Lampen gibt es in drei verschiedenen Einsatzarten:** Deckenmontage



Mobil
Mobile



MESOTHERAPIE-PISTOLE DIGITAL

CODE: MZTRP.01-EZ

- DIGITALER EINSTELLBARER KOPF
- STERIL, EINWEG MIT MEHREREN NADELSPITZEN
- HAAR-MESOTHERAPIE
- PRP GESICHT - HALS - DEKOLLET UND KÖRPER
- Hergestellt in Korea



Doz Ayarı Yapılabilir





MESOTHERAPIE-PISTOLE DIGITAL

MZTRP.02-INSTADBEAUTY

- DIGITALER EINSTELLBARER KOPF
- EINWEG-SYJEKTOR-UND NADELSPITZEN-SET, STERIL VERPACKT
- HAAR-MESOTHERAPIE
- PRP GESICHT - HALS - DEKOLLET UND KÖRPER
- Hergestellt in Korea

INSTATBEAUTY in MINUTES NEEDLE-FREE MESOTHERAPY

MINI VANADIUM TITANIUM MESOTHERAPY GUN FOR MOISTURIZING

INSTATBEAUTY mezoterapi tabancası intradermal uygulamalar için geliştirilmiştir. Mezoterapi işlemlerinin güvenli, garantili ve konforlu uygulanmasına olanak sağlar.

Hava kompresörüyle çalışan mezoterapi tabancası **INSTATBEAUTY MESOGUN**; enjeksiyon derinliği, enjeksiyon modu ve her noktaya bırakılacak ürün miktarı için bar basıncının ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Dakikada seri 500 atış özelliği sayesinde oldukça hızlı enjeksiyona olanak verir. Manuel uygulamalarda yaşanan ağrı, acı riskini ortadan kaldırır.

Tek kullanımlık iğne kiti ile kullanılan **INSTATBEAUTY MESOGUN**; ürün kaybını engeller. Kontrollü, rahat uygulama özelliği sayesinde hasta konforunu da sağlar.



DERİN TEMAS

Teknolojik Yapısı ile en derine temas ve iletme imkanı.



Yaşlanma ile birlikte başlayan çizgi ve kırışıklıklar üzerinde etkin uygulama ve Anti-Aging Seansları

KIRISIKLIK UYGULAMALARI





GÖZENEK KÜÇÜLTME

Gözenek uygulamalarında ve yağlı ve yağlıya dönük cilt tiplerinde etkin sonuçları



Güneş Lekeleri
Cilt Lekeleri
Akne Lekeleri
Çil ve Yarık İzleri
gibi leke sorunları ve cilt renk/ton dengesizlikleri için uygulamalar.

RENK/TON DENGESİZLİKLERİ CİLT LEKELERİ





Zentrifuge 6 Augen

CODE: SNTRF.06

- 30 MINUTEN ZEITLICH
- 4000 U/min
- KUNSTSTOFF-AXT
- VAKUUMFUSS Anti-Shake
- RUHIGER BETRIEB
- KOMPATIBEL MIT A.S.M. UND PRP
- 6 GZÖLÜDÜR

Abmessungen Karton: 35 x 35 x 35
cm, 4 kg

Electromag 8 Augen

CODE: SNTRFJ-E.M.08

- Özel platform üzerine oturtulan bakım gerektirmeyen indüksiyon motor sessiz ve titreşimsiz çalışır.
- Çalışırken kapağın açılmasını önleyen özel kilit sistemi vardır. Kapak kapatılmadan cihaz çalıştırılmaz.
- Kısa süreli çalışmalar için pulse seçeneği bulunmaktadır. Cihazlar Hız veya Savurma gücü girilerek çalıştırılabilir.
- Ayrıca kullanıcı tarafından istenilen çalışma anında savurma gücü (RCF) veya hız dönüşümü yapılarak ekranda gösterilir
- Tüpleri taşıyan 35° sabit açılı rotorlar polikarbonat malzemeden yapılmıştır.
- Açılır başlıklı santrifüjlerde rotor malzemesi elektrostatik fırın boyalı alüminyumdur.
- Tüp yuvaları değiştirilerek çeşitli tüp hacimlerine uygun çalışma sağlanır.
- Medikal santrifüj cihazlarının dış gövdeleri çelik sacdan imal edilmiştir ve fırın boya ile kaplanmıştır.
- Cihazlar akım emniyet sigortası ile koruma altına alınmıştır.



Ağırlık : 9 KG



Dijital Kontrol Paneli

- 0-99 dakika Arasında Ayarlanabilen Mekanik Zaman Ayarı
- Dijital Hız Kontrolü



8x 15ml Tüp Kapasiteli

Teknik özellikleri:

Tüp Kapasitesi	8x15ml
Rotor Tipi	Düşeyle 35° sabit açılı rotor
Hız Kontrolü	PID Dijital Mikroprosesör kontrol
Kontrol Paneli	Hız,RCF ve Zaman Kontrolü
Max. Dönme Hızı	5000 rpm
Max. Savurma Gücü (RCF x g)	2515xg
Hız Ayarlama Adımı	10rpm
Hız Ayarlama Aralığı	500-5000rpm
Zaman Başlangıcı	Ayarlanan Hıza Ulaştığında
Zaman Aralığı	1-99 dk
Sürekli Çalışma Modu	Var
Savurma Gücü Girilerek Çalışma	Var
Kısa Süreli Çalışma	Pulse Tuşuyla
Program Sayısı	10
Sigorta	1 Amper
Toplam Güç	100 W
Emniyet Sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak Kilidi	Var
Harici Hız Okuma	Var
Döner Başlık Malzemesi	Polikarbonat
Tüp yuvası (gode) malzemesi	ABS (sert plastik)
Dış Gövde Malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
Besleme	AC 190-240V / 50-60 Hz
Dış Ölçüler (g x y x d)	29x25x36 cm
Net Ağırlık	9 kg
Paketli Ağırlık	10 kg




PRP-GEL-TUBE-PACKUNG 50 STÜCK



CODE: PRP.T-J.50

ENTHÄLT 50 MEDIZINISCHE 10-ML-GEL-PRP-ZUBEREITUNGSRÖHRCHEN

Dem Patienten entnommenes Blut wird in ein spezielles Vakuumröhrchen mit Gel überführt und nach dem Zentrifugieren im Zentrifugengerät verwendet




PRP-CITRAT-RÖHRCHENPAKET 50 STÜCK

PRP.T-S.50

ENTHÄLT 50 MEDIZINISCHE 10-ML-PRP-ZUBEREITUNGSRÖHRCHEN mit Citrat

Dem Patienten entnommenes Blut wird in ein spezielles Vakuumröhrchen mit Gel überführt und nach dem Zentrifugieren im Zentrifugengerät verwendet

BLOOD STRUCTURE



PLASMA



WHITE BLOOD CELLS AND PLATELETS



RED BLOOD CELLS





DERMOROLLER

CODE: DRMRL-500.01

- HAARBEHANDLUNGEN
- HAAR-MESOTHERAPIE
- GESICHTS-MESOTHERAPIE
- HAARPFLEGEANWENDUNGEN
- ANWENDUNGEN FÜR DIE GESICHTSPFLEGE
- ANWENDUNGEN ZUR HAUTPFLEGE
- STERILE VERPACKUNG PERSONALISIERT
- 500 TITAN-NADELN
- ROLLENFortsCHRITT PRÄZISION



LEERE STERILE FLASCHE MIT ROLLVERSCHLUSS

DRMRL-300.02

Produktbeschreibung

Inhalt des Sets: Hydra Roller, Dermaroller-Reinigungsflüssigkeit, Hautdesinfektionsmittel, türkisches Benutzerhandbuch Hydra Roller: Es handelt sich um ein Micro-Needling-Gerät mit 64 Titannadeln am Rollerkopf.

Es besteht aus 3 Hauptteilen: Kopf, Rohr und Abdeckung. Dank der Schutzhülle bleiben die Nadeln unbeschädigt. Es stimuliert den Wundheilungsmechanismus und sorgt für die Produktion der Kollagensynthese, ohne die Haut zu schädigen. Dank der Mikrokanäle, die es in der Haut öffnet, erleichtert es die Aufnahme von Wirkstoffen unter die Haut. Es wird bei dunklen Augenringen, Falten und feinen Linien, offenen Poren, Akne und Narben, Hautunreinheiten, Haarausfall, Schwangerschaftsstreifen, Cellulite und vielen anderen Problemen eingesetzt.

Das Verfahren wird durchgeführt, indem der Anwendungsbereich 6-10 Mal sternförmig (Plus-Kreuz) gescannt wird. Abhängig von der verwendeten Nadelstärke erfolgt die Anwendung in einer Sitzung alle 2-5 Tage.

Der Hydra-Roller sollte vor und nach jeder Sitzung mit Dermaroller-Reinigungsflüssigkeit gereinigt werden.

Abmessungen der Hydra-Rollernadel:

- 0,25 mm - kann unter und um die Augen herum verwendet werden.
- 0,50 mm - kann im Gesicht oder auf den Haaren verwendet werden.
- 1,00 mm - kann im Körperbereich oder auf den Haaren verwendet werden.

Intervalle der Hydra Roller-Sitzungen:

- 0,25 mm - Kann in einer Sitzung alle 2 Tage aufgetragen werden.
- 0,50 mm - kann in einer Sitzung in 3 Tagen aufgetragen werden.
- 1,00 mm - kann in einer Sitzung in 5 Tagen aufgetragen werden.





HAARTRANSPLANTATION und MEDIZINISCHER KOD:ÄSTHETISCHER STUHL

- OP-STUHL DER LUX-SERIE MIT 3 MOTOREN
- LASERGESCHNITTENE STAHLKONSTRUKTION
- Rüttelt nicht
- 32 DICHTE SPEZIALSERIE SCHAUMKOMFORT
- VINLEX-LEDERBEZUG DER AŞAN VIVA-SERIE
- PERFORIERTER KOPF (UND SCHLISSKISSEN)
- Es ist ANTIBAKTERIELL
- FARBE IST OPTIONAL

HINWEIS: Optional werden Experten-Prozesshocker und Arbeitswagen in der gleichen Farbe hergestellt.
ABMESSUNGEN: 185 X 61 X 60 CM NETTO: 125 KG





ORTHOPÄDIE EXPERTEN-OP-HOCKER

KOD: TBR.01

- Orthopädischer Eingriffshocker mit Rückenlehne
- Es verfügt über Stoßdämpfer und lässt sich heben und senken.
- Es hat Chrombeine
- Gebremstes Radsystem ist verfügbar
- Es hat eine Rückenlehne
- Für den Dauereinsatz geeignet, ergonomisch
- Es ist ergonomisch zu bedienen
- Farboptionen verfügbar.

ABMESSUNGEN: 40 x 40 x 50 cm.

Nettogewicht: 9 kg





PROZEDUR-HOCKER MIT RÜCKENLEHNE

KOD: TBR.02

- Orthopädischer Eingriffshocker mit Rückenlehne
- Es verfügt über Stoßdämpfer und lässt sich heben und senken.
- Es hat Chrombeine
- Gebremstes Radsystem ist verfügbar
- Es hat eine Rückenlehne
- Es ist für den Langzeitgebrauch geeignet,
- Es ist ergonomisch zu bedienen
- **Farboptionen verfügbar.**

ABMESSUNGEN: 35 x 40 x 40 cm

NETTO: 8 KG

IF-HOCKER-SERIE

KOD: TBR.03

- Verfahren Stuhl Orthopädie
- Es verfügt über Stoßdämpfer und lässt sich heben und senken.
- Es hat Chrombeine
- Gebremstes Radsystem ist verfügbar
- Es hat eine Rückenlehne
- Es ist für den Langzeitgebrauch geeignet,
- **ES IST EINE PERSONALISIERTE SERIE MIT SEINER FORM, DIE DIE HÜFTEN FÜLLT UND DAS GEFÜHL VON MÜDIGKEIT UND TROMMELUNG ENTFERNT.**
- **Die Farboption ist NUR SCHWARZ**

ABMESSUNGEN: 40 x 40 x 40 cm.

Nettogewicht: 7 kg



RÜCKENLOSER HOCKER

KOD: TBR.04

- Verfahren Stuhl Orthopädie
- Es verfügt über Stoßdämpfer und lässt sich heben und senken.
- Es hat Chrombeine
- Gebremstes Radsystem ist verfügbar
- Es hat eine Rückenlehne
- Es ist für den Langzeitgebrauch geeignet,
- **IST EIN MODELL OHNE OBERFLÄCHE**
- **Farboptionen VERFÜGBAR**

ABMESSUNGEN: 40 x 35 x 38 cm.

Nettogewicht: 5,5 kg



BLUTZEICHUNGSSTUHL PROFESSIONELLER TYP

CODE: ERP.E.220-B

- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack
- antibakterieller Bodenbelag
- Trendelenburg-Funktion
- Bewegliche Kopfstütze und Armlehnen
- Gleichzeitige Rücken- und Fußbewegung
- Handsteuerung
- Sitzfläche: 60 x 50 cm
- 28 Dichte, 5 cm grauer Schwamm
- Maße: 80 x 175 x 48 cm
- Gewicht: 40 kg

SPEZIELLER MEDIZINSCHRANK VERSCHLOSSEN

CODE: ERP.E-112

- Betäubungsmittelkabinett
- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack
- grüne rote Kappen
- Dkp hinten
- Abschließbare Abdeckungen
- Maße: 18 x 60 x 50 cm
- Gewicht: 9 kg



UNTERSUCHUNGS-RUHETRAGE

KOD: TBR.04

- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack
- antibakterieller Bodenbelag
- Kopf- und Fußbewegung mit Gaskolben
- Füße ruhig
- Sofalänge mit geschlossenen Beinen: 145 cm
- Kopfteillänge: 40 cm
- Sitzteillänge: 100 cm
- Fußteillänge: 40 cm
- Maße: 56 x 185 x 70 cm
- Gewicht: 22 kg



MAYO MASASI HİDROLİKLİ MODELL

KOD:MM.H.01

- Edelstahl der Qualität 304
- Drei antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Höhenverstellung mit hydraulischem Fußpedal
- Um 360 Grad drehbarer Tisch
- Es handelt sich um ein Medizinprodukt
- Gewicht: 22 kg. Verpackt: 25 kg



KANN MANUELLES TASTENBRETT MASSIEREN

KOD:MM.H.02

- Edelstahl der Qualität 304
- Drei antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Manuelle Höhenverstellung
- Um 360 Grad drehbarer Tisch
- Es handelt sich um ein Medizinprodukt
- Gewicht: 17 kg. Verpackt: 20 kg



FLUSSMASSAGE TIBBİ HANDBUCH

KOD:MM.H.03

- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack
- Drei antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Oberplatte aus hochwertigem Edelstahl 304
- Manuelle Höhenverstellung
- Nutzfläche im Tisch: 57x38 cm
- ABMESSUNGEN: 60X40X70 CM 18 KG



PATIENTENTISC

H

CODE: ERP.E-273.A

- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack
- Vier antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Antibakterielle ABS-Oberplatte
- Bewegung mit Stoßdämpfer

Abmessungen: 40 x 80 x 80-100 cm. Gewicht: 10 kg



PATIENTENTISCH

CODE: ERP.E-273

Antibakterielle elektrostatische Pulverfarbe ABS antistatisch Vier Rollen, zwei mit Bremsen Tischplatte aus Holz Bewegung mit Stoßdämpfern Abmessungen: 40 x 80 x 80-100 cm Gewicht: 10 kg

POSITIVER SCHRANK

CODE: ERP-271-A

- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack
- Vier antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- ABS-Oberplatte, Blechgehäuse
- Schublade und Schrank

Maße: 37 x 44 x 80 cm

Gewicht: 15 kg





KLEIDWAGEN

CODE: ERP.E251

- 1 Antibakterielle elektrostatische Pulverfarbe
 - Vier antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
 - Metallkörper
 - 29x24 cm Trommel, 40 cm Badewanne, 20 cm Waschbecken
 - Schiebegriff
- Abmessungen: 36 x 87 x 82 cm.
Gewicht: 10 kg



MATERIAL- UND MEDIZINWAGEN

CODE: ERP.E-257

- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack auf Blechkörper
- Vier antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Antibakterielle Arbeitsplatte aus ABS
- Aktenhalter und Mülleimer
- 32 antibakterielle, transparente Medikamentenboxen
- Zwei Schubladen
- Schiebegriff
- Maße: 50 x 90 x 110 cm
- Gewicht: 47 kg



GERÄTEWAGEN MIT SERUMAUFHÄNGUNG

KOD: ERP.E-233A

- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack
- Vier antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Metallkörper
- Mit Schubladen und Kleiderbügel
- Schubladentiefe: 11 cm
- Maße: 40 x 50 x 82 cm
- Gewicht: 10 kg





WASCHSITZ LUXUS

CODE: Y-KLTK.01

- WASCHSITZ DER LUX-SERIE
- ES IST ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL
- SPÜLE + MISCHER-SET INKLUSIVE
- NUR WASSERANSCHLUSS UND ABFLUSSANSCHLUSS HERGESTELLT UND ES IST BEREIT FÜR DEN DIREKTEN GEBRAUCH.

GRÖSSE: 140X65X55 CM - 45 KG

WASCHSITZ

CODE: Y-KLTK.02

- WASCHSITZ STANDARD
- ES IST ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL
- SPÜLE + MISCHER-SET INKLUSIVE
- NUR WASSERANSCHLUSS UND ABFLUSSANSCHLUSS HERGESTELLT UND ES IST BEREIT FÜR DEN DIREKTEN GEBRAUCH.



TRAGBARER WASCHSTUHL

CODE: Y-KLTK.03

- TRAGBARER WASCHSTUHL
- Der Wasserablaufschauch wird in den Abfluss oder das Waschbecken geworfen
- In einem Badezimmer oder einem geeigneten Raum kann der Abfallschlauch auch in einen Eimer oder einen ähnlichen Bereich umgeleitet werden.
- ES KANN ÜBERALL MITGETRAGEN UND TRAGBAR VERWENDET WERDEN.



Z-BETRIEBSTISCH MIT SCHUBLADENMODELL

CODE: Z.SHP-01

- Verarbeitungstisch Z-
- Schubladenmodell
- Abmessungen: 40 x 65 x 71 cm
- Gewicht: 15 kg
- 2 Regale und Schubladen
- Es handelt sich um ein medizinisches Modell mit Rädern.
- RAD MIT BREMSE
- MEDIZINISCHE ANODISIERTE STATISCHE PULVERFARBE

OP-TISCH Z-MODELL MIT 2 ABLAGEN

CODE: Z.SHP-02

- Operationsständer Z-Modell
- Abmessungen: 40 x 65 x 71 cm
- Gewicht: 12 kg
- 2 Regale
- Es handelt sich um ein medizinisches Modell mit Rädern.
- RAD MIT BREMSE
- MEDIZINISCHE ANODISIERTE STATISCHE PULVERFARBE



OP-TISCH Z-MODELL MIT 3 ABLAGEN

CODE: Z.SHP-03

- Operationsständer Z-Modell
- Abmessungen: 40 x 65 x 71 cm
- Gewicht: 12 kg
- 2 Regale
- Es handelt sich um ein medizinisches Modell mit Rädern.
- RAD MIT BREMSE
- MEDIZINISCHE ANODISIERTE STATISCHE PULVERFARBE





SERUM ASKISI AHTAPOT AYAKLI

CODE: ERP.E288

- Antibakterieller, elektrostatischer, silberfarbener, rauer Pulverlack
- Fünf antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Vernickelter Kleiderbügelabschnitt
- mit vier Haken
- mit gusseisernen Beinen

Größe: 60 x 60 x 130-220 cm. Gewicht: 9 kg

SERUM ASKISI STANDARDMODELL

CODE: ERP.E287

- Antibakterieller elektrostatischer Pulverlack
- Vier antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Vernickelter Kleiderbügelabschnitt

Größe: 50 x 50 x 105-187 cm. Gewicht: 3 kg



IV POSE PROFESSIONELLES MULTIPLE-MODELL

CODE: ERP.E-289.B

- Gehäuse aus Edelstahl der Güteklasse 304
- Fünf antistatische ABS-Räder, zwei mit Bremsen
- Vier Kleiderbügel
- Infusionspumpentauglichkeit
- Fünf Fuß vernickelt

Maße: 60 x 60 x 115-210 cm

Gewicht: 6 kg





Hastabaşı
Monitör Şehpası
ZRV-097

- Krom Nikel Kaplama Gövde
- Alüminyum Cihaz Sabitleme Tablası
- Paslanmaz Aksesuar Sepeti
- 2'si Frenli 4 Tekerlek



GERÄTEÜBERWAC-
HUNGSWAGEN
MEDIZIN

KOD: C.ARB-01

- Tragbarer Monitorständer
 - Chromvernickeltes Gehäuse
 - Gerätebefestigungstisch aus Aluminium
 - Edelstahl-Zubehörkorb
 - 4 Räder, 2 mit Bremsen
- ABMESSUNGEN: 140 x 50 x 40 10 kg

GERÄTESTÄNDER
PROFESSIONELLES
MODELL

KOD: C.ARB-02

- PROOPTIONAL-SERIE
HANDHABUNGSWAGEN FÜR
MEDIZINGERÄTE
- Antibakterieller elektrostatischer
Pulverlack
- Vier antistatische ABS-Räder, zwei mit
Bremsen
- 3-GESCHOSSIGER NUTZUNGSBEREICH
- KAYDIRMAZ TABLALAR
- **3-STROM-STECKDOSE AM GERÄT**
- GRIFF ZIEHEN

Abmessungen: 80 x 40 x 40 Gewicht: 8



kg



GERÄTEWAGEN AUS EDELSTAHL,
SCHUBLADENMODELL

KOD: C.ARB-03

- Edelstahl
 - Chromvernickeltes Gehäuse
 - 2 Regale + Schubladen
 - 4 Räder, 2 mit Bremsen
 - Medizinische Operationssaal-Serie
- ABMESSUNGEN: 60 x 50 x 65 28 kg



**ETUV STERILISATOR
50 LITER**

KOD: ETV.50

- Sterilisatorgerät Dry Air 50LT Digital
- Thermostat: 20 °C - 250 °C
- Empfindlichkeit: + 2 %
- Widerstand: 600 W + Innenvolumen: 50LT
- Innenmaße:
- Breite: 40 cm - Höhe: 40 cm
- Tiefe: 32 cm

Es ist vielseitig einsetzbar

Es kann in Haartransplantationskliniken, bei Zahnärzten und bei kleineren chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden.



**Ofensterilisateur 10
Liter**

KOD: ETV.10


- Sterilisatorgerät Dry Air 10 LT Digital
- Thermostat: 20 °C - 250 °C
- Empfindlichkeit: + 2 %
- Widerstand: 600 W + Innenvolumen: 50LT
- Innenmaße:
- Breite: 30 cm - Höhe: 30 cm
- Tiefe: 24 cm

Es ist vielseitig einsetzbar

Es kann in Haartransplantationskliniken, bei Zahnärzten und bei kleineren chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden.



- Digital Is Cöstergesi
- Zamanlayıcı: 120 Dakika
- Termostat: 30C - 300C



VERSCHLIEBVRORICHTUNG FÜR STERILE VERPACKUNGEN

CODE: PK.01

- Technische Daten des Sterilisationsrollenschneide-Verschleißgeräts:
- - 230 V / 50 Hz Spannung
- - 500 W Leistung
- - Maximale Schließbreite 250 mm
- - Schweißnahtbreite 12 mm
- - Das Gewicht des Geräts beträgt 5 kg



ULTRASCHALL- ZERSTÖRUNGSGERÄT T 8 LITER

CODE: ULTRSNC-8

- Digitaler Ultraschallreiniger
- 8-Liter-Drahtkorb mit Ablasshahn
- Verschiedene Nutzungsmodi + Geräuscharmer Betrieb
- Einfache Reinigung
- ES VERFÜGT ÜBER EINEN HAHN UND ERMÖGLICHT EIN EINFACHES ENTLEREN.
- Sterilisations-Ultraschallreinigungsgerät
- Reinigen Sie alle Ihre Produkte mit Ultraschall-Vibrationswellen.

Durch Waschen schützen Sie es vor Korrosion und Abrieb und sorgen für eine gründliche Reinigung.

DIGITALES ULTRASCHALL-ZERSTÖRUNGSGERÄT 700 ml

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Açıklaması	Dijital Ultrasonik Temizleyici
Modeli:	CD-7940
Tank Kapasitesi	750 ml ±10% / 0.79 qt (ABD) Maks. 600 ml ±10% / 0.63 qt (ABD)
Tank Boyutları	14.9x12.7x4.6 cm / 5.9"x5.0"x1.8"
Güç Kaynağı	CD-7940: AC100V~ 50/60Hz, 26W AC100-120V~ 60Hz, 35W AC220-240V~ 50Hz, 50W
Dijital Zamanlayıcı Ayarları	(3dk) (5dk) (8dk) (1.5dk) (10dk) →180s → 300s → 480s → 90s → 600s
Ultrasonik Frekansı	CD-7940: 42 KHz ±10%
Tank Malzemesi	Paslanmaz Çelik SUS304
Gövde Malzemesi	ABS
Güç Kablo Uzunluğu (Yaklaşık)	1.5 m
Net Ağırlık	1.1 kg / 2.4 lb
Brüt Ağırlık	1.5 kg / 3.3 lb
Cihaz Boyutları	19.5x19.5x17.8 cm / 7.7"x7.7"x7.0"
İç Karton Boyutları	24.2x24.2x21.2 cm / 9.5"x9.5"x8.3"
Master Karton Başına Miktar	6 adet/karton
Master Karton Boyutları	75.0x26.0x45.0 cm/29.5"x10.2"x17.7"
Aksesuarlar	1 adet plastik sepet, 1 adet saat standı, 1 adet CD standı

CODE: ULTRSNC-700



STERILISATIONS-FORMALDEHYD- TABLETTE 800 Stk

CODE: FRM.800



- Es wird in 800 Kunststoff-Schutzhüllen präsentiert.
- Sterilisations- und Desinfektionsverfahren müssen von autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Es wird gemäß dem Verfahren und den Anweisungen verwendet.
- Formaldehydtabletten in geschlossenen, luftdichten Boxen
- Durch Wegwerfen einiger Teile können kleine Werkzeuge hergestellt werden.
- Es wird bei der Sterilisation verwendet.
- Produktname: Formaldehyd 800 Tabletten
- Abmessungen: 24 x 15 x 14 cm 1 kg
- Besonderheit: Gebrauchsfertiges Tablet in einer verschlossenen Plastikbox



**TROMMEL
MEDICINE**

CODE: TRM.24

- 24 LUKE MEDICAL TROMMEL
- STERILE GASKOMPRESSE
- STERILE HANDINSTRUMENTE
- STERILE GASBEUTEL
- STERILE Adern

Es stellt sicher, dass Produkte wie Produkte steril bleiben.

Abmessungen: 24 x 24 x 24 3 kg



**MEDIZINISCHES TABLETT MIT DECKEL
30 LUKS**

CODE: T.T.K-30

- MEDIZINISCHER EDELSTAHL
- STANDARDMODELL IM A4-GRÖSSE
- MIT EINER ABDECKUNG

GRÖSSE: 30 x 22 x 6 cm 0,750 Gr



**MEDIZINISCHE SCHÜSSEL
500 ml**

KOD: T.T.T-500

- MEDIZINISCHER EDELSTAHL
- LÖSUNGSSCHÜSSEL
- 400 ml



**MEDIZINISCHE
SCHÜSSEL 150 ML**

CODE: T.T.K-150

- MEDIZINISCHER EDELSTAHL
- LÖSUNGSSCHÜSSEL
- 150 ml

**MEDIZINISCHES GLAS
150 ML**

KOD: T.T.T-150



- MEDIZINISCHER EDELSTAHL
- LÖSUNGSGLAS
- 150 ml




**MEDIZINISCHES NIEREN-TAS
500 ml**

CODE: TBT-500

- MEDIZINISCHER EDELSTAHL
- LÖSUNG + TEILE BEHÄLTER 400 ML



0,3 mm Kalınlık x 100 mm Çap



3-FACH-GLAS-PETRIE

KOD: C.P-3X100

- 3 ABSCHNITTE
- KALIN CAM-MODELL
- PETRI-PFROPFSCHALE
- 100 mm x 100 mm

Transplantat-Petri-Kühler 150 mm


CODE: PTR.SĞTC-150



CAM PETRİ 100-120 mm


CODE: C.P-150

- TIBİ 150 MM CAM PETRİ
- ABDECKTES MODELL
- 150 x 150 ml




CODE: C.P-120

- TIBİ 120 MM CAM PETRİ
- ABDECKTES MODELL
- 120 x 120 ml



CODE: C.P- 100

- TIBİ 100 MM CAM PETRİ
- ABDECKTES MODELL
- 100 x 100 ml





Tragbarer UV-C-Kassettenautoklav

UVC - OTCLV-1

- Tragbare UV-C-Kassettenautoklav-Sterilisation in nur 3 Minuten
- ES BIETET DIE MÖGLICHKEIT, AUCH MIT DEM TELEFON ZU LADEN, DANK DES UNIVERSAL-LADEADAPTERS.
- ES ERMÖGLICHT IHNEN DIE STERILISATION ALLER IHRER PRODUKTE MIT KUNSTSTOFF, METALL, MIKROMOTOR, FUESTANZE, SAPHIRKLINGE usw. IN NUR 3 MINUTEN.
- Der tragbare Haartransplantations-Autoklav ist CE-/FDA-ROSH-zugelassen.
- Ultraviolette Wellenlänge: 253,7 Nm
- Arbeitsmethode; Es ist mit allen Telefonladegeräten kompatibel und Sie können es auch sterilisieren, indem Sie es direkt an die Steckdose anschließen.
- Es ist wirksam gegen alle Bakterien und Viren, einschließlich serologischer Erkrankungen (Hepatitis A - B - C - HIV 9), insbesondere Covid. Es bietet eine vollständige und sichere Sterilisation.
- Ergonomie; Es ist klein, mit elektronischem Summer ausgestattet, tragbar, kann während des Eingriffs in jedem Raum neben dem Prozessor platziert werden und bietet eine komfortablere Nutzung.
- Anwendung: Nachdem Sie es gereinigt (durch Entfernen von Blut usw.) und getrocknet haben, müssen Sie es nur noch hineinstellen und die Starttaste drücken. Darauf befinden sich Schilder und Sprachanweisungen.

GRÖSSE: 30 x 20 x 8 cm 350 g






SIZE ;
29 x 20 x 4 cm
21 x 16 x 4 cm
20 x 10 x 4 cm
19 x 8 x 4 cm

STERILISATIONSKASSETTE GROSSE GRÖSSE

GROSS: SKST-01 MITTEL: SKST-02 KLEIN: SKST -3

CODE: SKST-01 + 02 + 03

- MEDIZINISCHE
STERILISATIONSKASSETTE
- GROSSER JUNGE
- ES HAT EIN SPEZIELLES SILIKONBETT
- ES IST SPEZIELL FÜR DIE
HAARTRANSPLANTATION UND
PLASTISCHE CHIRURGIE HERGESTELLT.





STERILISATIONSKASSETTE

CODE: SKST-05

- Abmessungen: 16 x 7 x 2 cm
- Haartransplantationschirurgie
- Plastische Chirurgie

Es wird auf den Feldern
verwendet.

Die Sterilisationskassette ist eine
Sonderserie.



STERILISATIONSKASSETTE

CODE: SKST-05

- Abmessungen: 24 x 15 x 7 cm
- Haartransplantationschirurgie
- Plastische Chirurgie

Es wird auf den Feldern
verwendet.

Die Sterilisationskassette ist eine
Sonderserie.





MEDIZINISCHES UVC-STERILRAUMGERÄT 36 QUADRATMETER IST WIRKSAM

CODE: T.UVC-36

Die medizinische UV-C-Lampe für sterile Raumgeräte ist für 36 Quadratmeter wirksam.

- Entspricht der ärztlich zertifizierten Verordnung.
- Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Produkt mit kleinem und elegantem Design.
- Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör kann es überall montiert werden.



MEDIZINISCHES STAHLLINEAL 30 CM

KOD: T.Ç.C-30

- Medizinisches Mess- und Markierungslineal aus Stahl
- Es handelt sich um medizinischen Stahl
- Es ist 30 cm lang
- Ecken und Kanten sind oval geschliffen und hinterlassen keine Kratzer.
- Kann sterilisiert werden
- Es ist Edelstahl.



Medizinischer Stahlkamm, sterilisiert

CODE: T.T- 01

- Medizinischer Kamm aus Stahl
- Der Metallkamm ist ein autoklavierbares und sterilisierbares Modell.
- Mit seiner metallischen Struktur sorgt es für eine lange Nutzungsdauer.
- Verhindert Kontamination





GRAFT-SAMMLUNGSRING

KOD: GRFT.Y-01

- Transplantatring aus medizinischem Stahl
- 100 % medizinischer Stahl
- Die Größe des Fingerrings ist einstellbar
- Das größte Problem bei der Transplantatentnahme und -transplantation Entwickelt, um Ihr Assistent zu sein

GRAFTSAMMLLÖFFEL

CODE: GRFT.K-01

- Transplantatlöffel aus medizinischem Stahl
- 100 % medizinischer Stahl
- Die Größe des Fingerrings ist einstellbar
- Das größte Problem bei der Transplantatentnahme und -transplantation Entwickelt, um Ihr Assistent zu sein



Assistent zu sein



MEDIZINISCHE METALLSPÜRFLASCHE

CODE: MSSŞ-300

- Metallsprühflasche 300 ml
- Es handelt sich um einen Metallkörper
- Sterilisierbar - autoklavierbar
- Es handelt sich um ein medizinisches Modell, das den Vorschriften entspricht.



Medizinische, waschbare und desinfizierbare Rasiermaschine mit Batterie



KOD: TM.B-01

- MEDIZINISCHES MODELL + VOLLSTÄNDIG WASCHBAR
- KANN IN WASSER ARBEITEN
- ES IST BATTERIE
- ALLE GRÖSSEN UND SCHNITTNUMMERN SIND VERFÜGBAR
- Wirkt mindestens 120 Minuten

GRAFT-VORBEREITUNGSPADD AUS MEDIZINISCHEM SILIKON

CODE: GRFT.P.30

- Transplantatvorbereitungsset Silikon
- Kann sterilisiert werden
- Es ist das Produkt, mit dem Sie die Transplantate trennen, zählen und teilen können.



BLACK and GOLD MEDICAL

0,01 mm
mm ve inch



SAC EKİM ÖNCESİ PLANLAMA ÇİZİM CETVELİ
ELEKTRONİK DİJİTAL ÖLÇÜM

150 mm

DIGITALES MESSWERKZEUG

CODE: DJTL.KPS-01

- Digitales Maßlineal
- Es handelt sich um ein digitales batteriebetriebenes Messgerät, das bei Haartransplantationen und Botox-Füllungen oder Symmetriemessungen verwendet wird.



NOTFALL-HILFE-KIT

KOD: ERP.ES514-B

- Laryngoskop-Set
- Chirurgisches Set: Pinzette, Kraft, Skalpellgriff, portugiesische Schere
- PVC-Ambu-Seti
- automatisches Drehkreuz
- Intubationsschläuche
- Atemweg
- 1-Liter-Sauerstoffflasche und Manometer
- Maße: 33 x 45 x 15 cm
- Gewicht: 3 kg

GRAFT-VORBEREITUNGSPAD AUS MEDIZINISCHEM SILIKON

KOD: ERP.S514-E

- Aluminiumgehäuse
- Innenfächer
- Schwamm-Einlegesohle
- Schließsystem
- Maße: 33 x 45 x 15 cm
- Gewicht: 2 kg
- Wichtige Dokumente - Werkzeuge - Ihre Materialien

Sichere und geschützte Tasche für



HAARTRANSPLANTATIONSWERKZEUG - PENSET-SCHUTZTASCHE

CODE: PC-6

- ES IST FÜR DIE AUFBEWAHRUNG UND DEN TRANSPORT VON HAARTRANSPLANTATIONSZANGEN UND ÄHNLICHEN EMPFINDLICHEN GERÄTEN BESTIMMT.
- ES HAT 6 AUGEN
- Glatter Samt innen
- ES IST WEIBLICHE HAUT
- REISSVERSCHLUSSSYSTEM



HAARTRANSPLANTATIONSCHIRURGIE PATIENTENÜBERWACHUNGS-MONITOR- TRAGBARES MODELL



Code: HST.MNTR-

PO1 Merkmale:

- **SPO2, PR, NIBP, Körpertemperaturmessung:** Dieser Monitor ist in der Lage, SPO2 (Sauerstoffsättigung), Pulsfrequenz (PR), Blutdruck (NIBP) und Körpertemperatur (oC) zu messen und bietet so eine umfassende Patientenüberwachung.
- **Präzise Messung bei geringer Durchblutung:** Es kann selbst bei einer geringen Durchblutung von 0,05 % genaue Messungen durchführen und liefert so zuverlässige Ergebnisse in kritischen Situationen.
- **Perfusionsindex:** Die Messung des Perfusionsindex hilft Ihnen, den Perfusionsstatus detaillierter zu überwachen (der Perfusionsindex reicht von 0,05 % bis 20 %).
- **Geeignet für extreme Situationen:** Es kann auch in extremen Situationen wie Neugeborenenpatienten und Schock präzise Messungen durchführen, was einen vielseitigen Einsatz ermöglicht.
- **Zwei verschiedene Messmodi:** Sie können zwischen dem spontanen (sofortigen) und dem Überwachungsmodus wählen.
- **Datenspeicherung:** Mit der Datenspeicherfunktion können Sie auf historische Daten zugreifen und Diagrammtrends überwachen. Im Überwachungsmodus können Sie 48 Stunden lang ununterbrochen Daten empfangen.

SPO 2 PROBU DİJİTAL

CODE: STRP-01

- **Pulsoximeter Finger-** Sauerstoffmessgerät von Finger
- **Digitales Fingeroximeter 100 % GENAUES ERGEBNIS** Das Pulsoximeter ist ein Gerät, das auf einfachste und schnellste Weise Schläge pro Minute und Blutsauerstoffgehalt messen und auch aufzeichnen kann.





AUFBLASBARES HALSKISSEN

CODE: BYŞ.10

- AUFBLASBARES HALSKISSEN
- FARBOPTIONEN VERFÜGBAR
- SAMTIGE AUSSENFLÄCHE BIETET KOMFORT
- Dies ist die Art von bequemem Kissen, das Patienten für einen Zeitraum nach der Haartransplantation verwenden sollten.

HAARTRANSPLANTATIONS-STIRNBAND

KOD: SEB.50

- ÖDEME NACH HAARTRANSPLANTATION
- ES IST DAS KLEBEBAND, DAS VERWENDET WIRD, UM Durchhängen zu verhindern.
- SPEZIELLE ELASTISCHE STRUKTUR DRÜCKT NICHT - VERURTEILT KEIN UNBEQUEMUNGSGEFÜHL
- ES IST BREITBAND
- WASCHBAR



LANGHAARTRANSPLANTATIONS-CLIPS

CODE: SET.50

- METALL KANN STERILISIERBAR WERDEN
- ES WIRD VERWENDET, UM KOMFORTABLER UND KOMFORTABLER ARBEITSBEREICHE ZU SCHAFFEN, DURCH DAS SAMMELN DER HAARE WÄHREND LANGHAARTRANSPLANTATIONSVERFAHREN



50 Stück



C SILIKONKOPF

CODE: C.SB.01



- Es wird bei allen Operationen eingesetzt, die eine Kopfunterstützung erfordern.
- Haartransplantationschirurgie (HNO, Plastische Chirurgie, Allgemeine Chirurgie).
- Es war: 22 x 8,5 x 4,5 cm.
- Es besteht aus viskoelastischem Polymer.
- Es kann wiederverwendet und leicht gereinigt werden.
- Es ist wasserdicht und antistatisch.
- Es ermöglicht der Person, stundenlang in langfristigen Liegepositionen zu liegen, ohne dass die Haartransplantation gestört wird oder Spuren hinterlässt.

PURON POZİSYON EPEDİ

CODE: C.SB.02

- Es sorgt für die Luftzufuhr in Bauchlage des Patienten.
- Es war: 28 * 24 * 14 cm
- Es besteht aus viskoelastischem Polymer.
- Es kann wiederverwendet und leicht gereinigt werden.
- Es ist wasserdicht und antistatisch.

In der Puron-Position bei der Haartransplantation; Es ermöglicht Ihnen einen komfortablen Aufenthalt über längere Zeiträume.

Es ist völlig orthopädisch und hinterlässt keine Narben.



SPEZIELLES SILIKON-NALSSTÜTZPOLSTER

CODE: C.SB.03



- Es soll druckentlastend, schützend und unterstützend bei Diagnose, Behandlung und chirurgischen Eingriffen wirken.
- Es war 19 x 11 x 8 cm groß.
- Es besteht aus viskoelastischem Polymer.
- Es kann wiederverwendet und leicht gereinigt werden.
- Es ist wasserdicht und antistatisch.
- Es wird als Nackenstütze bei Haartransplantationen verwendet.
- Der Patient verspürt bei langen Eingriffen keine Beschwerden, sein Nacken schmerzt nicht und er kann stundenlang angenehm bewegungslos bleiben.



STERILER HAUTMARKIER- UND ZEICHNUNGSSTIFT

CODE: SCK-10

- FARBE: DUNKELBLAUES ZEICHNEN
- ES IST STERIL VERPACKT
- 1 MEDIZINISCHER MARKER-ZEICHNUNGSSTIFT
- ES GIBT 1 BESONDERES LINEAL.
- NACH DEM ÖFFNEN KANN ES BIS ZUM ABSCHLUSS DES AUFENTHALTS GENUTZT WERDEN.
- ES WIRD ZUM ZEICHNEN, MARKIEREN UND SCHREIBEN WÄHREND HAARTRANSPLANTATIONSVERFAHREN VERWENDET.
- ES WIRD AUCH ALS MARKIERUNGSSTIFT BEI ZEICHNUNGEN IN DER PLASTISCHEN CHIRURGIE, DER ALLGEMEINEN CHIRURGIE UND DERMATOLOGIE SOWIE BEI TÄTOWIERUNGSVERFAHREN VERWENDET.



STERILER HAUTMARKIER- UND ZEICHNUNGSSTIFT

CODE: CK-B.10

- FARBE: WEISSE ZEICHNUNG
- 1 MEDIZINISCHER MARKER-ZEICHNUNGSSTIFT
- ES GIBT 1 BESONDERES LINEAL.
- NACH DEM ÖFFNEN KANN ES BIS ZUM ABSCHLUSS DES AUFENTHALTS GENUTZT WERDEN.
- ES WIRD ZUM ZEICHNEN, MARKIEREN UND SCHREIBEN WÄHREND HAARTRANSPLANTATIONSVERFAHREN VERWENDET.
- ES WIRD AUCH ALS MARKIERUNGSSTIFT BEI ZEICHNUNGEN IN DER PLASTISCHEN CHIRURGIE, DER ALLGEMEINEN CHIRURGIE UND DERMATOLOGIE SOWIE BEI TÄTOWIERUNGSVERFAHREN VERWENDET.



STERILER HAUTMARKIER- UND ZEICHNUNGSSTIFT

CODE: CK-S.10

- FARBE: SCHWARZE ZEICHNUNG
- 1 MEDIZINISCHER MARKER-ZEICHNUNGSSTIFT
- ES GIBT 1 BESONDERES LINEAL.
- NACH DEM ÖFFNEN KANN ES BIS ZUM ABSCHLUSS DES AUFENTHALTS GENUTZT WERDEN.
- ES WIRD ZUM ZEICHNEN, MARKIEREN UND SCHREIBEN WÄHREND HAARTRANSPLANTATIONSVERFAHREN VERWENDET.
- ES WIRD AUCH ALS MARKIERUNGSSTIFT BEI ZEICHNUNGEN IN DER PLASTISCHEN CHIRURGIE, DER ALLGEMEINEN CHIRURGIE UND DERMATOLOGIE SOWIE BEI TÄTOWIERUNGSVERFAHREN VERWENDET.





BATIK TIRNAK ROBOTU

CODE: BTR-05

Wie benutzt man :

- Weichen Sie Ihre Füße vor der Anwendung des Produkts 15 Minuten lang in heißem Wasser ein.
- Befestigen Sie die beiden Arme des Werkzeugs nacheinander an den Kanten Ihres eingewachsenen Nagels.
- Befestigen Sie den mittleren Stützteil des Werkzeugs mit einer Hand an Ihrem Nagel und drehen Sie die Schraube des Stützteils, bis ein Gefühl der Ausdehnung entsteht (dieser Vorgang wird in heißem Wasser durchgeführt). Wiederholen Sie den Vorgang des Drehens und Spreizens der Schraube dreimal im Abstand von 10 Minuten für eine halbe Stunde, nehmen Sie dann Ihren Fuß aus dem heißen Wasser und trocknen Sie Ihre Nägel mit einem Fön.
- Entfernen Sie das Werkzeug und stützen Sie die korrigierten Teile, indem Sie Watte darunter legen.

Merkmale :

Es ist Edelstahl. + Verbiegt oder verdreht sich nicht.

Breite 2,5 cm / Länge 4 cm



13 X 9 X 3,5 CM

EISBATTERIE 13 CM


KOD: BZAK-13

- FARBE BLAU
- EISBATTERIE (ES IST MIT FLÜSSIGKEIT GEFÜLLT.)
- Maße: 13 x 9 x 3,5 cm
- 110 Gr

EISBATTERIE 32 CM

KOD: BZAK-32

- FARBE BLAU
- EISBATTERIE (ES IST MIT FLÜSSIGKEIT GEFÜLLT.)
- Maße: 32 x 30 x 1,4
- 1200 Gr





MOTORWARTUNGS- SCHMIERSPRAY

CODE: MB-S.500

Wie benutzt man :

- SPEZIELLE SPRÜHKOPFSPITZE IST BEFESTIGT,
- VOM ENDE DES MOTORS ODER VORSTART;
- 3 STOPFEN SIND FESTGEZOGEN. DER MOTOR LÄUFT 30 SEKUNDEN IM LEERLAUF. DAS IST ALLES.
- VERHINDERT DIE ÜBERHITZUNG DES MOTORS
- Reduzieren Sie die Geräusche, die vom Motor kommen
- UNTERSTÜTZT GESÜNDERES ARBEITEN OHNE GEHEN
- 500 ml



HC HairCharm




•Sodium	3-5mEq
•Potassium	3-5mEq
•Magnesium	0,3-0,5mEq
•Calcium	2-4mEq
•Phosphorous	1-2mEq
•Zinc (Çinko)	150-200mg
•Copper	10-20mg
•Iron	1mg
•Vitamin A	233units
•Vitamin C	6mg
•Vitamin D	66units
•Vitamin E	0,66units
•Vitamin B (Thiamine)	0,055mg
•Vitamin B2 (Riboflavine)	0,07mg
•Vitamin B3 (Niacine)	0,9mg
•Vitamin B5 (Pantothenic)	0,3mg
•Vitamin B6 (Pyridoxine)	0,05mg
•Biotine (Vitamin B7)	30mg
•Folic Acid (Vitamin B9)	8mg
•Vitamin B12 (Cyanocobalamine)	0,04mg

Sačınız için Gereklı Tım Vitamin ve Mineralleri İçerir

HAAR-MESOTHERAPIE

CODE: HC.HCRM-6X5

- HAARMESOTHERAPIE INVASIV
- MULTIVİTAMİN SERUMKOMPLEX



**UNSERE
VERTRIEBSHÄNDL**

Internationale Haarmedizin

ER

**Wenn Sie die notwendigen Voraussetzungen für
eine Vertriebspartnerschaft erfüllen, werden
Händler in andere Länder vergeben.**

*Kontaktieren Sie uns
für Details!*

EMAIL

info@internationalhairmedical.com

TELEFON

+90 539 662 8924 / +90 533 894 8843



**Internationaler Handel mit Haarmedizinprodukten.
Ltd. Şti.**

SEIT: 2020

*Es handelt sich um ein Produktions-, Herstellungs-, Vertriebs-, Händler-,
Groß- und Einzelhandelszentrum für Haartransplantationsgeräte und
Hilfsgeräte*

**INTERNATIONALE
ZERTIFIZIERT**

VERKAUFSBEHÖRDE

Wir bieten aktiven Versand in 61 Länder weltweit an, mit Ausnahme der Länder, in denen wir Vertriebshändler haben.

Unsere Sendungen werden direkt an die Adresse geliefert.

Obwohl es je nach Land unterschiedlich ist, werden unsere Lieferungen auf dem Luftweg innerhalb von 1-4 Tagen an die Adresse geliefert, unsere Lieferungen auf der Straße werden innerhalb von 7-14 Tagen an die Adresse geliefert, unsere Lieferungen auf dem See- und Landweg werden an die Adresse innerhalb von 7-14 Tagen geliefert 14-28 Tage.

Darüber hinaus bieten wir unseren Nutzern großen Komfort mit vielen offiziellen Zahlungsmethoden wie Kreditkarte, Debitkartenzahlung + Zahlung per Link + Banküberweisung.

Außer in den Ländern, in denen wir Vertriebshändler haben, sind schnelle Verkäufe auch über unsere Online-Website möglich.

Alle unsere Produkte verfügen über eine Rechnung und eine internationale Garantie.