

پزشکی بین المللی مو

کاتالوگ کاشت مو و زیبایی پزشکی



INTERNATIONAL HAIR MEDICAL

www.internationalhairmedical.com

Since 2020

ما خدمات سریع و قابل اعتمادی را با
شبکه خدمات گسترده خود در سراسر
جهان ارائه می دهیم

تلفن GSM (+90) 539 662 8924 / (+90) 533 894 8843

info@internationalhairmedical.com

ihm@internationalhairmedical.com آدرس وب

www.internationalhairmedical.com آدرس : Beylikdüzü /

Istanbul. Pk.34528





پزشکی بین المللی مو

شرکت ما

ما به عنوان گروه بهداشتی بلکاندگلد مدیکال با کادری حرفه ای بسیاری از محصولات پزشکی به ویژه کاشت مو و محصولات آرایشی و بهداشتی را با کیفیت / قیمت سریع و مقرون به صرفه به مشتریان گرامی عرضه می کنیم.

با هدف تخصص در فروش، بازاریابی و خدمات فنی، در بازاری که در آن حضور دارد؛ با قابلیت اطمینان، تجربه، سطح دانش فنی و خدمات پس از فروش توانسته است به شرکت برگزیده تبدیل شود.

گواهینامه CE / گواهینامه EC / ثبت اختراع نام تجاری ISO - گواهینامه های مطابقت TSE موجود هستند

موسسه ما؛ برای تولید و فروش مواد کاشت مو و محصولات زیبایی پزشکی مجاز و تایید شده است.

موسسه و کارمندان ما دارای گواهینامه فروش و مجوز تاسیس هستند.

همه محصولات ما که ما می فروشیم دارای ثبت UTS هستند.

موسسه ما با مدارک مربوطه و اطلاعاتی های لازم با همکاری سامانه ردیابی محصولات و دستورالعمل های مربوطه وزارت بهداشت در زمینه بهداشت عمومی و ایمنی محصول فعالیت می کند.

هر محصولی که از گروه بهداشتی بلک و طلایی مدیکال خریداری می کنید، کیفیت بررسی می شود،

مدارک تایید و مجوز اخذ می شود، اطلاع رسانی های لازم صورت می گیرد و سپس برای لذت و

استفاده به شما کاربران گرامی ارائه می شود.

100% ابزارهای جراحی پزشکی که استفاده می کنیم از فولاد طبی تولید می شوند. صحت آن توسط

اسناد پیوست ما تایید شده است.

دیدگاه ما

ما با توسعه محصولات با کیفیت، نوآورانه و متفاوت برای HEALTH که مهمترین ذینفع همه ماست، رویکرد خدماتی را بدون هیچ گونه مرزی به محیط زیست و جامعه به ویژه به شما کاربران گرامی ارائه می دهیم.

ماموریت ما

هدف ما این است که با دنبال کردن مداوم نوآوری ها و فناوری در بخش کاشت مو و زیبایی پزشکی، با ارائه محصولات کاربر محور، سازگار با محیط زیست و با کیفیت ترین راه حل، به کار خود به عنوان معتبرترین شرکت در جهان ادامه دهیم. مشتریان گرامی



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 13485:2016

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 13485:2016 Medikal Kalite Yönetim Sistemi Standartına uygunluğunu yerine getirdiği ve
AQC'ye belge verildiğini kabul eder. (This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 13485:2016 and
it bears its responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014520

İlk Belge Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date): 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date): 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration): 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.gov.tr. The certificate registration fees apply to our electronic registration system.



INTERNATIONAL HAIR MEDICAL
www.internationalhairmedical.com

Since 2020



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 9001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 9001:2015 standardına uygunluğunu yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 9001:2015 and
it bears its responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014521

İlk Belge Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date): 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date): 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration): 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.gov.tr. The certificate registration fees apply to our electronic registration system.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

ATTESTATIONS OF CONFORMITY
certifies that the company



SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

has been verified and recognized as
manufacturer of

**800watt Hair Transplantation Training Set, Graft Shocking Laser Set,
Hair Line Laser, Needle Free Anesthesia Device, Fox Punch Retractor or Straight,
Implantation Forceps, Dissection Forceps, Graft Impactor Pen, Fox Micro Motor,
Hair Analyzer Camera Microscope, Slide Handle, Hair Blade, Hair Transplantation
Chair, Loop Sizer, Sterilizer Forceps, Scissors, Heat Shield Box Set, Operation
Led Lamp, Hair Transplant Dressing Cream Set, Graft Tissue Transfer Barum**

according to the rules of
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and
of the Council of 5 April 2017 on medical devices

Certificate-no: 014522

The range of validity and details of the inspection can be taken from our
Report no. CP-301023

CE marking can be affixed on the product after the preparation of the necessary technical
documentation and the conformity declaration as well as the production control guaranteed
by the manufacturer and the provision of the other directive fulfilled if any

First Registration Date: 30.10.2023 Expiry Date: 30.10.2024
Certificate Date: 30.10.2023 Period of Registration: 1 years



Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.gov.tr. The certificate registration fees apply to our electronic registration system.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 45001:2018

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 45001:2018 standardına uygunluğunu yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 45001:2018 and
it bears its responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014518

İlk Belge Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date): 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date): 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration): 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.gov.tr. The certificate registration fees apply to our electronic registration system.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan Çevre yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 14001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN
ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 14001:2015 standardına uygunluğunu yerine getirdiği, ayrıca periyodik
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 14001:2015 and
it bears its responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014519

İlk Belge Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date): 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date): 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration): 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.gov.tr. The certificate registration fees apply to our electronic registration system.



(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI : SATURŖN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MANUFACTURER NAME : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL
ADRES : BULGARLIK PORTABİL
ADDRESS : STRELZIK PORTABLE

TIBBİ CİHAZIN ADI : SİNOF I EK B Kurul 2' e göre
DEVICE NAME : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)
GİRİŞ SINIFI :
PRODUCT CLASS : 33730

GİRİŞ KODU :
GDM CODE :
MODEL KODU :
MODEL CODE :
TEMEL ÜDÜ-DE :
BASIC ÜDÜ-DE :
UYGUNLUK DEĞ. NOTASYONU EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II - ANNEX III

Bu belge ile yukarıda belirtilen ürünün Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'ne (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici belgelerin tamamının firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre değerlendirilme yerine getirilmesi temininde değerlendirilir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745'tir.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfilment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 with:

EN 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CE MARKLAMA TARİHİ : 30.10.2023
START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023
TARİH YERİ, TARİH YERİ : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI : SATURŖN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MANUFACTURER NAME : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL
ADRES : BULGARLIK PORTABİL
ADDRESS : STRELZIK PORTABLE

TIBBİ CİHAZIN ADI : SİNOF I EK B Kurul 2' e göre
DEVICE NAME : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)
GİRİŞ SINIFI :
PRODUCT CLASS : 33730

GİRİŞ KODU :
GDM CODE :
MODEL KODU :
MODEL CODE :
TEMEL ÜDÜ-DE :
BASIC ÜDÜ-DE :
UYGUNLUK DEĞ. NOTASYONU EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II - ANNEX III

Bu belge ile yukarıda belirtilen ürünün Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'ne (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici belgelerin tamamının firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre değerlendirilme yerine getirilmesi temininde değerlendirilir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745'tir.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfilment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 with:

EN 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CE MARKLAMA TARİHİ : 30.10.2023
START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023
TARİH YERİ, TARİH YERİ : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI : SATURŖN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MANUFACTURER NAME : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL
ADRES : SOSSOR
ADDRESS : SOSSOR

TIBBİ CİHAZIN ADI : SİNOF I EK B Kurul 2' e göre
DEVICE NAME : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)
GİRİŞ SINIFI :
PRODUCT CLASS : 33730

GİRİŞ KODU :
GDM CODE :
MODEL KODU :
MODEL CODE :
TEMEL ÜDÜ-DE :
BASIC ÜDÜ-DE :
UYGUNLUK DEĞ. NOTASYONU EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II - ANNEX III

Bu belge ile yukarıda belirtilen ürünün Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'ne (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici belgelerin tamamının firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre değerlendirilme yerine getirilmesi temininde değerlendirilir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745'tir.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfilment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 with:

EN 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CE MARKLAMA TARİHİ : 30.10.2023
START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023
TARİH YERİ, TARİH YERİ : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI : SATURŖN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MANUFACTURER NAME : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL
ADRES : İMPLANTASYON KUVVETLERİ
ADDRESS : IMPLANTATION FORCES

TIBBİ CİHAZIN ADI : SİNOF I EK B Kurul 2' e göre
DEVICE NAME : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)
GİRİŞ SINIFI :
PRODUCT CLASS : 35796

GİRİŞ KODU :
GDM CODE :
MODEL KODU :
MODEL CODE :
TEMEL ÜDÜ-DE :
BASIC ÜDÜ-DE :
UYGUNLUK DEĞ. NOTASYONU EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II - ANNEX III

Bu belge ile yukarıda belirtilen ürünün Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'ne (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici belgelerin tamamının firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre değerlendirilme yerine getirilmesi temininde değerlendirilir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745'tir.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfilment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 with:

EN 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CE MARKLAMA TARİHİ : 30.10.2023
START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023
TARİH YERİ, TARİH YERİ : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI : SATURŖN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MANUFACTURER NAME : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL
ADRES : HAZIRLAMA LİZELERİ
ADDRESS : HAIR LINE LASER

TIBBİ CİHAZIN ADI : SİNOF I EK B Kurul 2' e göre
DEVICE NAME : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)
GİRİŞ SINIFI :
PRODUCT CLASS : 35796

GİRİŞ KODU :
GDM CODE :
MODEL KODU :
MODEL CODE :
TEMEL ÜDÜ-DE :
BASIC ÜDÜ-DE :
UYGUNLUK DEĞ. NOTASYONU EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II - ANNEX III

Bu belge ile yukarıda belirtilen ürünün Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'ne (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici belgelerin tamamının firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre değerlendirilme yerine getirilmesi temininde değerlendirilir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745'tir.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfilment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 with:

EN 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CE MARKLAMA TARİHİ : 30.10.2023
START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023
TARİH YERİ, TARİH YERİ : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI : SATURŖN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MANUFACTURER NAME : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL
ADRES : HAZIRLAMA LİZELERİ
ADDRESS : HAIR LINE LASER

TIBBİ CİHAZIN ADI : SİNOF I EK B Kurul 2' e göre
DEVICE NAME : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)
GİRİŞ SINIFI :
PRODUCT CLASS : 35796

GİRİŞ KODU :
GDM CODE :
MODEL KODU :
MODEL CODE :
TEMEL ÜDÜ-DE :
BASIC ÜDÜ-DE :
UYGUNLUK DEĞ. NOTASYONU EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II - ANNEX III

Bu belge ile yukarıda belirtilen ürünün Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'ne (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici belgelerin tamamının firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre değerlendirilme yerine getirilmesi temininde değerlendirilir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745'tir.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfilment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 with:

EN 13485:2016, EN ISO 14971:2019, TS EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019

CE MARKLAMA TARİHİ : 30.10.2023
START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023
TARİH YERİ, TARİH YERİ : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

پزشکی بین المللی مو

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR BLADE

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 1225

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : Graft Shaving Laser Set

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 5450

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : DHE DRYER PEN

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : V022 2582

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE PUNCH(SERRATED OR STRAIGHT)

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35289

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR TRANSPLANTATION CHAIR

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 38447

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : LOOP EYES

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : V022 4440

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE MICRO MOTOR

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 43915

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : EXTRACTION FORCEPS

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35798

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATÖRN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR ANALYSER CAMERA MICROSCOP

ÜRÜN SINIFI / (EN 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35798

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC UDD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONFORM. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

BAŞLANGIÇ YERİ / START OF CE MARKING : 30.10.2023

YERİ / PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

پزشکی بین المللی مو

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NAİL DRILL BOX SET
SINIF / (EK 8 Kural 1'e göre) / CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 3509S

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE : ÜRÜN İZLENİMİ ANNEKX II + ANNEKX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemur görüşmesi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/EN 15223-1, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLİZNDÜZ) YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NEEDLE FREE ANESTHESIA DEVICE
SINIF / (EK 8 Kural 1'e göre) / CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 11500

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE : ÜRÜN İZLENİMİ ANNEKX II + ANNEKX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemur görüşmesi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 11335:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/EN 15223-1, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLİZNDÜZ) YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : NAİL DRILL BOX SET
SINIF / (EK 8 Kural 1'e göre) / CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 3509S

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE : ÜRÜN İZLENİMİ ANNEKX II + ANNEKX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemur görüşmesi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/EN 15223-1, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLİZNDÜZ) YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE PUNCH/SERRATED OR STRAIGHT
SINIF / (EK 8 Kural 1'e göre) / CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35289

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE : ÜRÜN İZLENİMİ ANNEKX II + ANNEKX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemur görüşmesi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/EN 15223-1, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLİZNDÜZ) YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR TRANSPLANTATION CHAIR
SINIF / (EK 8 Kural 1'e göre) / CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 38447

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE : ÜRÜN İZLENİMİ ANNEKX II + ANNEKX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemur görüşmesi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR

EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/EN 15223-1, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLİZNDÜZ) YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)
(EU) 2017/745 DECLARATION
OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI / MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TİBBİ CİHAZIN ADI / DEVICE NAME : LOOP EYES
SINIF / (EK 8 Kural 1'e göre) / CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : Y022 44480

MODEL KODU / MODEL CODE : _____

TEMEL ÜD-DE / BASIC ÜD-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU / CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE : ÜRÜN İZLENİMİ ANNEKX II + ANNEKX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyan destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı, Ek 2'ye göre gerçekleştirilen yemur görüşmesi temelinde düzenlenmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile:

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR / URBELANAN STANDARTLAR

EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE MARKING/EN 15223-1, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZLİZNDÜZ) YER, TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR


Registration Certificate
ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - CERTİFİKA
ATTESTATIONS OF CONFORMITY
certifies that the company
SATURIN MEDICAL
SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL
has been verified and recognized as manufacturer of
Bilimsel ve Tıbbi Ürünlerin Üretimi ve Satışı İçin Kurulmuş Lisanslı Birim
This certificate has been awarded to the company
SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL
Uygulamakta olan yemur sistemini
To certify that the implemented management system complies with
ISO 13485:2016
Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla bu aşağıdaki kapsama vermiştir.
For the activities described below
HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND COSMETICS PRODUCTS
Bu belge, İsmo (CE) 13485:2016 Standardına göre değerlendirilmiştir. Bu belge, ISO 13485:2016 Standardına göre değerlendirilmiştir. Bu belge, ISO 13485:2016 Standardına göre değerlendirilmiştir.
This certificate is valid as long as it falls the requirements of the standard (CE) 13485:2016 and it is the responsibility of the company.
Sertifika No (Certificate No): 014522
The range of validity and details of the inspection can be taken from our Register, CE 13485
CE marking can be affixed on the product after the presentation of the necessary technical documentation and the conformity declaration as well as the production control guarantee.
By the manufacturer and the presence of the other directive fulfilled if any
Date Certificate Date : 30.10.2023 Expiry Date : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Bılgı Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
General Müdür / Executive Manager

Registration Certificate
ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - CERTİFİKA
Bu belge, İsmo (CE) 14001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir. Bu belge, ISO 14001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir. Bu belge, ISO 14001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir.
This certificate is valid as long as it falls the requirements of the standard (CE) 14001:2015 and it is the responsibility of the company.
Sertifika No (Certificate No): 014520
Date Certificate Date : 30.10.2023 Expiry Date : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Bılgı Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
General Müdür / Executive Manager

Registration Certificate
ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - CERTİFİKA
Bu belge, İsmo (CE) 9001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir. Bu belge, ISO 9001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir. Bu belge, ISO 9001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir.
This certificate is valid as long as it falls the requirements of the standard (CE) 9001:2015 and it is the responsibility of the company.
Sertifika No (Certificate No): 014521
Date Certificate Date : 30.10.2023 Expiry Date : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Bılgı Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
General Müdür / Executive Manager

Registration Certificate
ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - CERTİFİKA
Bu belge, İsmo (CE) 9001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir. Bu belge, ISO 9001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir. Bu belge, ISO 9001:2015 Standardına göre değerlendirilmiştir.
This certificate is valid as long as it falls the requirements of the standard (CE) 9001:2015 and it is the responsibility of the company.
Sertifika No (Certificate No): 014521
Date Certificate Date : 30.10.2023 Expiry Date : 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Bılgı Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024
General Müdür / Executive Manager

پانچ موتوریزه دوز فو



- فولاد درجه 1 آلمان استفاده می شود.
- اندازه گیری های مختلف قطر و طول موجود است.
- ثبت شده در UBB، تایید شده توسط وزارت بهداشت
- جراحی کم تهاجمی را ارائه می دهد
- ساختار نوک شارپ به خصوص کمترین حساسیت را در بافت ایجاد می کند
- حذف آسان فولیکول های پیوند را به ملایم ترین و بدون آسیب رساندن تضمین می کند.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	D625	D63	D635	D64	D65
0.6-5	D6525	D653	D6535	D654	D655
0.7	D725	D73	D735	D74	D75
0.7,5	D7525	D753	D7535	D754	D755
0.8	D825	D83	D835	D84	D85
0.8,5	D8525	D853	D8535	D854	D855
0.9	D925	D93	D935	D94	D95
0.9,5	D9525	D953	D9535	D954	D955
1	D125	D13	D135	D14	D15
1,1	D1125	D113	D1135	D114	D115
1,2	D1225	D123	D1235	D124	D125
1,3	D1325	D133	D1335	D134	D135



پانچ TIRTIKLI / YILDIZ Fue Motorize

- فولاد درجه 1 آلمان استفاده می شود.
- در 6 مدل دندان دار و 8 دندان دار موجود می باشد
- دندان زدن برگ و دندان اره موجود است
- اندازه گیری های مختلف قطر و طول موجود است.
- ثبت شده در UBB، تایید شده توسط وزارت بهداشت
- جراحی کم تهاجمی را ارائه می دهد
- ساختار نوک شارپ به خصوص کمترین حساسیت را در بافت ایجاد می کند
- حذف آسان فولیکول های پیوند را به ملایم ترین



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	T625	T63	T635	T64	T65
0.6-5	T6525	T653	T6535	T654	T655
0.7	T725	T73	D735	T74	T75
0.7,5	T7525	T753	T7535	T754	T755
0.8	T825	T83	T835	T84	T85
0.8,5	T8525	T853	T8535	T854	T855
0.9	T925	T93	T935	T94	T95
0.9,5	T9525	T953	T9535	T954	T955
1	T125	T13	T135	T14	T15
1,1	T1125	T113	T1135	T114	T115
1,2	T1225	T123	T1235	T124	T125
1,3	T1325	T133	T1335	T134	T135



Fue Punch Motorize (فرا ایمن) XS



- فولاد درجه 1 آلمان استفاده می شود.
- مدلی با نوک خمشی بیشتر به سمت بیرون است.
- اندازه گیری های مختلف قطر و طول موجود است.
- ثبت شده در UBB، تایید شده توسط وزارت بهداشت
- جراحی کم تهاجمی را ارائه می دهد
- ساختار نوک شارپ به خصوص کمترین حساسیت را در بافت ایجاد می کند
- حذف آسان فولیکول های پیوند را به ملایم ترین و بدون آسیب رساندن تضمین می کند.

□


ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	XS625	XS63	XS635	XS64	XS65
0.6-5	XS6525	XS653	XS6535	XS654	XS655
0.7	XS725	XS73	XS735	XS74	XS75
0.7,5	XS7525	XS753	XS7535	XS754	XS755
0.8	XS825	XS83	XS835	XS84	XS85
0.8,5	XS8525	XS853	XS8535	XS854	XS855
0.9	XS925	XS93	XS935	XS94	XS95
0.9,5	XS9525	XS953	XS9535	XS954	XS955
1	XS125	XS13	XS135	XS14	XS15
1,1	XS1125	XS113	XS1135	XS114	XS115
1,2	XS1225	XS123	XS1235	XS124	XS125
1,3	XS1325	XS133	XS1335	XS134	XS135



0.08 mm

Tip Length 5 mm

36 mm

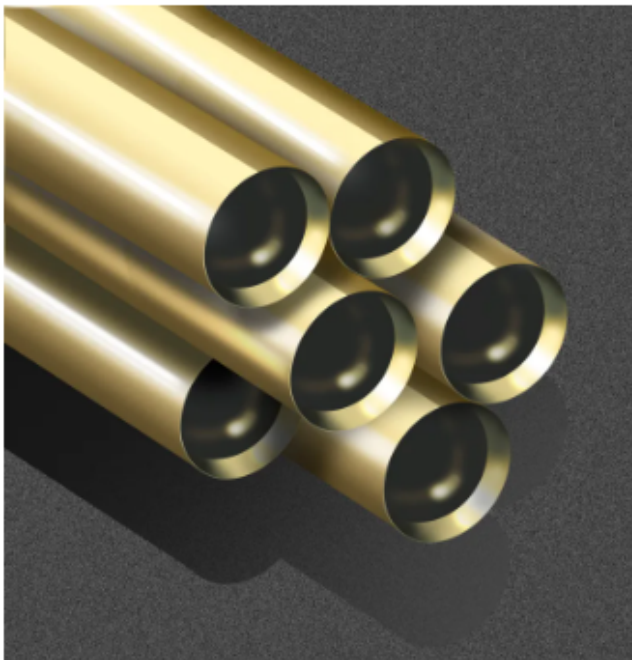

فیو پانچ موتوری برای موهای بلند

- فولاد درجه 1 آلمان استفاده می شود.
- نوک به طور خاص با شیارهایی ساخته شده است تا از شکستن موهای بلند جلوگیری شود.
- اندازه گیری های مختلف قطر و طول موجود است.
- ثبت شده در UBB، تایید شده توسط وزارت بهداشت
- جراحی کم تهاجمی را ارائه می دهد
- ساختار نوک شارپ به خصوص کمترین حساسیت را در بافت ایجاد می کند
- حذف آسان فولیکول های پیوند را به ملایم ترین و بدون آسیب رساندن تضمین می کند.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	US625	US63	US635	US64	US65
0.6-5	US6525	US653	US6535	US654	US655
0.7	US725	US73	US735	US74	US75
0.7,5	US7525	US753	US7535	US754	US755
0.8	US825	US83	US835	US84	US85
0.8,5	US8525	US853	US8535	US854	US855
0.9	US925	US93	US935	US94	US95
0.9,5	US9525	US953	US9535	US954	US955
1	US125	US13	US135	US14	US15
1,1	US1125	US113	US1135	US114	US115
1,2	US1225	US123	US1235	US124	US125
1,3	US1325	US133	US1335	US134	US135





IHM 25 RED هندپیس دوبل

1 عدد هندپیس استاندارد
1 هندپیس فلزی چرخش راست -
چپ
35000 دور در دقیقه سازگار با
110 - 220 وات



هندپیس دوبل

استفاده ارگونومیک
هندپیس سبک هندپیس
جایگزین هندپیس بی صدا



IHM25 قرمز

هندپیس فلزی نشستی ندارد. ماندگاری طولانی، استفاده آسان، هندپیس دستی، بسیار بی صدا و سبک وزن. این به شما امکان می دهد ریشه های پیوند سالم تری استخراج کنید و شما را خسته نمی کند.





IHM 25 PINK

هندپیس دابل

1 عدد هندپیس استاندارد
1 هندپیس فلزی چرخش راست -
چپ
35000 دور در دقیقه سازگار با
110 - 220 وات



هندپیس دابل

استفاده ارگونومیک
هندپیس سبک هندپیس
جایگزین هندپیس بی صدا



IHM25 PINK

هندپیس فلزی نشستی ندارد. ماندگاری طولانی، استفاده آسان، هندپیس دستی، بسیار بی صدا و سبک وزن. این به شما امکان می دهد ریشه های پیوند سالم تری استخراج کنید و شما را خسته نمی کند.




ماراتن H37 L

هندپیس استاندارد
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ با زغال سنگ، هوا
خنک کننده امکان کنترل دست و پا
سازگار با 110 - 220 وات

H 37 L

رنگ: خاکستری خاستگاه: کره وزن:
236 گرم خنک کننده: خنک کننده
هوا سیستم زغال سنگ




ماراتن H 37 L

امکان کنترل دست و پا
35000 دور در دقیقه سرعت
چرخش قابل تنظیم چرخه کاری
راست و چپ



قوی 210

هندپیس استاندارد
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ با زغال سنگ، هوا
خنک کننده امکان کنترل دست و پا
سازگار با 110 - 220 وات



قوی 210

رنگ: سفید منشاء: کره وزن: 236
گرم خنک کننده: خنک کننده هوا
سیستم زغال سنگ



Mikromotor FUE MOTOR

Saç-qaş aktımı için cihaz
40000 abarot



قوی 210

امکان کنترل دست و پا
35000 دور در دقیقه سرعت
چرخش قابل تنظیم چرخه کاری
راست و چپ





اسکورت 2 پرو SH20N

هندپیس با نوک فلزی
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ امکان کنترل دست و
پا با هوا خنک سازگار با 110 - 220
وات

SH 300

رنگ: سفید اصل: کره وزن: 190
گرم خنک کننده: خنک کننده هوا



Complete set



قهرمان SH20N

امکان کنترل دست و پا
35000 دور در دقیقه سرعت
چرخش قابل تنظیم چرخه کاری
راست و چپ



IHM GRİ

کد: MBOX.IHM-GRİ

هندپیس با نوک فلزی
30000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ امکان کنترل دست و
پا با هوا خنک سازگار با 110 - 220
وات



IHM GRİ

کد: MBOX.IHM-SYH

هندپیس با نوک استاندارد
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ امکان کنترل دست و
پا با هوا خنک سازگار با 110 - 220
وات



او آبی

کد: MBOX.IHM-MV

هندپیس با نوک استاندارد
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ امکان کنترل دست و
پا با هوا خنک سازگار با 110 - 220
وات





صحبت کردن با او

کد: MBOX.IHM-KRMZ

هندپیس با نوک فلزی
30000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ امکان کنترل دست و
پا با هوا خنک سازگار با 110 - 220
وات



قطعات فلزی سیاه

کد: MBOX.IHM-MTL

هندپیس با نوک استاندارد
30000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ امکان کنترل دست و
پا با هوا خنک سازگار با 110 - 220
وات



دستگیره آبی مشکی

کد: MBOX.IHM-MV-01

هندپیس با نوک استاندارد
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ امکان کنترل دست و
پا با هوا خنک سازگار با 110 - 220
وات





M BOX KORE

کد: MBOXK

هندپیس با نوک فلزی
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ گزینه کنترل دست و
پا با هوا خنک کننده حساسیت به
دست ارگونومیک سازگار با 110 -
220 وات



کد: MBOXM

M BOX METAL PIASEMEN

رنگ: سفید - آبی - قرمز - مشکی اصل:
کره وزن: 170 گرم خنک کننده: خنک
کننده هوا



M BOX - کره

امکان کنترل دست و پا
35000 دور در دقیقه سرعت
چرخش قابل تنظیم چرخه کاری
راست و چپ



سفید + آبی + قرمز + سیاه

کد: MBOX.B MBOXM MBOXK MBOXS



K38

Portable type
Digital speed window

MH20

Max. 30,000rpm
130g

میکرو موتور سوخت قابل حمل قابل شارژ

کد: MH20K38

هندپیس با نوک فلزی
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ تا 6 ساعت استفاده با
شارژ کامل صفحه نمایشگر
دیجیتال اتصال پایه کمر بند سازگار
با 110 - 220 وات

میکرو موتور قابل شارژ قابل حمل

رنگ: سفید - سبز - قرمز - مشکی اصل:
کره وزن: 170 گرم خنک کننده: خنک
کننده هوا



میکرو موتور سوخت قابل حمل

کد: MMŞRJ-01

نشانگر صفحه نمایش دیجیتال
35000 دور در دقیقه سرعت
چرخش قابل تنظیم چرخه کاری
راست و چپ





میکرو موتور سوخت دیجیتال HMI

کد: BLCK-01 D

هندپیس با نوک فلزی
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ نشانگر نمایشگر
دیجیتال
190 گرم هندپیس امکان کنترل
دست و پا سازگار با 110 - 220
وات

میکرو موتور سوخت دیجیتال HMI

رنگ: سفید اصل: کره وزن: 190 گرم
خنک کننده: پنل دیجیتال خنک کننده هوا



میکرو موتور سوخت دیجیتال HMI

میکرو موتور FUE Profosyonel





HMI دیجیتال فیو میکرو موتور S200

کد: BLCK-01 D

هندپیس با نوک فلزی
35000 دور در دقیقه چرخش
راست - چپ نشانگر نمایشگر
دیجیتال
190 گرم هندپیس امکان کنترل
دست و پا سازگار با 110 - 220
وات



HMI دیجیتال فیو میکرو موتور S200

رنگ: سفید اصل: کره وزن: 190 گرم
خنک کننده: پنل دیجیتال خنک کننده هوا



Hand
Knee
Foot



Fwd
Rev



Standby
Working




HMI دیجیتال فیو میکرو موتور S200 میکرو موتور FUE Profosyonel





KOD:OSLSYN-D.01

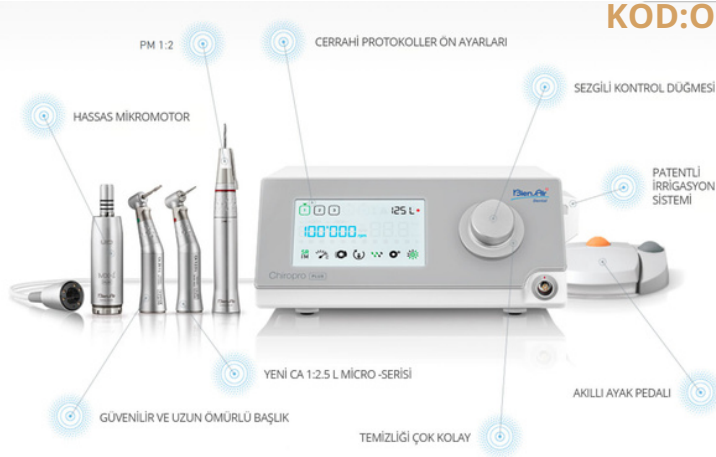

میکرو موتور Chiropro Plus Osilasyonlu Fue

حرفه ای ترین میکرو موتور شناخته شده
Chiropro Plus
50000 دور در دقیقه راست - چرخش
چپ اسکولاسیون - جلو-عقب 360 درجه
برای داشتن ریشه موهای بلند بهترین
است. گزینه های سر متعدد هستند

میکرو موتور Chiropro Plus Osilasyonlu Fue

مجموعه کابل و هندپیس اتوکلاو

مجموعه حرفه ای جراحی



میکرو موتور Chiropro Plus Osilasyonlu Fue

امکان شستشوی محل کار با مایع -
سرم را فراهم می کند





Marathon - Strong ve
با Universal Handpiece
ورودی 3 پین، سوکت گرد،
سازگار با تمام موتورها



RPM 35000 چرخش راست چپ مدل
زغال سنگ هوا خنک
260 گرم

هندپیس جایگزین سایز
جهانی

مدل H 37 L



marathon

مدل H 37 L





S 30 PIYASEMEN



- Dimensions : L129 x Ø22 (mm)
- Speed : 0 - 30,000 rpm
- Max. Torque : 2.9 Ncm
- Weight : 143g
- Cord length : 1.5m

کد: Y.PYSMN.M-01

RPM 35000 چرخش راست چپ مدل
زغال سنگ هوا خنک
260 گرم

S 30 PIYASEMEN



S 30 PIYASEMEN





نوک هندپیس قابل اتوکلاو



RPM 40000 چرخش راست چپ مدل
زغال سنگ هوا خنک
95 گرم



نوک هندپیس
استریل شده اتوکلاو
فلزی

کابل هندپیس قابل اتوکلاو



RPM 40000 چرخش راست چپ مدل
زغال سنگ هوا خنک
95 گرم



کابل هندپیس قابل اتوکلاو



بنیاد N 30



کد: YP.N30

30000 دور در دقیقه چرخش راست چپ
- هوا خنک سازگار با همه موتورها با
ورودی 160 گرم + یونیورسال

NBOX IHM جایگزین هندپیس
قرمز

کد: YP.MBOX-BLACK.KRMZ

30000 دور در دقیقه چرخش راست چپ
- هوا خنک سازگار با همه موتورها با
ورودی 160 گرم + یونیورسال



قطعه جایگزین NBOX IHM
PIECE BLACK

کد: YP.MBOX-BLACK.SYH

30000 دور در دقیقه چرخش راست چپ
- هوا خنک سازگار با همه موتورها با
ورودی 160 گرم + یونیورسال





در مورد آن فکر کنید

ساختار نوک فورسپس جمع آوری و حذف گرفت سری طلا می تواند به طور ویژه تولید شود. برای آسیب رساندن به فولیکول های پیوند طراحی شده است.



IHM Toplama Penseti



Gold Serisi Toplama Penseti Size Tablosu

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755

استخراج طلا





DHI - CHOI PEN LAYING / PLACING PENSE

سری طلایی DHI PEN SERIES FORCET اجازه می دهد تا پیوند به راحتی در قلم قرار داده شود. با دستگیره ارگونومیک خود استفاده آسانی را ارائه می دهد و دست را خسته نمی کند.



UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755



Gold Thi Implanter Pen Array / Insertion Forcep



فورسپس پیوند طلا

فورسپس پیوندی سری طلایی
 ما 100% فولاد ضد زنگ پزشکی
 است. گزینه دستگیره نوک
 شخصی. ساختار نوک طول
 نوک گزینه های زاویه نوک
 موجود است.
 فورسپس های سری طلا متعلق
 به برند ما هستند.

سری طلایی نیروهای مشاهده

- سری طلا
- طول نوک
- زاویه نوک
- درجه سختی: گرفتن
- ساختار نکته

گزینه هایی دارد


UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT





فورسپس پیوندی دسته سوراخ دار طلا

فورسپس پیوندی سری طلای ما 100% فولاد ضد زنگ پزشکی است. گزینه دستگیره نوک شخصی. ساختار نوک طول نوک گزینه های زاویه نوک موجود است. فورسپس های سری طلا متعلق به برند ما هستند.

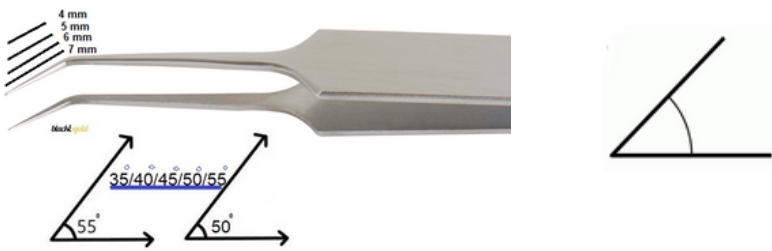


نیروهای مشاهده کننده دستگیره سوراخ شده

- سری طلا
- طول نوک
- زاویه نوک
- درجه سختی: گرفتن
- ساختار نکته

گزینه هایی دارد

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT



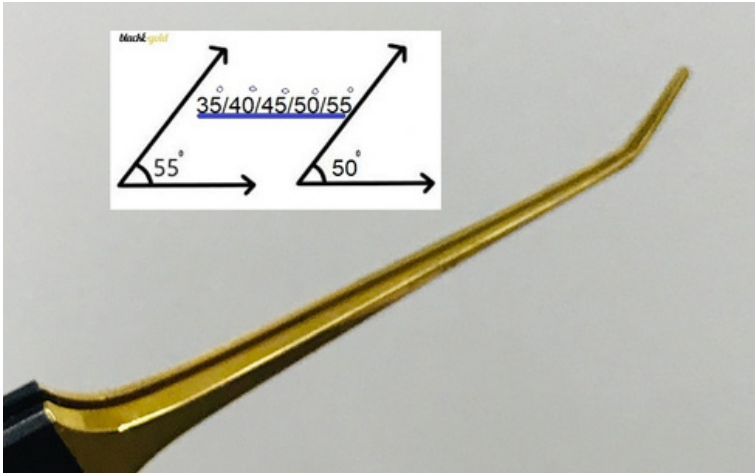


فورسپس پیوندی مدل سرامیکی

فورسپس کاشت سری سرامیکی ما

دستگیره دستگیره با پوشش
سرامیکی;

- باعث تعریق نمی شود
- ضد الکتریسیته ساکن است و
- باعث ایجاد برق نمی شود
- نوک طلاکاری شده به پیوند نمی چسبد
- فرصت کاشت آسان و سالم را فراهم می کند

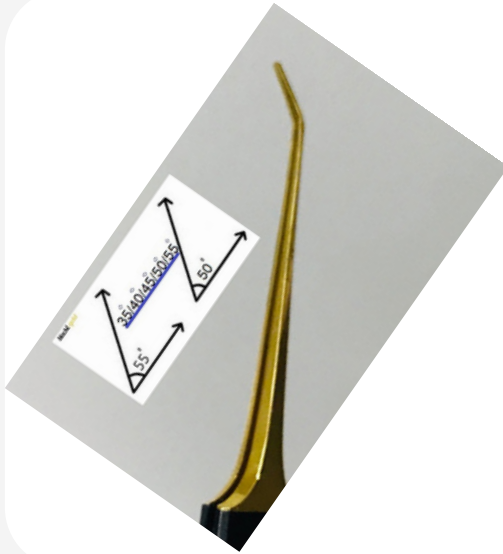

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT








فورسپس پیوندی مدل تیتانیوم



این مدل تیتانیومی است.
سبک تر و بادوام تر است

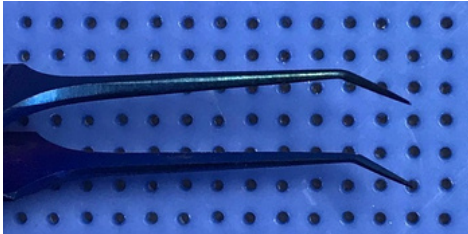

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	IĞNE	TOPUZ	KÜNT

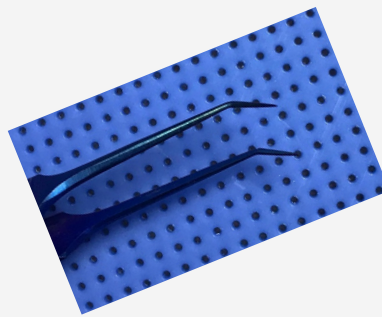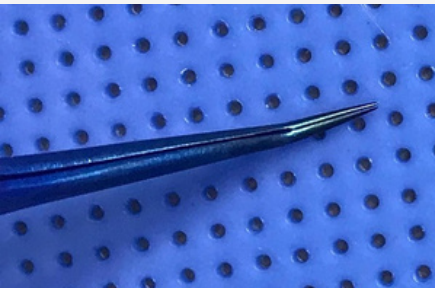




سری فورسپس قمر تیتانیوم کد: TAP-01

سری تیتانیومی است. برای چندین سال استفاده مناسب است. می توان آن را استریل کرد. این یک محصول قابل استفاده مجدد از نظر پزشکی است. برای اهداف متداول در پیوند - جمع آوری - تراز یا قرار دادن قلم ذی استفاده می شود.

انبردست است

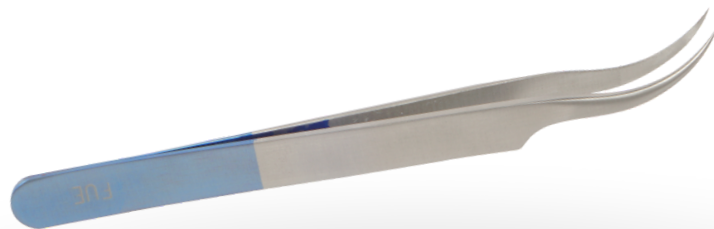

سیاه و طلایی مداد است






فورسپس آرایه طلا

سری طلاست.
 برای چیدمان و جداسازی فولیکول
 ها در گرفت های پیشانی طراحی
 شده است.
 ساختار نوک نازکی دارد که به
 بافت آسیب نمی رساند. این 100%
 فولاد ضد زنگ پزشکی است.

مبل صندلی

نوک سوزن مستقیم سری GOLD
 آرایه فورسپس

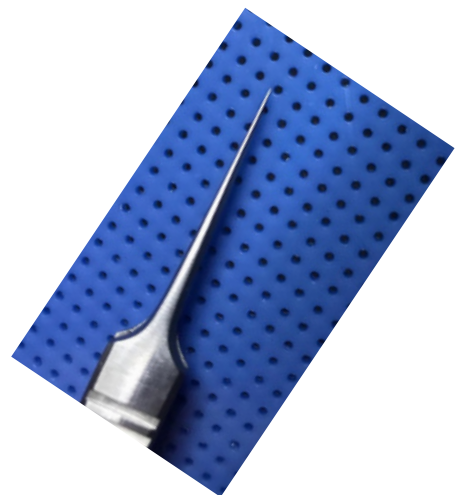



دسته اسلاید نوع قلم کد: STH-K



- سری طلاست
- دارای نوک الماسی است. نمی لغزد.
- دارای چاقوهای کشویی در هر اندازه
- طول آن 15 سانتی متر است
- وزن آن 50 گرم است
- با گیره فشرده سازی خود، نگه داشتن ایمن را فراهم می کند
- دارای نوک الماسی است که امکان فشرده سازی در یک زاویه را فراهم می کند.
- ارگونومیک و استفاده آسان را ارائه می دهد

دستگیره قفل کننده دستگیره کشویی کد: STH-DK

- سری طلاست.
- انواع تیغه های لغزنده، از جمله سرسره های ضخیم تر را محکم می گیرد و هرگز رها نمی کند.
- دارای سر نوک الماسی است
- مورد استفاده در جراحی پلاستیک و جراحی کاشت مو
- دستگیره افقی یک طراحی عالی برای کسانی است که عادت کار دارند.



دستگیره سرسره استاندارد کد: STH-SM

- سر الماس سری طلا
- تیغه اسلاید همه اندازه ها را نگه می دارد
- طول آن 14 تا 15 سانتی متر است
- اسکروول نمی کند
- مورد استفاده در جراحی مو و جراحی پلاستیک
- این 100% فولاد ضد زنگ پزشکی است





FUE PUNCH و دسته سوزن دستی کد: MFPH-02

- سری طلاست
- اندازه جهانی پانچ توتار بود
- اندازه جهانی نوک سوزن را نگه می دارد
- دارای سر فشرده سازی قابل تنظیم است
- برداشت دستی پیوند
- در عملیات باز کردن دستی کانال از راه پوست با وارد کردن سوزن استفاده می شود.
- دسته دندانه دار چسبندگی آسان و بدون لغزش را فراهم می کند
- این 100% فولاد ضد زنگ پزشکی است



چاقو - دسته سوزن کد: MFPH-01

- بدنه آلومینیومی
- سر فشرده سازی قابل تنظیم
- 4-سر فشاری زاویه دار
- مواد پزشکی بدون زنگ زدگی
- در عملیاتی که با نگه داشتن سوزن و چاقو انجام می شود استفاده می شود.
- کاشت مو - خالکوبی - شیارهای از راه پوست و جراحی پلاستیک زمینه های اصلی استفاده هستند.



دستگیره BİSTÜRİ کد: BSTR-15


- 100% فولاد پزشکی
- با تیغه های مقیاس شماره 11-15 سازگار است
- از آنجایی که یک نوع قلم است، فرصت کار بسیار راحت و راحت را ارائه می دهد





نگهدارنده یاقوت کبود

نگهدارنده یاقوت کبود مدل
تیتانیوم با تمام اعداد سازگار
است و یک مدل با اندازه جهانی
است

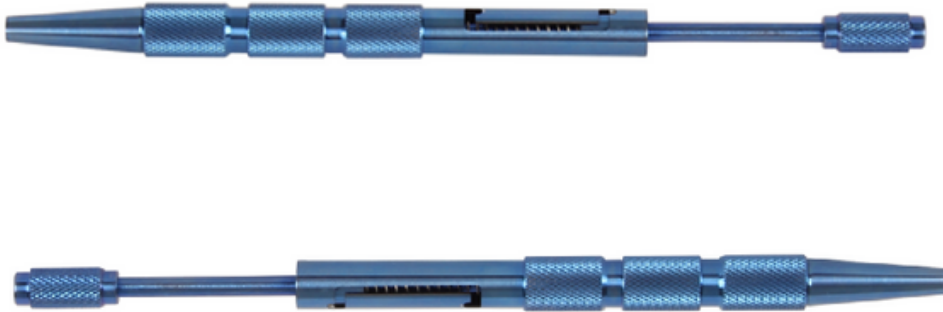

تیغه های یاقوت کبود

- تیغه های یاقوت کبود مدل های اصلی هستند.
- یونیورسال با همه قلم ها سازگار است
- AUTOCLAVABLE - استریل شده
- ضد آلرژی
- مینیمال ترومای بافتی با حداقل برش
- بازیابی بسیار سریعتر
- شماره ها برای شما در دسترس است



اندازه :

- 1.5 - 1.4 - 1.3 - 1.2 - 1.1 - 1
1.7 - 1.6






تیغه مخصوص
استریل SP 90



تیغه کوچک SP
90

- 0.8 میلی متر
- 0.9 میلی متر
- 1.0 میلی متر
- 1.1 میلی متر
- 1.2 میلی متر
- 1.3 میلی متر
- 1.4 میلی متر
- 1.5 میلی متر
- 1.6 میلی متر
- 1.7 میلی متر

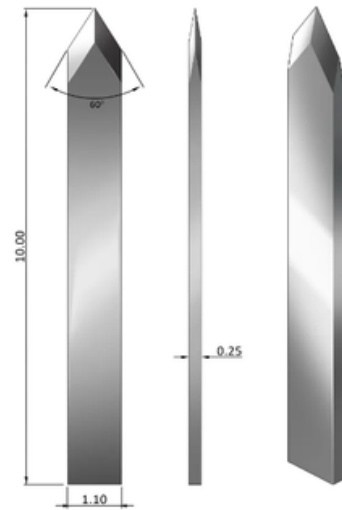

تیغه های شیار



لغزنده از قبل
برش خورده


با دستگاه های مخصوص برش
خورده و کاملا صاف و تیز است.
محتوای بسته: 25 عدد



OKT Choi قلم Implanter

- قلم کاشت موی پزشکی است
- در کاشت موی طبیعی استفاده می شود
- فرصت کاشت متراکم و مکرر را فراهم می کند
- کاشت راحت تر است
- امکان جهت دادن در هنگام قرار دادن هر ریشه
- می تواند استریل شود
- این یک محصول قابل قبول است فقط سوزن ها با کدر شدن عوض می شوند.
- موجود در جعبه های 10 تایی
- اعداد مختلفی وجود دارد
- کاشت مو
- ساکل اپیکمی
- کاشت ابرو

OKT'nin 10 Avantajı

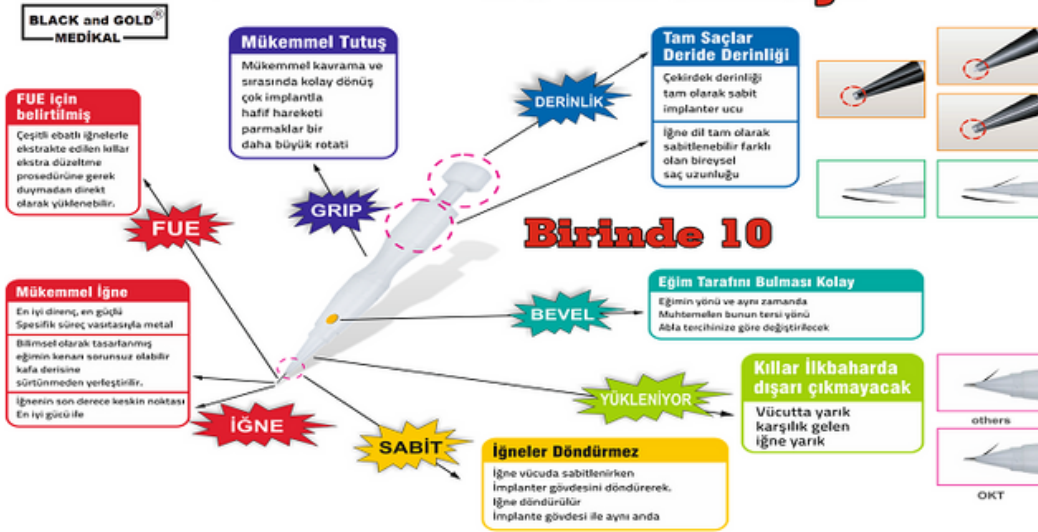


ایمپلنت OKT Dhi

با چرخاندن دایره در ناحیه دستگیره نوک سوزن تنظیم می شود.
چرخش به چپ: نوک سوزن را گسترش می دهد.
چرخش به راست: نوک سوزن را کوتاه می کند



MAVi - 0.9 میلی متر
قرمز - 1.02 میلی متر

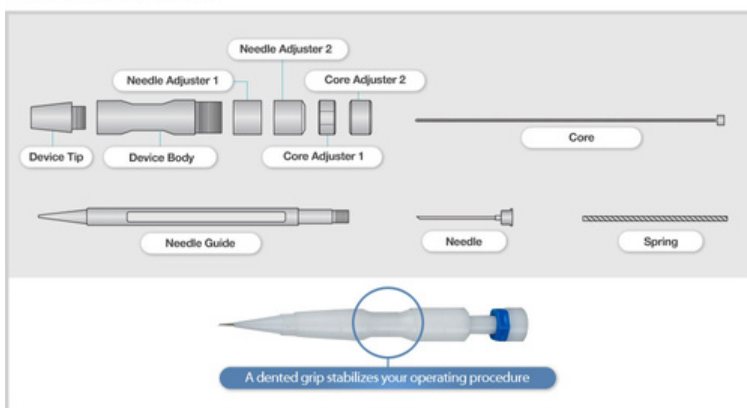

OKT DHI KALEM NUMARALARI

آبی: مناسب برای پیوندهای تک و دوتایی
در خط جلویی مو، سفت کردن، کاشت ریش و ابرو استفاده می شود.
قرمز: مناسب برای 1-2-3-4-5 گرافت
در کشت فشرده استفاده می شود.

نکته: اکثر اوقات یک ست شامل 4 عدد آبی + 6 عدد قرمز است.

مبدأ: کره



MAVI: 0.8 میلی متر



قلم ایمپلنت INCURAM

- قلم کاشت موی پزشکی است
- در کاشت موی طبیعی استفاده می شود
- فرصت کاشت متراکم و مکرر را فراهم می کند
- کاشت راحت تر است
- امکان جهت دادن در هنگام قرار دادن هر ریشه
- می تواند استریل شود
- این یک محصول قابل قبول است
- فقط سوزن ها با کدر شدن عوض می شوند.
- موجود در جعبه های 10 تایی
- اعداد مختلفی وجود دارد
- کاشت مو
- ساکل ایکیمی
- کاشت ابرو

بی دقتی در مورد ایمپلنت

0 میلی متر

با چرخاندن دایره در ناحیه دستگیره نوک سوزن تنظیم می شود. چرخش به چپ: نوک سوزن را گسترش می دهد. چرخش به راست: نوک سوزن را کوتاه می کند



سفید: 1 میلی متر





قلم ایمپلنت INCURAM

- قلم کاشت موی پزشکی است
- در کاشت موی طبیعی استفاده می شود
- فرصت کاشت متراکم و مکرر را فراهم می کند
- کاشت راحت تر است
- امکان جهت دادن در هنگام قرار دادن هر ریشه
- می تواند استریل شود
- این یک محصول قابل قبول است
- فقط سوزن ها با کدر شدن عوض می شوند.
- موجود در جعبه های 10 تایی
- اعداد مختلفی وجود دارد
- کاشت مو
- ساکل ایکیمی
- کاشت ابرو



سوزن یدکی 0.8 : incuram BLUE میلی متر



سوزن یدکی 0.8 : incuram RED میلی متر





**INCURAM
Implanter Pen**
سوزن یدکی

سوزن زاپاس incuram: سفید 1 میلی متر



سوزن زاپاس incuram BLACK: 1.1 میلی متر



محتوای جعبه: 10 قطعه قابل استریل مناسب برای استفاده مجدد از فولاد پزشکی Incuram نوک سوزن مشاء: کره.


توجه: سفید و آبی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند



1.1 میلی متر 1.0 میلی متر 0.9 میلی متر 0.8 میلی متر



قیچی جراحی

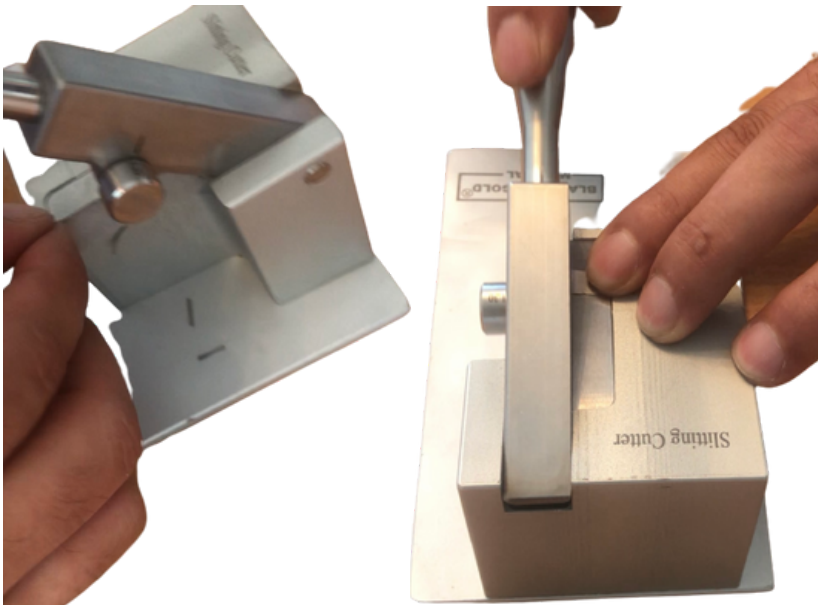

- فولاد پزشکی
- سری طلا
- نوک الماس
- از یک طرف نازک
- طرف دیگر استاندارد است
- برش کشویی
- تزئین
- جراحی
- در زمینه ها استفاده می شود

دستگاه های برش کشویی

- بدنه استنلس استیل پزشکی
- سر الماس دو طرفه
- برش صاف
- به عدد دلخواه برش دهید
- برش در زاویه دلخواه
- شما می توانید اسلاید خود را طراحی کنید و آن را به هر اندازه و طولی که می خواهید برش دهید.
- می تواند حداقل 5000000 تیغه کشویی صاف را برش دهد.





واحد واکسیناسیون پیوند یخ آبی


- حجم محفظه داخلی 10 پتریل
- محفظه خنک کننده محدوده 4-12 درجه
- تنظیم نسبت رطوبت بافت
- تنظیم نسبت PH بافت
- پیشگیری از عفونت با کابینت ضد عفونی
- تکان دهنده پیوند و واکسیناسیون + مزوتراپی دادن پیوند با موتور واکسیناسیون

مهمتر از همه، همه این رویه ها. این امکان را برای مدیریت و نظارت از پانل دیجیتال فراهم می کند

این یک دستگاه تایید شده با تست پالینی با CE + ISO + GS1 + EC + گواهی انطباق اتحادیه اروپا است

- حجم داخلی بزرگ
- کنترل دیجیتالی کلیه عملیات
- سیستم هشدار در صورت وقوع رویدادهای منفی با آلام صوتی


پیوندهای گرفته شده با این دستگاه تضمین می کند که آنها می توانند در شرایط طبیعی خود سالم بمانند، درست مانند بافت های زنده. با شوکه کردن فولیکول های فرسوده و تبدیل شدن به پیوندهای خسته در طول فرآیندها، از افزایش نرخ بقا پشتیبانی می کند. از بهبود پیوندهای ایجاد شده بسیار سریعتر و چسبندگی آنها به بافت پشتیبانی می کند. این روش، سالم ترین + قابل اطمینان ترین + طبیعی ترین روش کاشت مو را ارائه می دهد.

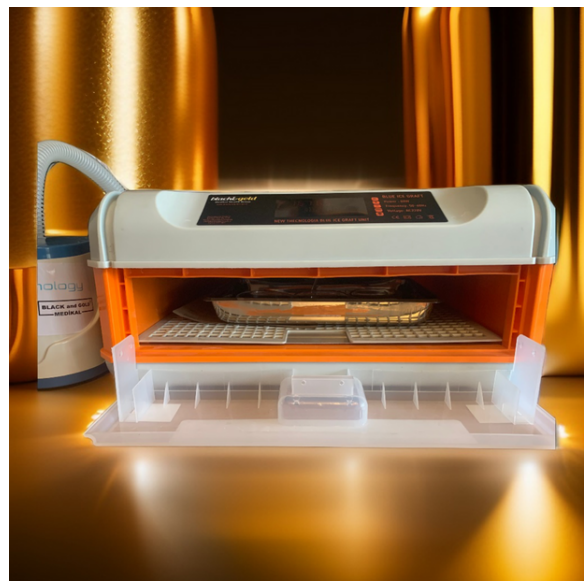

ابعاد

60 × 60 × 30 سانتی متر KOLI
 16 کیلوگرم TOTAL AGIRLIK
 220 / 110 W کار ضد عفونی UVC

- محتویات جعبه
- دفترچه راهنمای کاربر
- ضمانت نامه
- موتور پیوند
- واحد اصلی
- دفترچه راهنمای کاربر
- راهنمای توضیحات محصول

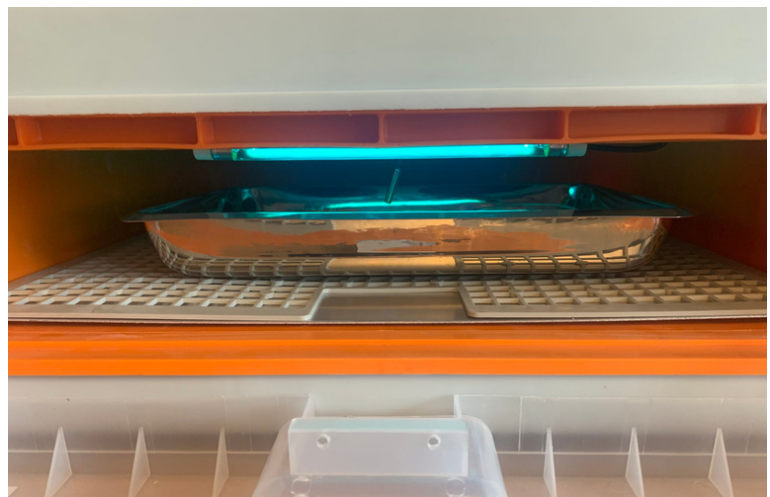



DERMOJET

تزریق و بیهوشی بدون درد



قابل استریل شدن محفظه داروی 5 سی سی دارد، مواد مصرفی ندارد، محصول پزشکی است، دارو را بگذارید و استفاده کنید، سوزن ندارد، با فشار کار می کند. وقتی تاج را می کشید و رها می کنید، فشار خودش را ایجاد می کند.

دستگاه بیهوشی بدون درد

استفاده ارگونومیک، بدون ترس از سوزن، بدون درد، صرفه جویی در زمان با استفاده سریع، بدون خونریزی، روشی راحت را ارائه می دهد





قلم بیهوشی ویبره

6000 در دقیقه
موج ارتعاشی

- 6000 لرزش در دقیقه را ارائه می دهد
- با باتری کار می کند
- با لمس ناحیه نزدیک به ناحیه درست قبل از تزریق فعال می شود. از آنجایی که مغز انسان ارتعاش را سریعتر و زودتر درک می کند، اطمینان حاصل می کند که بیمار ورود سوزن را احساس نمی کند.
- به نوعی مغزمان را فریب خواهیم داد.

دستگاه بیهوشی ویبره

- کاربردهای بیهوشی
- کاربردهای تزریق
- کاربردهای واکسیناسیون
- برنامه های پرکننده
- کاربردهای بوتاکس

حوزه های اصلی استفاده



قلم بیهوشی ویبره
طلایی



حرفه ای

کد: Mcrskp.01



تهیه پیوند + میکروسکوپ آماده سازی فولیکولی

توضیحات محصول:

1. صفحه نمایش: مجهز به صفحه نمایش LCD 7 اینچی، سنسور CMOS 26 مگاپیکسلی، بزرگنمایی دیجیتال 2100 برابر، ارائه تصاویر با صافی و وضوح کنتراست خوب.
2. میکروسکوپ: میکروسکوپ دارای یک لنز سر شیبدار 45 درجه و یک لوله چشمی چرخان 360 درجه است که از زوم 6.5:1 پشتیبانی می کند و از هم تراز دقیق و کاهش خستگی بینایی اطمینان می دهد.
3. کار خوب: همه اجزای شیشه نوری از لنزهای شیشه ای دقیق، مواد آلیاژ آلومینیوم با سختی بالا، شکاف مردمک قابل تنظیم، پشتیبانی از رابط چند رسانه ای با کیفیت بالا و خروجی ویدیوی USB استفاده می کنند.
4. نور حلقه ای: مجهز به نور حلقه میکروسکوپ فشرده، روشنایی بدون سایه شدید و متمرکز با جهت و شدت روشنایی قابل تنظیم را فراهم می کند، می تواند برای مدت طولانی استفاده شود.
5. کاربرد گسترده: روش های تجزیه و تحلیل پزشکی + کاشت مو روش های جداسازی پیوند + روش های استخراج و معاینه فولیکول پیوند



امکانات:

نوع میکروسکوپ: میکروسکوپ استریو Trinocular جنس: آلیاژ آلومینیوم، میکروسکوپ Trinocular ABS ویژگی ها: هدف میکروسکوپ کاتوکل سه چشمی چرخان 360 درجه با چشمی قابل کج 45 درجه: میدان دید فوق عریض 30 میلی متر/1.18 اینچ WF10X/20 با لنز بزرگنمایی بالا + لنز هدف: 0.7-4.5 برابر محدوده زوم: 6.5:1 + نقطه اتصال Trino: تقریباً پورت نوری 23 میلی متر/0.91 اینچ فاصله مردمک: تقریباً 2 1/8 اینچ تا 3 اینچ (54-76 میلی متر) + میدان دید: تقریباً 1 1/4 اینچ (33 میلی متر) فاصله کاری: 7X-45X (100 میلی متر/3.94 اینچ)، 7X-90X (40 میلی متر/1.57 اینچ) لنز شبی 2.0 برابر نصب روی سر: تقریباً قطر 3 اینچ (76 میلی متر) + تناسب نصب: تقریباً قطر 1 7/8 اینچ (48 میلی متر نخ داخلی).

ویژگی های دوربین میکروسکوپ 7 اینچی: سنسور تصویر: سنسور CMOS 26 مگاپیکسلی با وضوح بالا

محتویات جعبه:

میکروسکوپ + سر روشنایی LED + صفحه دیجیتال ال سی دی + پد کار سیلیکون ضد خش + کابل های متصل + اتصال دوربین میکروسکوپ + کابل های متصل + آداپتور

ابعاد: 30*30*25 سانتی متر اندازه جعبه وزن جعبه 8 کیلوگرم



میکروسکوپ پیوند + آنالیز فولیکول

کد: MCRSKP.02

1 برای جراحی کاشت مو؛

- جداسازی پیوند
- تصویربرداری فولیکول
- تمدن ریشه
- مو به دنبال تجزیه و تحلیل

میکروسکوپ دیجیتال با میز کار نور LED و صفحه نمایش بهترین دستیار شما در عملیاتی مانند

میکروسکوپ دیجیتال سه بعدی اچ دی



نمایش جلوه سه بعدی را ارائه می دهد لوازم جانبی قابل تنظیم: براکت، صفحه نمایش LCD و نور LED دوگانه را می توان آزادانه تنظیم کرد

پردازش تصویر و کنترل از راه دور مادون قرمز لنز با کیفیت بالا و سنسور CMOS حساس + تصویر به سرعت از روی صفحه نمایش داده می شود و عمق خوبی دارد. + فیلتر UV روی لنز نیز به کاهش انعکاس کمک می کند. 8 چراغ LED قابل تنظیم داخلی: به جز 2 چراغ LED در دو طرف پایه، چراغ های تعبیه شده در لنز باعث می شود که چراغ ها کافی تر شوند. شما می توانید آزادانه دیافراگم تمام چراغ های LED را تنظیم کنید.

تصویربرداری و ضبط: می توانید با استفاده از کنترل از راه دور یا دکمه روی صفحه، عکس بگیرید و فیلم ضبط کنید (فیلم ها و تصاویر را می توان در کارت micro SD که حداکثر 32G را پشتیبانی می کند ذخیره کرد) جزئیات:

سنسور تصویر: سنسور 2 مگا پیکسل HD خروجی ویدئو: FHD1920x1080 30FPS; HD1280x720 30FPS فرمت ویدئو:

MOV بزرگنمایی: تا 100 برابر وضوح عکس: 1920X1080 فرمت عکس: JPG محدوده فوکوس: 6CM-18CM نرخ فریم:

حداکثر. ذخیره سازی 30f/s: میکروسکوپ-کارت SD، تا 32G منبع تغذیه: 5V DC منبع نور: LED داخلی و LED 2 روی پایه

اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ اندازه پایه: 19cm * 12cm * 20cm گواهی: CE / FCC / بسته RoHS شامل: میکروسکوپ 1 ×

پایه فلزی 1 × + دستورالعمل 1 × کنترل از راه دور مادون قرمز 1 × + کابل سوئیچ 1 × آداپتور برق 1 × + فیلتر UV × 1

درپوش لنز 1 × داده بسته بندی 32 * 22 * 10 سانتی متر / 1 کیلوگرم



مجموعه آنالیز حرفه ای کد: AK.01


اتصال بی سیم وای فای تلفن +
تبلت + مانیتور کامپیوتر و اتصال
تلویزیون برقرار است

شما می توانید سوابق بیمار خود را
به صورت خودکار ذخیره کنید.
شما می توانید با یک کلیک بر روی
تبلت یا دوربین عکس و فیلم ضبط
کنید. دارای تنظیمات LIGHT +
ZOOM + FOCUS
همراه با نرم افزار نصب



توضیحات مدل حرفه ای آنالیزر مو و پوست

- تبلت 10.1 اینچی + صفحه کلید بی سیم + پوشش محافظ ویژه + حافظه خارجی
- عکس گرفتن ویژگی مشاهده فوری با یک کلیک
- قابلیت قبل - بعد از ضبط
- نمایشگر بی سیم 1600 پیکسلی قابل تنظیم و بزرگنمایی صفحه نمایش
- دوربین هوشمند وای فای بی سیم
- نگهدارنده تبلت قابل تنظیم سه پایه ایستاده (قابلیت تنظیم ارتفاع و 360 درجه)
- بسته تضمین Genpa Türkiye + تضمین پزشکی Blackandgold

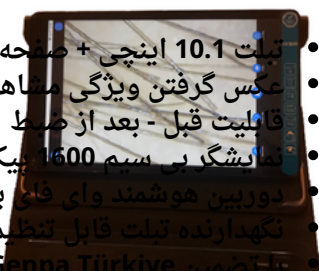


این امکان را به بیماران شما می دهد تا با استفاده مستقیم از قرص ها، تجزیه و تحلیل مو و پوست را بسیار راحت تر انجام دهند.
این فرصت را برای گرفتن عکس و فیلم ضبط شده در طول تجزیه و تحلیل ارائه می دهد.
نتایج واضحی در مورد جهت، تراکم، تعداد گرافت ها و خواص پیوند فولیکول های مو نشان می دهد.
در صورتی که فرد دارای بیماری پوستی باشد، متخصص را راهنمایی می کند.
این به اندازه گیری بصری میزان چربی پوست کمک می کند. به وضوح ساختار پوست را تجسم می کند و تصویری عمیق ارائه می دهد.

ابعاد جعبه: 20 x 10 x 20 سانتی متر وزن 650 گرم



دوربین آنالیز USB کد: AK.02


USB متصل است
دوربین 1600 X مو و پوست آنالیز

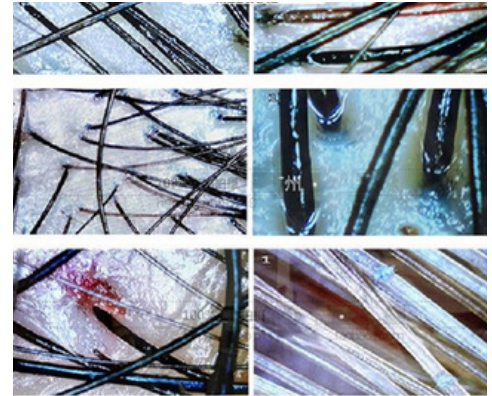

اتصال USB تلفن + تبلت + کامپیوتر

دستگاه اتصال سازگار با تلفن دیجیتال 1000 X - 1600 X USB مو و پوست در مجموعه موجود است.

- آنالیزر مو و پوست 1000 X USB Digital
- انتقال تصویر متصل به USB
- راه اندازی آسان

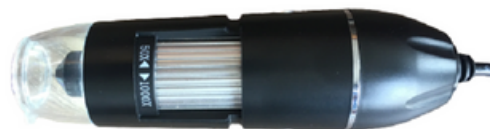


دوربین آنالیز پوست و مو

توضیح:


- دفترچه راهنمای کاربر
- آداپتور شارژ
- دوربین 1600X
- آداپتور اتصال تلفن + تبلت

ابعاد: اندازه جعبه 15*10*7 سانتی متر
وزن 340 گرم



درموتوسکوپ با نور LED

کد: DRM-01

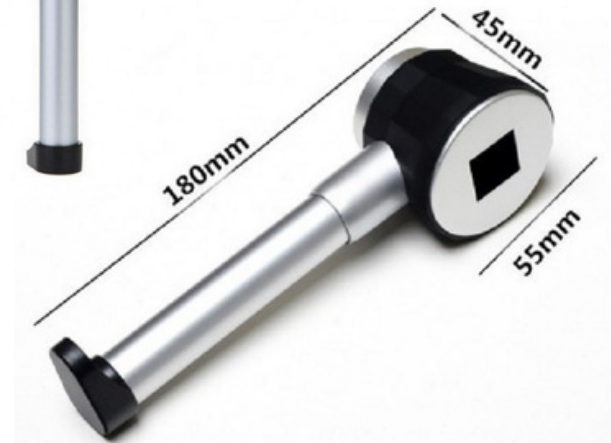

SCALALI MAGNIFICENT

کد: DRM-02

ذره بین Scala روشن شده نوع پوست مورد استفاده در آنالیز پوست توضیحات: 15 x 5 x 5 سانتی متر 250 گرم



درموتوسکوپ ال تیپی

کد: DRM - 03

نسبت بزرگنمایی 40X - دقت اندازه گیری: دقت مقیاس 0.05 میلی متر
روشنایی: نور LED سفید رنگ: سفید استفاده:
برای انجام آنالیزهای عمیق منطقه ای در پوست و جراحی پلاستیک
استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل عمیق تشکیلات عمیق در پوست،
لایه چربی و پوست استفاده می شود.
مقیاس قطر کل: قطر کل 4 میلی متر ابعاد: 140 x 45 x 23 میلی متر 350
گرم محدوده بسته بندی
1 ذره بین، 1 کیف حمل چرمی، منبع تغذیه + 2 باتری قلمی (در جعبه موجود
نمی باشد).





عینک های لیزری

کد: LGZLK-01



توضیحات محصول ؛

مجموعه ای از عینک های مورد استفاده در دستگاه های لیزر مورد استفاده در مراکز کاشت مو و رشته های زیبایی - زیبایی پزشکی است. مراکز کاشت مو

بخش های زیبایی پزشکی عینک های محافظ موهای زائد سالن لیزر 200-1200 نانومتر 200 نانومتر - 1200 نانومتر

ست عینک پردازش لیزری

کد: LGZLK-02

ست عینک فرآیند لیزری
توضیحات محصول ؛

مجموعه ای از عینک های مورد استفاده در دستگاه های لیزر مورد استفاده در مراکز کاشت مو و رشته های زیبایی - زیبایی پزشکی است. در مجموعه 2 لیوان یکی برای بیمار و دیگری برای کاربر وجود دارد.

مراکز کاشت مو بخش های زیبایی پزشکی سالن لیزر اپیلاسیون

عینک محافظ 200-1200 نانومتر-200 نانومتر - 1200 نانومتر



عینک بیمار عمل لیزر

کد: LGZLK-03

عینک های بیمار پردازش لیزری مناسب برای عمل های زیبایی و لیزر طول موج محافظت از عینک های بیمار آرایشی: 190 نیوتن متر تا 2000 نیوتن متر تمام طول موج؛ از 5+ مواد پلاستیکی جاذب به طور گسترده در لیزر و میدان کیهانی استفاده می شود.

IPL LAZER

DANIŞAN KORUYUCU GÖZLÜK

SIYAH





عینک حلقه ای

LUP-01

- ذره بین
- لنز ترکیبی انعطاف پذیر با بزرگنمایی بالا
- نور قابل تنظیم بالا و پایین
- سر پیچ قابل تنظیم بالا و پایین
- لنز دوگانه با نسبت زوم 3 برابری
- تسمه سرپوش دار به راحتی قابل تنظیم و گسترش است
- لنز: 1.8x, 2.3x, 3.7x, 4.8x



عینک حلقه ای

LUP-02


- ذره بین سری 9 امکانات
- Büyütme: 1x, 1.7x, 2x, 2.5x, 4.5x
- جنس: شکم، اکریلیک، ذره بین از نوع پوشیدنی
- دو تکه لامپ سوپر led + باتری: 2 قلمی استفاده کنید؛
- روشن با استفاده از لنزهای بزرگنمایی نوع سر 5
- می توان از 2 لنز به طور همزمان استفاده کرد
- در همان زمان می تواند به قدرت 8 برابر برسد.
- مواد ABS و لنز اکریلیک شفاف.
- هدبند به راحتی قابل تنظیم است.



عینک حلقه ای

LUP-03

- زوم 3 برابر تنظیم ارگونومیک هدبند
- تنظیم زاویه لنز

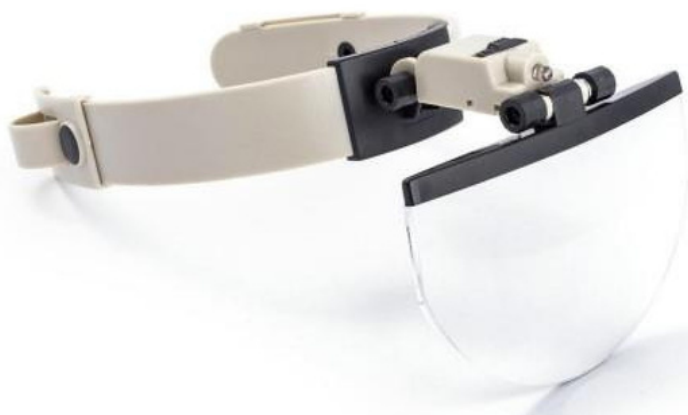

عینک حلقه ای

LUP-04



عینک ذره بین چراغ دار LED نوع کلاه ذره بین 9x زوم 5 لامپ سر لنز ذره بین روشن 5 2 LED لنز نوع کلاه ذره بین (زوم 9 برابر).
 به لطف ویژگی بزرگنمایی لایه به لایه، به شما این امکان را می دهد که اشیاء را با تمام جزئیات آنها ببینید.
 به لطف 5 لنز مختلف، می توانید از لنزها بر اساس نیاز خود استفاده کنید.
 لنزها دارای قابلیت زوم 1.5x - 2x - 2.5x - 3.5x هستند.
 زوم اضافی را فراهم می کند زیرا توانایی اضافه کردن جدید لنز به کلاه را دارد.
 لنز ترکیبی انعطاف پذیر، نسبت بزرگنمایی بالا، نور قابل تنظیم بالا و پایین، شیشه قابل تنظیم در دو نقطه مختلف بالا و پایین. بخش ها و زمینه های استفاده:
 • کلینیک های کاشت مو - متخصصین کاشت مو
 • مراکز زیبایی
 • مشخصات فنی:
 • لامپ LED + کار با 3 باتری از راه دور + سر قابل تنظیم
 • 5 لنز با ویژگی های زوم مختلف
 • بسته شامل:
 • 1 کلاه + 5 لنز در جعبه + 3 باتری ریموت
 • ابعاد لنز: ابعاد لنز هر 10.8 سانتی متر عرض 4 سانتی متر ارتفاع
 • ابعاد کلاه: عرض: 17.6 سانتی متر عمق: قابل تغییر ارتفاع: قابل تغییر
 استفاده ارگونومیک را ارائه می دهد + یک مدل سبک وزن و مفید است. این ویژه برای روش های کاشت مو و مداخلات پزشکی زیبایی شناسی مشابه است.

عینک حلقه ای

LUP-05

ذره بین سری 5
 3 لنز ذره بین حرفه ای یدکی مدل شارژی LED
 روشنایی حرفه ای استفاده ارگونومیک را ارائه
 می دهد مدل سبک وزن و مفید ویژه کاشت مو
 و مداخلات پزشکی زیبایی شناسی مشابه.



عینک حلقه ای

LUP-06

نوع سر با 4 لنز بزرگنمایی یدکی + هدبند
 قابل تنظیم عینک حلقه قابل تنظیم
 مفصل متحرک.



عینک حلقه ای

LUP-07



روشنایی بسیار بهتر با ویژگی LED دوگانه * 5 لنز یدکی با ویژگی های بزرگنمایی متفاوت.
* اندازه لنز 1.0X - 1.5X - 2.0X - 2.5X - 3.5X * طراحی ارگونومیک زیبا که هیچ گونه ناراحتی برای سر ایجاد نمی کند.
* تولید ویژه از مواد کربن تیتانیوم ضد حساسیت با کیفیت درجه یک.
این خودکار با 3 باتری تغذیه می شود.

ابعاد جعبه: 24 × 20 × 7 سانتی متر 380 گرم


عینک حلقه ای

LUP-08

روشنایی بسیار بهتر با ویژگی * 5 LED لنز یدکی با ویژگی های بزرگنمایی متفاوت.
* اندازه لنز 1.0X - 1.5X - 2.0X - 2.5X - 3.5X * طراحی ارگونومیک زیبا که هیچ گونه ناراحتی برای سر ایجاد نمی کند.
* تولید ویژه از مواد کربن تیتانیوم ضد حساسیت با کیفیت درجه یک.
سبک ترین مدل است



GÖZLÜK TİP LED IŞIKLI BÜYÜTEÇ 8X / 15X VE 23 X



عینک حلقه ای

LUP-09

نوع سر با 4 لنز بزرگنمایی یدکی + هدبند قابل تنظیم مفصل متحرک نور قابل تنظیم


- بزرگنمایی 10 برابر
- بزرگنمایی 15 برابر
- بزرگنمایی 20 برابر
- بزرگنمایی 25 برابر



OPTIVISOR

OPTVZR-01

ذره بین
Blue
Professional نوع
با 5 لنز یدکی

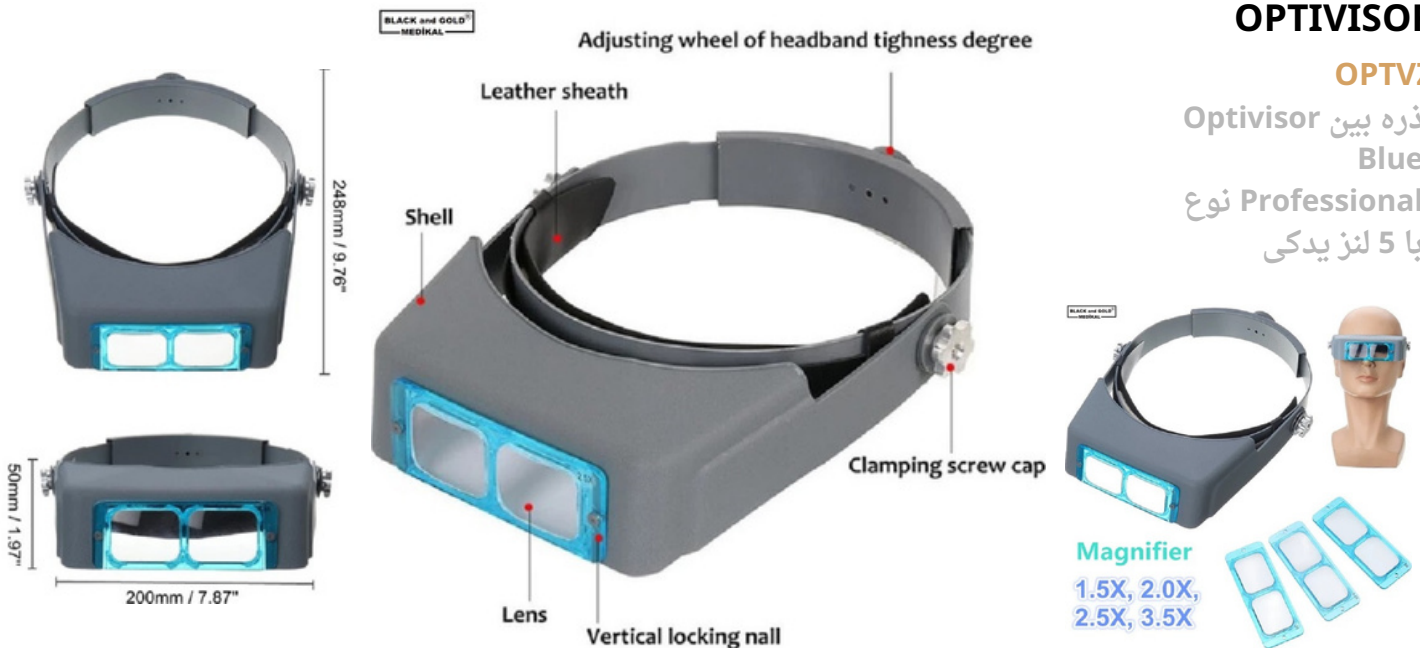

لامپ LED قابل تمرکز با باتری

کد : BTRYL.01

- لامپ ال ای دی کاشت مو قابل شارژ، قابل فوکوس
- طراحی ارگونومیک و شیک دارد
- سبک است و سر را سنگین نمی کند
- LED قابل تنظیم و متحرک است
- باتری لیتیومی دارد و با شارژ می توان از آن استفاده کرد.
- با یک بار شارژ به طور متوسط 4-5 ساعت استفاده را ارائه می دهد
- مشکل قطع برق را حل می کند
- نور LED دید حرفه ای عالی را ارائه می دهد



عینک ایمنی

KGZLK-01

عینک های Reasuble محافظ را می توان ضد عفونی کرد. برای استفاده مجدد مناسب است. محافظ جانبی دارد. تنظیم گوش می تواند انجام شود.



عینک حلقه ای حرفه ای

PRF.LP.01

عینک حلقه ای حرفه ای گزینه های آبی و قرمز موجود با قابلیت تنظیم اندازه گوش عینک جراحی قابل تنظیم روش های کاشت مو، جراحی دندان

نور: LED CHALIMA ALANI: 20-60 سانتی متر بزرگنمایی 3.5 - 400 برابر





عینک حلقه ای حرفه ای

PRF.LP.02

عینک حلقه ای حرفه ای گزینه‌های آبی روشن و قرمز LED با باتری حرفه‌ای در دسترس است عینک جراحی قابل تنظیم اندازه گوش قابل تنظیم روش‌های کاشت مو، جراحی دندان

نور: LED CHALIMA ALANI: 20-60 سانتی متر بزرگنمایی 3.5 - 400 برابر





عینک حلقه ای حرفه ای

PRF.LP.03



نوع نور؛ رهبری
شدت نور؛ باتری 2؛ 60000Lx نرخ
بزرگنمایی حلقه. 2x-3x-4x دمای رنگ؛
عمر لامپ 50000؛ 5.500K ساعت زمان
کار؛ وزن 4 ساعت؛ 280 گرم

عینک حلقه ای حرفه ای

PRF.LP.04



نوع نور؛ رهبری
شدت نور؛ باتری 1؛ 60000Lx نسبت
بزرگنمایی حلقه. 2x-3x-4x دمای رنگ؛
عمر لامپ 50000؛ 5.500K ساعت زمان
کار؛ وزن 4 ساعت؛ 290 گرم

عینک حلقه ای حرفه ای

PRF.LP.05



نوع نور؛ رهبری
شدت نور؛ باتری 1؛ 60000Lx نسبت
بزرگنمایی حلقه. 2x-3x-4x دمای رنگ؛
عمر لامپ 50000؛ 5.500K ساعت زمان
کار؛ وزن 4 ساعت؛ هدبند 290 گرمی نیمه
ماه قابل تنظیم



DERMO HAZER LAZER




- دستگاه لیزر مو 650 نیوتن متری پا با لیزر درمو منشأ: ایتالیا
GS1+ISO+CE+EC+EU انطباق + تایید شده بالینی
- لیزر مو باعث تحریک گردش خون می شود.
 - لیزر موی مویرگ با افزایش گردش خون مویرگی از کارایی منطقه ای پشتیبانی می کند
 - لیزر مو فولیکول های مو را تحریک و احیا می کند
 - لیزر مو فاکتورهای رشد را تحریک و فعال می کند
 - لیزر مو با افزایش احتباس اکسیژن منطقه ای، اکسیژن رسانی سطحی را افزایش می دهد.
 - لیزر مو با باز کردن منافذ (اتساع) از انتقال سلول به سلول پشتیبانی می کند و از احتباس اکسیژن پشتیبانی می کند.

دستگاه لیزر مو

تحت نظر پزشک استفاده می شود. درمان های ریزش مو. بعد از کاشت مو؛

- شفا را تسریع می کند
- میزان بقای پیوندها را افزایش می دهد
- ظهور فولیکول های جدید مو را تسریع می کند
- بدون ریزش بر مرحله ریزش شوک غلبه می کند.
- علائم ریزش مو با الگوی مردانه در زنان اعمال می شود
- شوک ها ریزش موی ناشی از استرس را متوقف می کنند

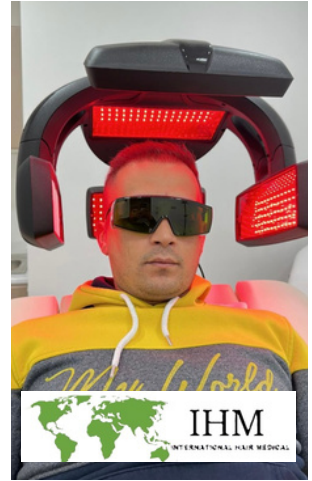

Hair Dermo Leisure

- تحت کنترل و توصیه پزشک؛
معمولا 2 سنا در هفته
6 تا 8 هفته درمان توصیه می شود.
در هر جلسه شارژ می شود.
هر جلسه 15 دقیقه است. مدت زمان سناس
را می توان روی دستگاه انتخاب کرد.
5 بدنه اصلی از یک سر تشکیل شده است.
سر را کاملا می پوشاند.
250 عدد ال ای دی میکال Nmlazer 710
وجود دارد



HAIR LINE DESIGNER LAZER

کد: HCL.01

لیزر مارکینگ و طراحی

- بدنه 100% فولادی طبی
- باتری لیتیومی (تقریباً 3 ماه استفاده با یک بار شارژ)
- اتصال شارژ جهانی (امکان شارژ حتی با تلفن همراه)
- لیزر پزشکی وصل شده است

استفاده از:

برای ارائه زیبایی و تعیین خط وسط آناتومیکی ناحیه پیشانی استفاده می شود.

با کابل شارژ USB همراه با هر شارژر قابل شارژ است.



استفاده سبک و ارگونومیک را فراهم می کند.

نوار تنظیم در ناحیه علامت گذاری پیشانی می تواند منبسط یا جمع شود.

از تماس مستقیم طولانی مدت با چشم باید اجتناب شود.

باید با کمک یک پارچه مرطوب تمیز تمیز شود.



پاک کردن آن با مواد ضد عفونی کننده ضرری ندارد.

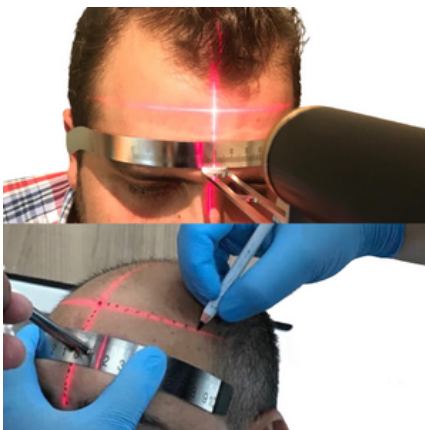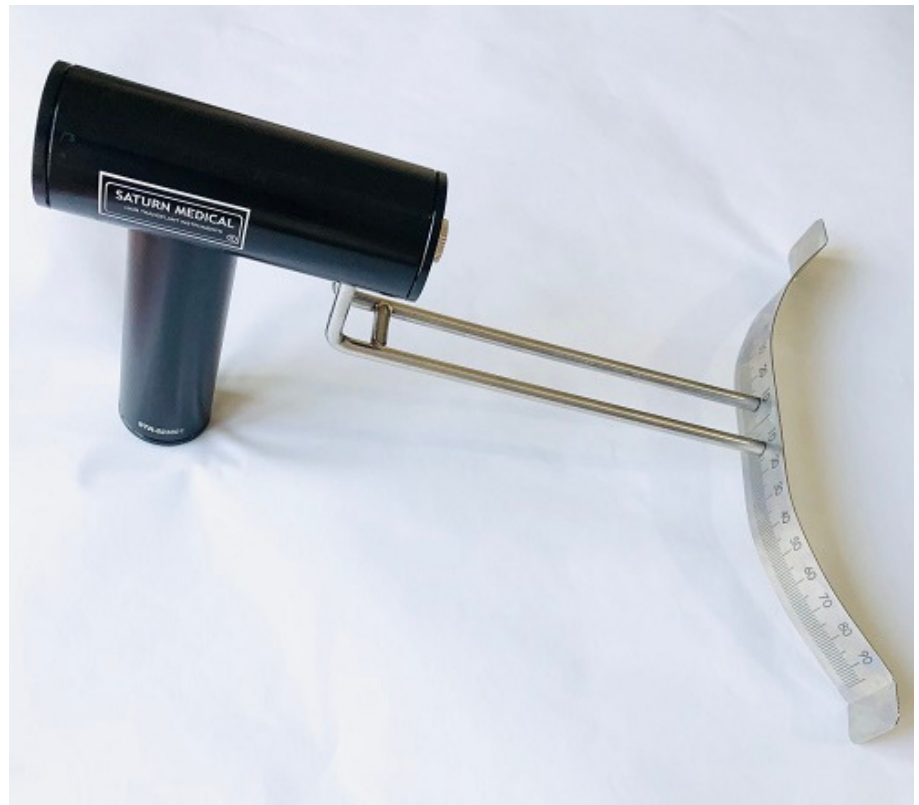



لوسیون NECROSIZ

جعبه کمک های اولیه

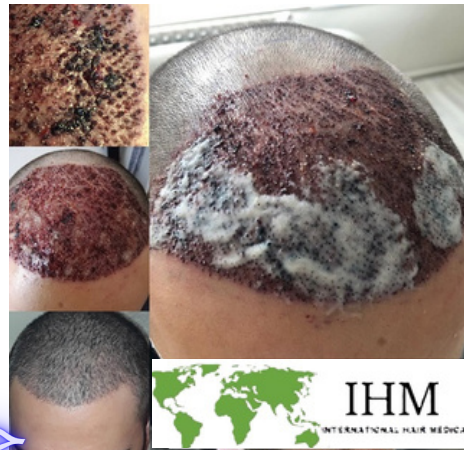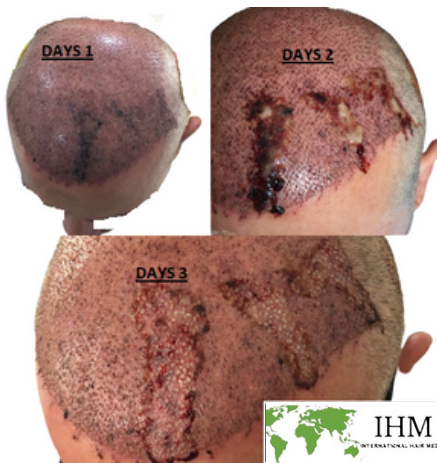

جعبه کمک های اولیه

لوسیون نکروز - لوسیون نکروز لوسیون نکروز hc hair charm ترمیم کلینیکی لوسیون سیاه و طلایی لوسیون نکروز در لوله های 125 میلی لیتری می باشد. استفاده: روی بافت مشکوک، عفونی یا نکروزه استفاده می شود. (قبل از آن باید تمیز و خشک شود) با لمس نوک انگشت، بدون فشار وارد می شود. همینطور رها شده است. از آنجایی که با آب حل می شود، شستشوی معمولی روز بعد (پس از 24 ساعت) انجام می شود.

بهبود قابل مشاهده پس از شستشو قابل توجه خواهد بود. در موارد شدید مانند نکروز عمیق، نکروز عفونی یا نکروز دیر تشخیص داده شده، توصیه می شود به همین ترتیب تا 1 هفته ادامه دهید. در موارد مشکوک یا تازه شکل گرفته که بلافاصله مورد توجه قرار می گیرد، در جلسه اول 99.9 درصد نتیجه می دهد. و از دست دادن پیوند وجود ندارد.

- این اثر مومی روی بافت دارد و گردش خون را همراه با سلول ها به سمت بالا می کشد.
- یک اثر تقویت کننده گردش خون را فراهم می کند
- حفظ اکسیژن بالا را فراهم می کند
- آن را دائما مرطوب نگه می دارد
- از یکپارچگی سلول محافظت می کند و به ترمیم بافت آسیب دیده کمک می کند
- این شامل محتوایی با هدف جلوگیری از عفونت و رفع عفونت موجود است.
- با فرمول خاص خود غیر حساسیت زا بوده و تنها محصول در زمینه خود می باشد.
- هشدارها: 4 تا 6 ساعت پس از استفاده، نشت خون کوچکی در ناحیه وجود خواهد داشت. (این به این دلیل است که گردش خون را تقویت می کند و ناحیه نکروزه را احیا می کند)
- ظاهری شبیه به ترشحات زرد رنگ در ناحیه کاربرد وجود خواهد داشت. (وکیوم با ایجاد استفراغ نکروز و بافت کثیف، عفونی و مرده را از بین می برد)
- در موارد تازه کشف شده هیچ از دست دادن پیوند وجود ندارد، اما مقداری از دست دادن پیوند (بسته به ناحیه) ممکن است در نکروز در مراحل پایانی یا نکروز تا پریوستوم مشاهده شود.
- هیچ درمان دیگری نباید در حین استفاده از این جلسات کاربردی اعمال شود.



سری استاندارد

MÜD.L.01

- دارای چراغ LED - 30000 LUX
- تنظیم نور 3 مرحله ای
- صفحه لمسی
- تنظیم ارتفاع و جهت
- عملیات led - لامپ مداخله
- روش های زیبایی پوست
- روش های مراقبت از پوست
- رویه های پزشکی
- عمل جراحی
- لامپ فرآیند مداخله قابل حمل
- چرخدار چند منظوره در
- مناطق کاشت مو ترجیح داده می شود



لامپ مداخله ای با حلقه با پا

MUD.L.02

- حلقه با شکوه
- LED 90 نور سفید
- LUX LIGHT 35000
- منطقه کار بین 20-60 سانتی متر
- استاندارد با چرخ
- پا و بدن را می توان جدا کرد
- قابل ساخت 360 درجه



ریخته گری PRF پا با LED 108

MUD.L.03

- لامپ کاشت مو حلقه 108 ال ای دی
- مدل ضد نوک با پایه های چدنی
- این چراغ مداخله با بزرگترین سر است.
- نام محصول: لامپ کاشت مو با پایه چدنی حلقه
- ال ای دی LED 108 ال ای دی
- کد محصول: MDLD-02
- ابعاد: 35-40-96 + پایه چدنی 60 سانتی متر +
- چرخ ترمز
- ویژگی: پایه های چدنی ضد کج + مفصل متحرک
- LED 108
- LUX LIGHT 35000





سری اسپات اسپات

MUD.L.04

- چراغ مداخله رنگارنگ با پایه های مارپیچ و بدون نوک
- چراغ 24 LED وات - عمر LED 5000 ساعت - قابلیت حرکت در هر جهت به لطف مارپیچ انعطاف پذیر - چرخ های متحرک - رنگ الکترواستاتیک
- محصول ما؛ جراحی کاشت مو برای بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز زیبایی و کلیه مناطق کاری که نیاز به نور متمرکز دارند مناسب است.
- 40000 لوکس
- مشکی - آبی - سفید - زرد - خاکستری

انعکاس نقطه ای پا ABS حرفه ای

MUD.L.05

- لامپ بازتابی نقطه ای پایه پلاستیکی Abs 50000 LUKS
- 1. اتصال برق: 240-100 V AC, 50-60 HZ 0.65A
- 2. مصرف برق: 10 وات
- 3. فیوز: F2AL250V
- 4. خروجی: 15V=0.65A
- 5. دمای عملیاتی: تا 5+ / 40+ C
- 6. عمر لامپ: 10000 ساعت
- اندازه های محصول:
- Boyut: 60 x 60 x 200 سانتی متر
- وزن: 5 کیلوگرم



لامپ مداخله ای LED حرفه ای

MUD.L.06

- با نور LED (LED زرد و سفید مخلوط)
- از انعکاس و خیرگی جلوگیری می کند
- لمسی دیجیتالی قابل تنظیم، با صفحه نمایش
- قسمت سر 360 درجه متحرک است
- قسمت گردن یک مفصل متحرک است و قابل تنظیم است.
- ساختار پا مدل اتاق عمل چرخ دار موجود است
- داده های تکنیکی
- تراکم 55000 لوکس
- قطر لکه 150-100 میلی متر، قطر عمق 10-25 سانتی متر، دمای رنگ 3800 - 4800 K
- شاخص رندر رنگ LED 91 Ra میانگین عمر < 50000 ساعت
- تعداد LED 12 قطر نور 150 میلی متر کنترل شدت 10 ~ 100 لمس دیجیتالی
- منبع تغذیه 220 ولت / 50 هرتز AC مصرف برق 12 وات






لامپ عملیات مداخله حرفه ای سوئیس

MUD.L.07

Muayene Aydınlatma'da
Yeni Nesil LED Teknolojisi

YENİ
ÜRÜN

Derungs

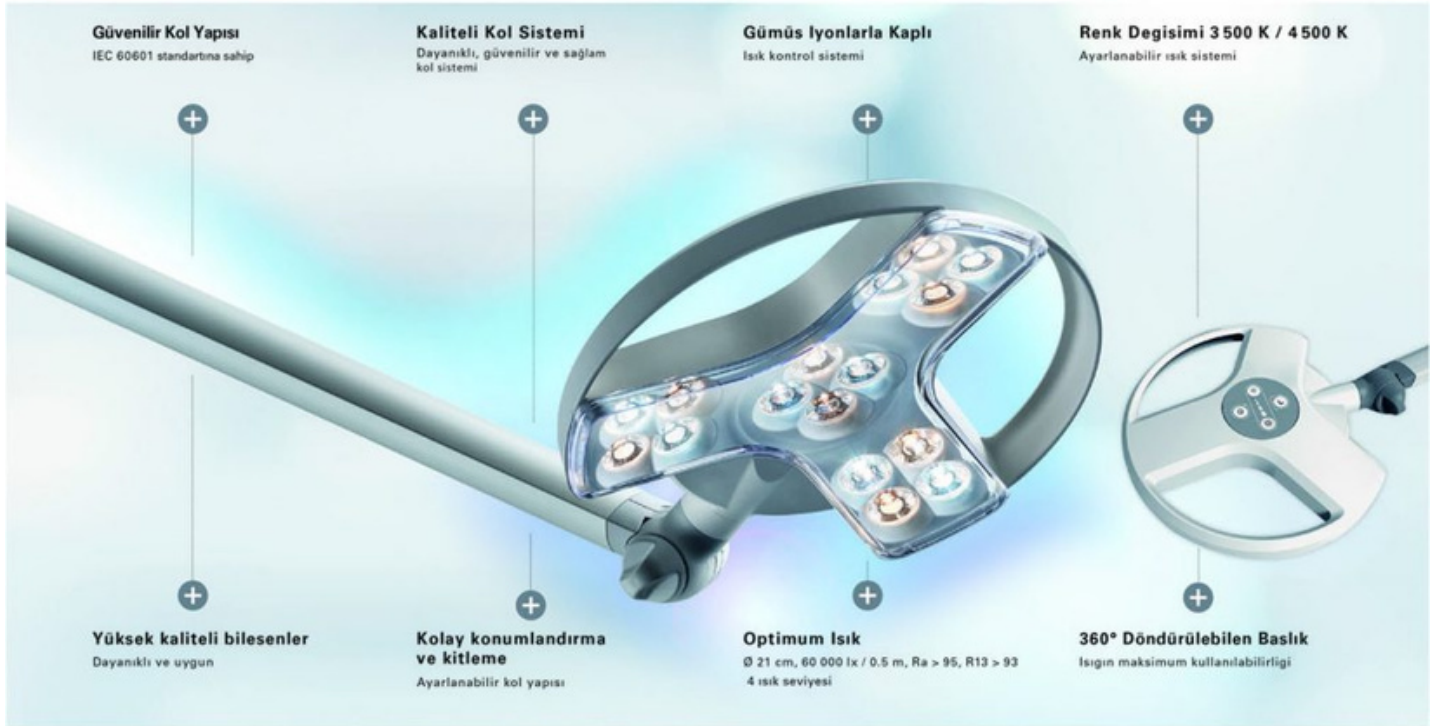

Kullanım Opsiyonları
tavana monte, tekerlekli ayak
raya monte, duvara monte
masaya monte



- muayene odası
- sac ekim odası
- acil servis

- yoğun bakım ünitesi
- neonatology
- jinekoloji

- pratisyen
- dermatolog
- kulak burun boğaz



- LED teknoloژی
- قدرت روشنایی بالا 60000 lx / 0.5 متر
- طول عمر LED در سطح بهینه 60000 ساعت تضمین شده است.
- منطقه روشن 210 میلی متر
- ارائه رنگ دقیق $Ra > 95$, $R9 > 90$
- دمای رنگ (3500K و 4500K) نمایش کنتراست فردی را فعال می کند. قدرت روشنایی در 4 مرحله است
- بالاترین کیفیت نور به لطف اپتیک الماسی
- عملکرد بهداشت ضد میکروبی بر روی اجزای مهم لامپ
- واحد عملیات آسان روی سر
- حداکثر شعاع کاری (سر می تواند 360 درجه بچرخد)
- ارگونومی عالی با سیستم بازوی آلومینیومی متعادل کننده فنر
- حداقل هزینه نگهداری به دلیل تکنولوژی LED
- مطابق با استانداردهای EN 60601-1 و EN 60601-2-41
- این محصول با یون های نقره پوشانده شده است. در عرض 8 ساعت خود را استریل می کند.
- قابل نصب دیواری، ریلی و
- گزینه های پای چرخ دار موجود است.
- دیوار نصب
- گزینه های نصب شده روی سقف < (هزینه اضافی)





لامپ عملیات مداخله حرفه ای آلمان

MUD.L.08

• مشخصات فنی لامپ های جراحی

- شدت روشنایی مرکزی (EC): برای اطمینان از دید خوب و جلوگیری از فشارهای بینایی برای جراحان، شدت نور ایده آل باید بین 40000 تا 160000 لوکس، در وسط پرتو نور، یک متر دورتر از منبع نور باشد.
- دمای رنگ (K): از آنجایی که چراغ های جراحی عموماً بافت های قرمز تیره را روشن می کنند، نور قرمز مرئی باید برای تأکید بر کنتراست و تمایز بافت ارائه شود. دمای رنگ 4000K روشنایی کافی را فراهم می کند و به جراح اجازه می دهد تا رنگ های بافت واقعی را با حداقل خستگی چشم تشخیص دهد. محدوده قابل قبول برای چراغ های جراحی باید بین 3000 تا 6700K باشد.
- عمق روشنایی (L1+L2): فاصله بین نقاط شدت روشنایی 20 درصد در بالا و پایین نقطه مرکزی. از نقطه حداکثر روشنایی، که مرکز میدان نور در فاصله 1 متری از سطح ساطع کننده نور است، فتومتر به سمت نور حرکت می کند تا شدت نور اندازه گیری شده به 20% از حداکثر مقدار کاهش یابد. فاصله بین مرکز و این نقطه به صورت L1 تعریف می شود. فاصله اندازه گیری شده مشابه دور از نور L2 است. عمق روشنایی بدون نیاز به فوکوس مجدد مجموع دو فاصله L1 و L2 است. در ویرایش دوم استاندارد IEC که در سال 2009 منتشر شد، مقدار آستانه از 20% به 60% اصلاح شد. در عمل، این عبارتی است که برای تصویربرداری بهینه از اجسام کوچک و کم کنتراست در اعماق مختلف در حفره های بدن استفاده می شود. سر لامپ های جراحی با عمق میدان زیاد، منطقه کاری بالاتر از استاندارد را بدون کوتاه کردن ناحیه کار فراهم می کند.
- ارزش CRI Ra: یک لامپ جراحی با مقدار CRI بالا به این معنی است که رنگ ها طبیعی تر به نظر می رسند. محدوده مقدار بین 0 تا 100 متغیر است. نور روز 100 در نظر گرفته می شود. مقادیر CRI 85 و بیشتر از 85 نشان دهنده رندر رنگ خوب است. به طور خلاصه، هر چه مقدار به 100 نزدیکتر باشد، نور طبیعی و با کیفیت بیشتری به دست می آید.
- مقدار CRI R9: طیف انعکاس مقداری است که مخصوصاً مربوط به اجسامی است که دارای طول موج قرمز هستند. نورپردازی LED نمی تواند به طور کامل به رندر رنگ قرمز برسد. در طول مداخلات جراحی باید از نورهایی با مقدار R9 بالا که می تواند رنگ قرمز را کاملاً نشان دهد استفاده شود.
- نوع ماده: نوع ماده ای که در سر لامپ های جراحی استفاده می شود باید به عنوان ماده ای سخت و مقاوم در برابر دما، ضربه و خراش انتخاب شود.
- قطر ناحیه روشنایی (D10): به جایی ختم می شود که لامپ عامل به 10 درصد شدت نور برسد. پهن به قطر لکه اشاره دارد.
- اندازه گیری توزیع نور (D50): به جایی ختم می شود که لامپ عامل به 50 درصد شدت نور خود برسد. باریک به قطر لکه اشاره دارد.
- جریان هوای لامینار: جریان هوای لامینار در اتاق های عمل و عمل های جراحی برای جلوگیری از نشستن باکتری ها، ویروس ها و میکروب ها در ناحیه باز جراحی و ایجاد عفونت ایجاد می شود. تلاطم هوا وضعیت مطلوبی نیست زیرا می تواند باعث دمیدن ذرات غیر جھتی شود که می تواند منجر به عفونت ناحیه جراحی شود که باید استریل باقی بماند. به منظور به حداقل رساندن آلودگی در لامپ های اتاق عمل، باید از طرح های سر جراحی که تلاطم هوا را ایجاد می کنند، استفاده شود.
- بهداشت: ساختار عایق تقویت شده و بدنه پوشش داده شده با رنگ آنتی باکتریال لامپ های LED اتاق عمل نباید حاوی گرد و غبار، کثیفی و باکتری های داخل دستگاه باشد و برای نظافت با محصولات ضد عفونی کننده مناسب باشد.
- IP54: سر لامپ های اتاق عمل باید در برابر گرد و غبار و آب مقاوم باشند.
- لامپ های اتاق عمل دارای 3 نوع کاربری مختلف هستند: سقفی، دیواری و متحرک.
- آپشن های دیواری - سقفی (هزینه اضافی)





اسلحه مزوتراپی دیجیتال

کد: MZTRP.01-EZ

- هد قابل تنظیم دیجیتال
- نوک سوزن چند بار مصرف استریل
- مزوتراپی مو
- PRP صورت - گردن - دکلته و بدن
- ساخت کره



Doz Ayarı Yapılabilir





اسلحه مزوتراپی دیجیتال

MZTRP.02-INSTADBEAUTY

- هد قابل تنظیم
- دیجیتال
- ست سرسوزن و سر
- سوزن یکبار مصرف
- بسته استریل
- مزوتراپی مو
- PRP صورت - گردن -
- دکلته و بدن
- ساخت کره

INSTATBEAUTY IN MINUTES
NEEDLE-FREE MESOTHERAPY
■ MINI VANADIUM TITANIUM MESOTHERAPY GUN FOR MOISTURIZING ■

INSTATBEAUTY mezoterapi tabancası intradermal uygulamalar için geliştirilmiştir. Mezoterapi işlemlerinin güvenli, garantili ve konforlu uygulanmasına olanak sağlar.

Hava kompresörüyle çalışan mezoterapi tabancası **INSTATBEAUTY MESOGUN**; enjeksiyon derinliği, enjeksiyon modu ve her noktaya bırakılacak ürün miktarı için bar basıncının ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Dakikada seri 500 atış özelliği sayesinde oldukça hızlı enjeksiyona olanak verir. Manuel uygulamalarda yaşanan ağrı, acı riskini ortadan kaldırır.

Tek kullanımlık iğne kiti ile kullanılan **INSTATBEAUTY MESOGUN**; ürün kaybını engeller. Kontrollü, rahat uygulama özelliği sayesinde hasta konforunu da sağlar.



DERİN TEMAS

Teknolojik Yapısı ile en derine temas ve ikmal imkanı.



Yaşlanma ile birlikte başlayan çizgi ve kırışıklıklar üzerinde etkin uygulama ve Anti-Aging Seansları

KIRISIKLIK UYGULAMALARI




GÖZENEK KÜÇÜLTME

Gözenek uygulamalarında ve yağlı ve yağlıya dönük cilt tiplerinde etkin sonuçları



Güneş Lekeleri
Cilt Lekeleri
Akne Lekeleri
Çil ve Yanık İzleri
gibi leke sorunları ve cilt renk/ton dengesizlikleri için uygulamalar.

RENK/TON DENGESİZLİKLERİ CİLT LEKELERİ

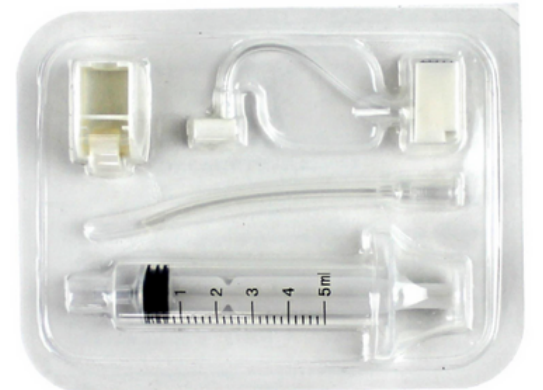



سانتریفیوژ 6 چشم

کد: SNTRF.06

- 30 دقیقه زمان بندی شده
- 4000 دور در دقیقه
- تبر پلاستیکی
- VACUUM FOOT ضد لرزش
- عملیات بی صدا
- سازگار با A.S.M و PRP
- GZÖLÜDÜR 6



ابعاد جعبه: 35 x 35 x 35 سانتی متر 4 کیلوگرم

الکتروماگ 8 چشم

کد: SNTRFJ-E.M.08

- Özel platform üzerine oturtulan bakım gerektirmeyen induksiyon motor sessiz ve titreşimsiz çalışır.
- Çalışırken kapağın açılmasını önleyen özel kilit sistemi vardır. Kapak kapatılmadan cihaz çalıştırılmaz.
- Kısa süreli çalışmalar için pulse seçeneği bulunmaktadır. Cihazlar Hız veya Savurma gücü girilerek çalıştırılabilir.
- Ayrıca kullanıcı tarafından istenilen çalışma anında savurma gücü (RCF) veya hız dönüşümü yapılarak ekranda gösterilir
- Tüpleri taşıyan 35° sabit açılı rotorlar polikarbonat malzemeden yapılmıştır.
- Açılır başlıklı santrifüjlerde rotor malzemesi elektrostatik fırın boyalı alüminyumdur.
- Tüp yuvaları değiştirilerek çeşitli tüp hacimlerine uygun çalışma sağlanır.
- Medikal santrifüj cihazlarının dış gövdeleri çelik sacdan imal edilmiştir ve fırın boya ile kaplanmıştır.
- Cihazlar akım emniyet sigortası ile koruma altına alınmıştır.



Dijital Kontrol Paneli

- 0-99 dakika Arasında Ayarlanabilen Mekanik Zaman Ayarı
- Dijital Hız Kontrolü



8x 15ml Tüp Kapasiteli



Ağırlık : 9 KG

Teknik özellikleri:

Tüp Kapasitesi	8x15ml
Rotor Tipi	Düşeyle 35° sabit açılı rotor
Hız Kontrolü	PID Dijital Mikroprosesör kontrol
Kontrol Paneli	Hız,RCF ve Zaman Kontrolü
Max. Dönme Hızı	5000 rpm
Max. Savurma Gücü (RCF x g)	2515kg
Hız Ayarlama Adımı	10rpm
Hız Ayarlama Aralığı	500-5000rpm
Zaman Başlangıcı	Ayarlanan Hıza Ulaştığında
Zaman Aralığı	1-99 dk
Sürekli Çalışma Modu	Var
Savurma Gücü Girilerek Çalışma	Var
Kısa Süreli Çalışma	Pulse Tuşuyla
Program Sayısı	10
Sigorta	1 Amper
Toplam Güç	100 W
Emniyet Sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak Kilidi	Var
Harici Hız Okuma	Var
Döner Başlık Malzemesi	Polikarbonat
Tüp yuvası (gode) malzemesi	ABS (sert plastik)
Dış Gövde Malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
Besleme	AC 190-240V / 50-60 Hz
Dış Ölçüler (g x y x d)	29x25x36 cm
Net Ağırlık	9 kg
Paketli Ağırlık	10 kg




PRP GEL TUBE پکیج 50 عددی



کد: PRP.T-J.50

حاوی 50 لوله آماده سازی ژل PRP پزشکی 10 میلی لیتری

خون گرفته شده از بیمار به یک لوله وکیوم مخصوص با ژل منتقل می شود و پس از سانتریفیوژ در دستگاه سانتریفیوژ استفاده می شود.

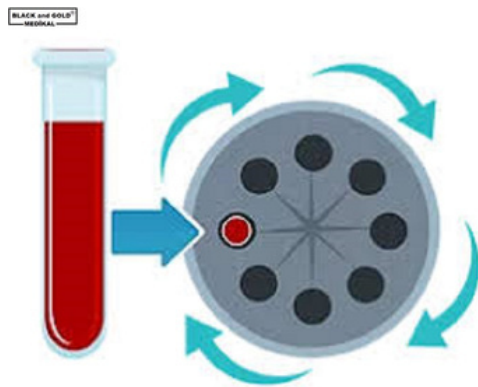


پی آر پی سیترات تیوب بسته بندی 50 عددی

PRP.T-S.50

حاوی 50 لوله آماده سازی PRP سیترات شده 10 میلی لیتری پزشکی

خون گرفته شده از بیمار به یک لوله وکیوم مخصوص با ژل منتقل می شود و پس از سانتریفیوژ در دستگاه سانتریفیوژ استفاده می شود.

BLOOD STRUCTURE

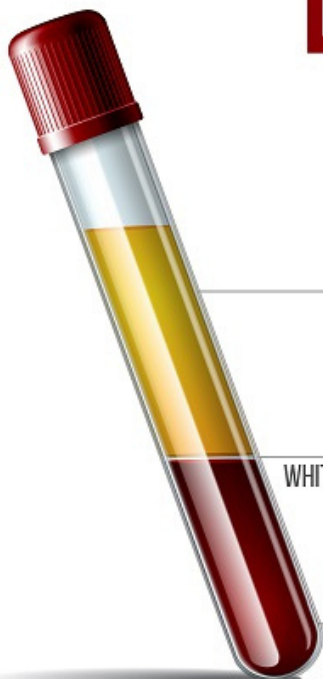

PLASMA



WHITE BLOOD CELLS AND PLATELETS



RED BLOOD CELLS





درمورولر

کد: DRML-500.01

- درمان های مو
- مزوتراپی مو
- مزوتراپی صورت
- کاربردهای مراقبت از مو
- برنامه های کاربردی مراقبت از صورت
- کاربردهای مراقبت از پوست
- بسته استریل شخصی شده
- 500 سوزن تیتانیوم
- دقت پیشبرد نقش ها



بطری خالی استریل با درپوش غلتکی

DRML-300.02

توضیحات محصول

محتویات مجموعه: غلتک Hydra، مایع پاک کننده درمارولر، ضد عفونی کننده پوست، راهنمای کاربر ترکیه Hydra Roller: این یک ابزار میکرونییدینگ با 64 سوزن تیتانیوم بر روی سر غلتکی است.

از 3 قسمت اصلی تشکیل شده است: سر، لوله و پوشش. به لطف پوشش محافظ آن، سوزن ها بدون آسیب نگهداری می شوند.

مکانیسم ترمیم زخم را تحریک می کند و تولید کلاژن را بدون آسیب رساندن به پوست تضمین می کند.

حتی مواد فعال زیر پوست را به لطف کانال های میکرو که در پوست باز می کند، تسهیل می کند.

برای سیاهی زیر چشم، چین و چروک و خطوط ریز، منافذ باز، آکنه و جای زخم، لکه های پوستی، ریزش مو، علائم کشش هنگام تولد، سلولیت و بسیاری از مشکلات دیگر استفاده می شود.

این روش با اسکن ناحیه برنامه در یک الگوی ستاره ای (به علاوه متقاطع) 10-6 بار انجام می شود.

بطری محلول دارویی خالی اندازه سوزن استفاده شده، اعمال در 1 جلسه هر 2-5 روز انجام می شود.

غلتک های پدرا باید فقط از هر جلسه با مایع پاک کننده درمارولر تمیز شود.

ابعاد سوزن غلتکی Hydra:

0.25mm - قابل استفاده در ریزش و اطراف چشم.

0.50 میلی متر - قابل استفاده برای صورت یا مو.

1.00mm - قابل استفاده در ناحیه بدن یا روی مو.

فواصل جلسات Hydra Roller:

0.25mm - قابل استفاده در 1 جلسه هر 2 روز.

0.50 میلی متر - قابل استفاده در 1 جلسه در 3 روز.

1.00 میلی متر - قابل اعمال در 1 جلسه در 5 روز.

پوشش غلتکی سوزن تیتانیوم 64



پوشش محافظ



کاشت مو و صندلی زیبایی پزشکی کد: KLTK.3M-01

- صندلی عملیاتی سری LUX با 3 موتور
 - ساخت و ساز فولادی برش لیزری
 - تکان نمی خورد
 - DENSITY SPECIAL SERIES FOAM 32
 - Comfort
 - روکش چرم VINLEX سری AŞAN VIVA
 - سر سوراخ شده (و بالش بسته)
 - این آنتی باکتریال است
 - رنگ اختیاری است
- توجه: چهارپایه ها و چرخ دستی های کار با همان رنگ اختیاری ساخته می شوند.
- ابعاد: 185 × 61 × 60 سانتی متر خالص: 93 کیلوگرم





ارتوپدی EXPERT OPERATION STOL

کد: TBR.01

- روش مدفوع ارتوپدی با پشتی
 - ضربه گیر دارد و بالا و پایین می رود.
 - دارای پایه های کرومی
 - سیستم چرخ ترمزدار موجود است
 - پشتی دارد
 - مناسب برای استفاده طولانی مدت، ارگونومیک
 - استفاده از آن ارگونومیک است
 - گزینه های رنگ موجود است.
- ابعاد: 40 x 50 x 40 سانتی متر خالص: 9 کیلوگرم





مدفوع رویه با پشتی



کد: TBR.02

- روش مدفوع ارتوپدی با پشتی
 - ضربه گیر دارد و بالا و پایین می رود.
 - دارای پایه های کرومی
 - سیستم چرخ ترمزدار موجود است
 - پشتی دارد
 - برای استفاده طولانی مدت مناسب است،
 - استفاده از آن ارگونومیک است
 - گزینه های رنگ موجود است.
- ابعاد: 40 × 40 × 35 سانتی متر
خالص: 8 کیلوگرم

IF SOOL SERIES

کد: TBR.03

- روش مدفوع ارتوپدی
 - ضربه گیر دارد و بالا و پایین می رود.
 - دارای پایه های کرومی
 - سیستم چرخ ترمزدار موجود است
 - پشتی دارد
 - برای استفاده طولانی مدت مناسب است،
 - این یک سریال شخصی شده با شکل آن است،
 - باسن را می گیرد و احساس خستگی و خواب آلودگی را از بین می برد.
 - گزینه رنگ **ONLY BLACK** است
- ابعاد: 40 × 40 × 40 سانتی متر خالص: 7 کیلوگرم



مدفوع بدون پشت

کد: TBR.04

- روش مدفوع ارتوپدی
 - ضربه گیر دارد و بالا و پایین می رود.
 - دارای پایه های کرومی
 - سیستم چرخ ترمزدار موجود است
 - پشتی دارد
 - برای استفاده طولانی مدت مناسب است،
 - یک مدل بدون سطح است
 - گزینه های رنگ موجود است
- ابعاد: 40 × 35 × 38 سانتی متر خالص: 5.5 کیلوگرم





صندلی خون گیری نوع حرفه ای

کد: ERP.E.220-B

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- کفپوش آنتی باکتریال
- ویژگی Trendelenburg
- پشتی سر و دسته متحرک
- حرکت همزمان پشت و پا
- کنترل دست
- فضای نشیمن: 60 در 50 سانتی متر
- اسفنج خاکستری 28 تراکم 5 سانتی متر
- Boyut : 80 × 175 × 48 سانتی متر
- وزن: 40 کیلوگرم

کابینت داروی خاص قفل شده است

کد: ERP.E-112

- کابینه مواد مخدر
- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- کلاه قرمز سبز
- Dkp پشت سر
- روکش های قابل قفل شدن
- Boyut : 18 × 60 × 50 سانتی متر
- وزن: 9 کیلوگرم



برانکار استراحت معاینه

کد: TBR.04

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- کفپوش آنتی باکتریال
- حرکت سر و پا با پیستون گاز
- پا ثابت
- طول مبل با پایه های بسته: 145 سانتی متر
- طول قسمت سر: 40 سانتی متر
- طول قسمت نشیمن: 100 سانتی متر
- طول قسمت پا: 40 سانتی متر
- Boyut : 56 x 185 x 70 سانتی متر
- وزن: 22 کیلوگرم





MAYO MASASI HİDROLİKLİ MODEL

کد: MM.H.01

- فولاد ضد زنگ با کیفیت 304
- سه چرخ ABS ضد الکتریسیته ساکن، دو تا با ترمز
- تنظیم ارتفاع با پدال پایه هیدرولیک
- میز بالا با چرخش 360 درجه
- یک محصول پزشکی است
- وزن: 22 کیلوگرم بسته بندی: 25 کیلوگرم



MAY تخته دکمه دستی Massage

کد: MM.H.02

- فولاد ضد زنگ با کیفیت 304
- سه چرخ ABS ضد الکتریسیته ساکن، دو تا با ترمز
- تنظیم دستی ارتفاع
- میز بالا با چرخش 360 درجه
- یک محصول پزشکی است
- وزن: 17 کیلوگرم بسته بندی: 20 کیلوگرم



راهنمای ماساژ رودخانه TIBBİ

کد: MM.H.03

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- سه چرخ ABS ضد الکتریسیته ساکن، دو تا با ترمز
- صفحه رویه استیل ضد زنگ با کیفیت 304
- تنظیم دستی ارتفاع
- فضای استفاده در داخل میز: 57x38 سانتی متر
- ابعاد 70*40*60 سانتی متر 18 کیلوگرم





میز بیمار

کد : ERP.E-273.A

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- چهار چرخ ضد الکتریسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- صفحه بالایی آنتی باکتریال ABS
- حرکت با کمک فنر

ابعاد: 40 x 80-100 x 80 سانتی متر وزن: 10 کیلوگرم



میز بیمار

کد : ERP.E-273

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال ABS آنتی استاتیک چهار کاستور، دو عدد با ترمز میز رویه چوبی
- حرکت با کمک فنر ابعاد: 40 x 80 x 80 سانتی متر وزن: 10 کیلوگرم



کابینت مثبت

کد: ERP-271-A

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- چهار چرخ ضد الکتریسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- صفحه رویی ABS، بدنه ورق فلزی
- کشو و کابینت
- Boyut : 37 x 44 x 80 سانتی متر
- وزن: 15 کیلوگرم





چرخ دستی

کد: ERP.E251

- 1 رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- چهار چرخ ضد الکتریسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- بدنه فلزی
- ترومل 29x24 سانتی متر، وان 40 سانتی متر، لگن 20 سانتی متر
- دسته فشار
- ابعاد: 36 x 82 x 87 سانتی متر وزن: 10 کیلوگرم



چرخ دستی مواد و دارو

کد: ERP.E-257

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال روی بدنه فلزی
- چهار چرخ ضد الکتریسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- بالای کانتر آنتی باکتریال ABS
- نگهدارنده فایل و سطل زباله
- 32 جعبه داروی شفاف آنتی باکتریال
- دو کشو
- دسته فشار
- Boyut : 50 × 90 × 110 سانتی متر
- وزن: 47 کیلوگرم



سبد خرید دستگاہ با تعلیق سرم

کد: ERP.E-233A

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- چهار چرخ ضد الکتریسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- بدنه فلزی
- با کشو و چوب لباسی
- عمق کشو: 11 سانتی متر
- Boyut : 40 × 50 × 82 سانتی متر
- وزن: 10 کیلوگرم





ستن صندلی لوکس

کد: Y-KLTK.01

- صندلی لباسشویی سری LUX
- ارگونومیک و راحت است
- سینک + مجموعه میکسر گنجانده شده است
- فقط اتصال آب و اتصال تخلیه ساخته شده است و برای استفاده مستقیم آماده است.
- اندازه: 140X65X65 سانتی متر - 45 کیلوگرم



صندلی شستشو

کد: Y-KLTK.02

- استاندارد صندلی شستشو
- ارگونومیک و راحت است
- سینک + مجموعه میکسر گنجانده شده است
- فقط اتصال آب و اتصال تخلیه ساخته شده است و برای استفاده مستقیم آماده است.



صندلی لباسشویی قابل حمل

کد: Y-KLTK.03

- صندلی لباسشویی قابل حمل
- بشیلنگ تخلیه آب به داخل زهکش یا سینک پرتاب می شود
- در یک حمام یا اتاق مناسب، بشیلنگ زباله همچنین می تواند به یک سطل یا یک منطقه مشابه منتقل شود.
- می توان آن را حمل و در هر مکانی به عنوان قابل حمل استفاده کرد
- سایز: 160-100 سانتی متر 20 کیلوگرم





میز عملیات Z با مدل کشو

کد: Z.SHP-01

- جدول پردازش Z مدل کشو
- ابعاد: 71 × 65 × 40 سانتی متر
- وزن: 15 کیلوگرم
- 2 قفسه و کشو
- این یک مدل پزشکی چرخدار است.
- چرخ با ترمز
- رنگ پودری استاتیک آنودایز شده پزشکی

میز عملیات مدل Z با 2 قفسه

کد: Z.SHP-02

- پایه عملیاتی مدل Z
- ابعاد: 71 × 65 × 40 سانتی متر
- وزن: 12 کیلوگرم
- 2 قفسه
- این یک مدل پزشکی چرخدار است.
- چرخ با ترمز
- رنگ پودری استاتیک آنودایز شده پزشکی



میز عملیات مدل Z با 3 قفسه

کد: Z.SHP-03

- پایه عملیاتی مدل Z
- ابعاد: 71 × 65 × 40 سانتی متر
- وزن: 12 کیلوگرم
- 2 قفسه
- این یک مدل پزشکی چرخدار است.
- چرخ با ترمز
- رنگ پودری استاتیک آنودایز شده پزشکی





SERUM ASKISI AHTAPOT AYAKLI

کد: ERP.E288

- رنگ پودری خشن نقره ای الکترواستاتیک
- آنتی باکتریال
- پنج چرخ ضد الکتروسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- بخش آویز نیکل اندود
- با چهار قلاب
- با پایه های چدنی
- اندازه: 60 x 130-220cm x 60 وزن: 9 کیلوگرم

سرمد ASKISI مدل استاندارد

کد: ERP.E287

- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- چهار چرخ ضد الکتروسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- بخش آویز نیکل اندود
- اندازه: 50 x 105-187cm x 50 وزن: 3 کیلوگرم



IV POSE PROFESSIONAL MULTIPLE MODEL

کد: ERP.E-289.B

- بدنه استیل ضد زنگ با کیفیت 304
- پنج چرخ ضد الکتروسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- چهار چوب لباسی
- مناسب بودن حمل پمپ تزریق
- پنج فوت نیکل اندود شده است
- Boyut: 60 x 60 x 115-210 سانتی متر
- وزن: 6 کیلوگرم





Hastabaşı
Monitör Şehpası
ZRV-097

- Krom Nikel Kaplama Gövde
- Alüminyum Cihaz Sabitleme Tablası
- Paslanmaz Aksesuar Sepeti
- 2'si Frenli 4 Tekerlek



دستگاه مانیتور
سبد خرید پزشکی

کد: C.ARB-01

- پایه مانیتور قابل حمل
- بدنه نیکل اندود کروم
- میز تعمیر دستگاه آلومینیومی
- سبد لوازم جانبی ضد زنگ
- 4 چرخ، 2 تا با ترمز
- ابعاد: 140 × 50 × 40 کیلوگرم

مدل حرفه ای پایه دستگاه

کد: C.ARB-02

- سری آزمایشی
- سبد خرید دستگاه های پزشکی
- رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی باکتریال
- چهار چرخ ضد الکتریسیته ساکن ABS، دو تا با ترمز
- بخش کاربری 3 طبقه
- KAYDIRMAZ TABLALAR
- 3-پریز برق روی دستگاه
- PULL GRIP HANDLE
- ابعاد: 80 × 40 × 40 x وزن: 8 کیلوگرم



مدل کشو ضد زنگ چرخ دستی
دستگاه

کد: C.ARB-03

- فولاد ضد زنگ
- بدنه نیکل اندود کروم
- 2 قفسه + کشو
- 4 چرخ، 2 تا با ترمز
- سری اتاق عمل پزشکی
- ابعاد: 60 × 50 × 65 کیلوگرم





دستگاه ضد عفونی کننده ETUV 50 لیتری

کد: ETV.50

- دستگاه استریلایزر Dry Air 50LT دیجیتال
- ترموستات: 20C - 250C
- حساسیت: + - 2%
- مقاومت: 600 وات + حجم داخلی: 50 لیتر
- ابعاد داخلی:
- عرض: 40 سانتی متر - ارتفاع: 40 سانتی متر
- عمق: 32 سانتی متر
- کاربرد چند منظوره دارد
- می توان از آن در کلینیک های کاشت مو، دندانپزشکان و جراحی های جزئی استفاده کرد.

دستگاه استریلایزر فر 10 لیتری

کد: ETV.10


- دستگاه استریلایزر Dry Air 10 LT Digital
- ترموستات: 20C - 250C
- حساسیت: + - 2%
- مقاومت: 600 وات + حجم داخلی: 50 لیتر
- ابعاد داخلی:
- عرض: 30 سانتی متر - ارتفاع: 30 سانتی متر
- عمق: 24 سانتی متر
- کاربرد چند منظوره دارد
- می توان از آن در کلینیک های کاشت مو، دندانپزشکان و جراحی های جزئی استفاده کرد.



دستگاه بسته بندی استریل

کد: PK.01

- اطلاعات فنی دستگاه بسته شدن برش رول استریلیزاسیون:
- ولتاژ 230 ولت / 50 هرتز
- قدرت 500 وات
- حداکثر عرض بسته شدن 250 میلی متر
- عرض جوش 12 میلی متر
- وزن دستگاه 5 کیلوگرم می باشد

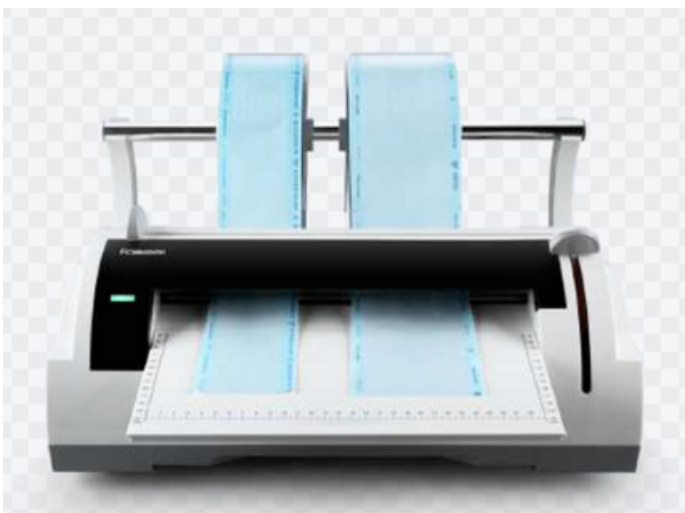



دستگاه تخریب اولتراسونیک 8 لیتر

کد: ULTRSNC-8

- پاک کننده دیجیتال التراسونیک
- سبد سیمی 8 لیتری با شیر تخلیه
- حالت های مختلف استفاده + عملکرد کم نویز
- تمیز کردن آسان
- دارای یک شیر آب است و تخلیه آسان را فراهم می کند.
- دستگاه تمیز کننده اولتراسونیک استریلیزاسیون
- تمام محصولات خود را با امواج ارتعاشی اولتراسونیک تمیز کنید.
- با نشستن آن می توانید از خوردگی و سایش محافظت کنید و از تمیز کردن دقیق آن اطمینان حاصل کنید.

دستگاه تخریب التراسونیک دیجیتال 700 میلی لیتر



TEKNİK ÖZELLİKLER

Açıklaması	Dijital Ultrasonik Temizleyici
Modeli:	CD-7940
Tank Kapasitesi	750 ml ±10% / 0.79 qt (ABD) Maks. 600 ml ±10% / 0.63 qt (ABD)
Tank Boyutları	14.9x12.7x4.6 cm / 5.9"x5.0"x1.8"
Güç Kaynağı	CD-7940: AC100V~ 50/60Hz, 26W AC100-120V~ 60Hz, 35W AC220-240V~ 50Hz, 50W
Dijital Zamanlayıcı Ayarları	(3dk) (5dk) (8dk) (1.5dk) (10dk) →180s → 300s → 480s → 90s → 600s
Ultrasonik Frekansı	CD-7940: 42 KHz ±10%
Tank Malzemesi	Paslanmaz Çelik SUS304
Gövde Malzemesi	ABS
Güç Kablosu Uzunluğu (Yaklaşık)	1.5 m
Net Ağırlık	1.1 kg / 2.4 lb
Brüt Ağırlık	1.5 kg / 3.3 lb
Cihaz Boyutları	19.5x19.5x17.8 cm / 7.7"x7.7"x7.0"
İç Karton Boyutları	24.2x24.2x21.2 cm / 9.5"x9.5"x8.3"
Master Karton Başına Miktar	6 adet/karton
Master Karton Boyutları	75.0x26.0x45.0 cm/29.5"x10.2"x17.7"
Aksesuarlar	1 adet plastik sepet, 1 adet saat standı, 1 adet CD standı

کد: ULTRSNC-700



قرص فرمالدهید استریلیزاسیون 800

کد: FRM.800

عدد



- این در 800 محافظ پلاستیکی ارائه شده است.
- مراحل استریلیزاسیون و ضد عفونی باید توسط افراد مجاز انجام شود.
- طبق روال و دستورالعمل استفاده می شود.
- قرص فرمالدئید در جعبه های دربسته و بدون هوا
- ابزارهای کوچک را می توان با دور انداختن چند قطعه درست کرد.
- در استریلیزاسیون استفاده می شود.
- نام محصول: قرص فرمالدئید 800
- ابعاد: 14 × 15 × 24 سانتی متر 1 کیلوگرم
- ویژگی: تیلت آماده برای استفاده در یک جعبه پلاستیکی قفل شده
- محل تولید: ترکیه



طب درام

كد: TRM.24

- LUKE MEDICAL DRUM 24
- كمپرس گاز استريل
- ابزار دستى استريل
- كيسه هاى گاز استريل
- وريدهاى استريل
- اين تضمين مى كند كه محصولاتى مانند محصولات استريل باقى مى مانند. ابعاد: 24 x 24 x 24 كيلوگرم

سینی پزشکی با درب 30 لوک

كد: T.T.K-30

- فولاد ضد زنگ پزشکی
- مدل استاندارد در سایز A4
- با کاور
- اندازه: 30 × 22 × 6 سانتی متر 0.750 گرم



كاسه پزشکی 500 میلی لیتر

كد: T.T.T-500

- فولاد ضد زنگ پزشکی
- كاسه محلول
- 400 میلی لیتر



كاسه پزشكى 150 مىلى
لىتر

كد: T.T.K-150

- فولاد ضد زنگ پزشكى
- كاسه محلول
- 150 مىلى لىتر

لىوان طبى 150 مىلى لىتر

كد: T.T.T-150

- فولاد ضد زنگ پزشكى
- SOLUTION GLASS
- 150 مىلى لىتر




MEDICAL KIDNEY TAS 500


مىلى لىتر
كد: TBT-500

- فولاد ضد زنگ پزشكى
- SOLUTION + PARTS TUB 400 ML



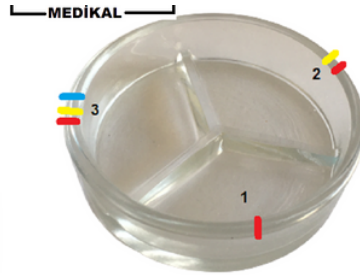

0,3 mm Kalınlık x 100 mm Çap

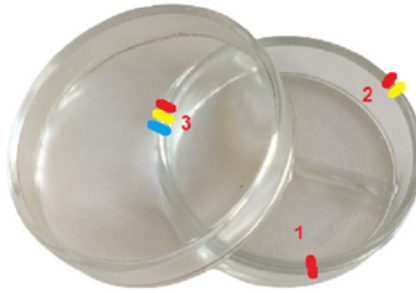

3 محفظه شیشه ای پتری

کد: C.P-3X100

- 3 بخش
- مدل دوربین کالین
- ظرف پیوند پتری
- 100 میلی متر X 100 میلی متر

کولر گرافت پتری 150 میلی متر

کد: PTR.SĞTC-150



CAM PETRİ 100-120

کد: C.P-150




کد: C.P-120 میلی متر

کد: C.P- 100

- TIIBİ 150 میلی متری بادامک PETRİ
- مدل پوشش داده شده
- 150 x 150 میلی لیتر

- TIIBİ 120 میلی متری دوربین PETRİ
- مدل پوشش داده شده
- 120 x 120 میلی لیتر

- TIIBİ 100 میلی متری بادامک PETRİ
- مدل پوشش داده شده
- 100 x 100 میلی لیتر

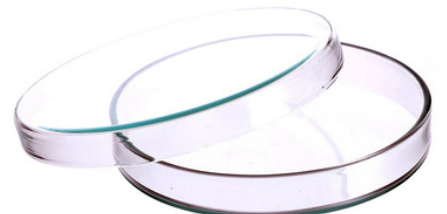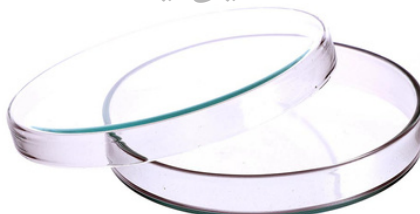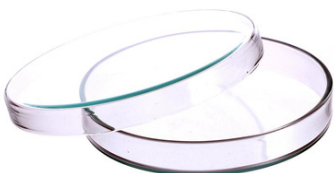



UVC - OTCLV-1

- استریلیزاسیون اتوکلاو کاست قابل حمل UV C فقط در 3 دقیقه به لطف آداپتور شارژ جهانی، امکان شارژ حتی با تلفن را نیز ارائه می دهد.
- این به شما این امکان را می دهد که فقط در 3 دقیقه استریل کردن تمام محصولات خود را با پلاستیک - فلز - میکروموتور - فیو پانچ - تیغه یا قوت کبود و غیره انجام دهید.
- اتوکلاو کاست مو قابل حمل دارای تاییدیه CE / FDA - ROHS است.
- طول موج فرابنفش: 253.7 نیوتن متر
- روش کار؛ با تمام شارژهای گوشی سازگار است و همچنین می توانید با وصل کردن مستقیم آن به پریز، استریل آن را انجام دهید.
- در برابر کلیه باکتری ها و ویروس ها از جمله بیماری های سرولوژیکی (هپاتیت A - B - C - HIV 9) به ویژه کووید موثر است.
- عقیم سازی کامل و ایمن را ارائه می دهد.
- ارگونومی؛ این کوچک است، با زنگ الکترونیکی، قابل حمل، می تواند در کنار پردازنده در هر اتاق در طول عمل قرار گیرد، و استفاده راحت تری را ارائه می دهد.
- روش استفاده: پس از تمیز کردن (با خارج کردن خون و غیره) و خشک کردن آن، کافی است آن را داخل آن قرار دهید و دکمه شروع را فشار دهید، علائم و دستورالعمل های صوتی روی آن وجود دارد.

سایز: 30 × 20 × 8 سانتی متر 350 گرم








SIZE ;
29 x 20 x 4 cm
21 x 16 x 4 cm
20 x 10 x 4 cm
19 x 8 x 4 cm

کاست استریلیزاسیون سائز بزرگ

بزرگ: SKST-01 متوسط: SKST-3 SKST-02 SMAL:

کد: SKST-01 + 02 + 03




- کاست استریلیزاسیون پزشکی
- پسر بزرگ
- دارای تخت سیلیکونی خاص
- این به طور ویژه برای کاشت مو و جراحی پلاستیک تولید شده است.

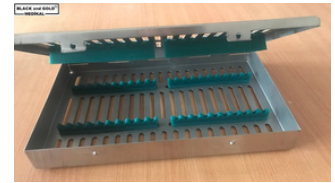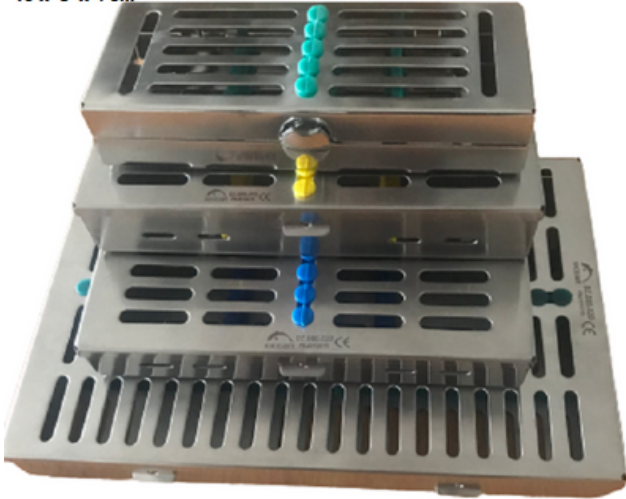

کاست استریلیزاسیون

کد: SKST-05

- ابعاد: 2 × 7 × 16 سانتی متر
- جراحی کاشت مو
- جراحی پلاستیک
- در زمینه ها استفاده می شود.
- کاست استریلیزاسیون یک سری ویژه است.

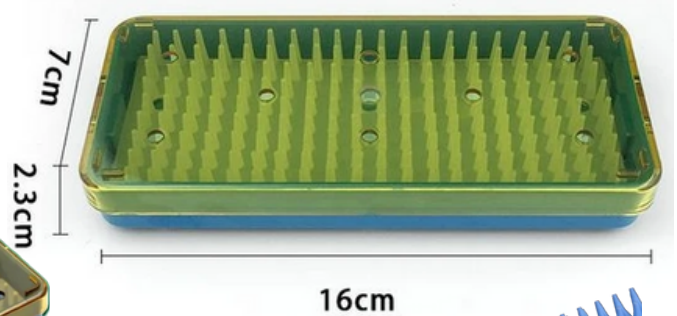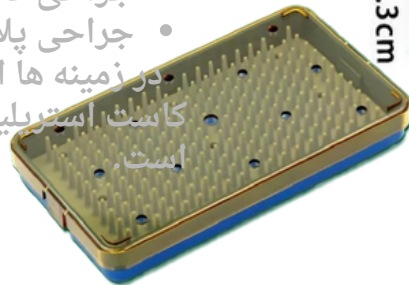

کاست استریلیزاسیون

کد: SKST-05

- ابعاد: 7*15*24 سانتی متر
- جراحی کاشت مو
- جراحی پلاستیک
- در زمینه ها استفاده می شود.
- کاست استریلیزاسیون یک سری ویژه است.





دستگاه اتاق استریل UVC پزشکی
36 متر مربع موثر است

کد: T.UVC-36



- لامپ UV C پزشکی دستگاه اتاق استریل برای 36 متر مربع موثر است.
- مطابق با مقررات تایید شده پزشکی است.
- این محصول آماده مصرف با طراحی کوچک و شیک می باشد.
- با تجهیزات موجود در جعبه می توان آن را در هر مکانی نصب کرد.



خط کش استیل پزشکی 30 سانتی
متر

کد: T.C.C-30

- خط کش اندازه گیری و علامت گذاری فولاد پزشکی
- فولاد طبی است
- طول آن 30 سانتی متر است
- گوشه ها و لبه ها بیضی شکل هستند
- و برش صافی دارند و خراش ندارند.
- قابل استریل شدن است
- فولاد ضد زنگ است.



شانه فولادی پزشکی استریل شده

کد: T.T-01

- شانه طبی فولادی
- شانه فلزی یک مدل اتوکلاو و استریل پذیر است.
- با ساختار فلزی خود سال های طولانی استفاده را فراهم می کند.
- از آلودگی جلوگیری می کند





حلقه كلکسیون پیوند

کد: GRFT.Y-01

- فولاد پزشکی حلقه پیوند
- فولاد 100% طبی
- اندازه حلقه انگشت قابل تنظیم است
- بزرگترین مشکل در جمع آوری و پیوند پیوند طراحی شده تا دستیار شما باشد



قاشق جمع آوری پیوند

کد: GRFT.K-01

- فولاد پزشکی قاشق پیوند
- فولاد 100% طبی
- اندازه حلقه انگشت قابل تنظیم است
- بزرگترین مشکل در جمع آوری و پیوند پیوند طراحی شده تا دستیار شما باشد



بطری اسپری فلزی پزشکی

کد: MSSŞ-300

- بطری اسپری فلزی 300 میلی لیتر
- بدنه فلزی است
- استریل پذیر - قابل اتوکلاو
- این یک مدل پزشکی است که مطابق با مقررات است.





ماشين اصلاح با باترى قابل شستشو و ضد عفونى

كد: TM.B-01



- مدل پزشکی + کامل قابل شستشو
- می تواند در آب کار کند
- باتری است
- همه اندازه ها و شماره های برش موجود است
- برای حداقل 120 دقیقه کار می کند

سیلیکون پزشکی پد آماده سازی پیوند

كد: GRFT.P-30

مجموعه آماده سازی پیوند سیلیکونی قابل استریل شدن است این محصولی است که می توانید پیوندها را بر روی آن جدا کرده، بشمارید و تقسیم کنید.



0,01 mm
mm ve inch



150 mm

ابزار اندازه گیری دیجیتال

كد: DJTL.KPS-01

- خط کش اندازه گیری دیجیتال
- این یک ابزار اندازه گیری دیجیتالی است که با باتری کار می کند و در کاشت مو و پر کردن بوتاکس یا اندازه گیری تقارن استفاده می شود.



كيت كمك هاى اضطرارى

كد: ERP.ES514-B

- مجموعه لارنگوسكوپ
- مجموعه جراحى: فورسپس - فورس - دسته
- چاقوى جراحى - پرتغالى - قيچى
- پى وى سى آموستى
- گردان اتوماتيك
- لوله هاى لوله گذارى
- راه تنفسى
- سيلندر و مانومتر اكسيژن 1 ليتري
- Boyut: 33 x 45 x 15 سانتى متر
- وزن: 3 كيلوگرم

سيلكون پزشكى پد آماده سازى پيوند

كد: ERP.S514-E

- بدنه آلومينيومى
- محفظه هاى داخل
- كفى كفى اسفنجى
- سيستم قفل
- Boyut: 33 x 45 x 15 سانتى متر
- وزن: 2 كيلوگرم
- اسناد مهم - ابزار - مواد شما
- كيسه ايمن و محافظت شده براى



ابزار كاشت مو - كيسه محافظ PENSET

كد: PC-6

- اين براى نگهدارى و حمل نيروى كاشت مو و دستگاه هاى حساس مشابه طراحى شده است.
- 6 چشم دارد
- مخمل صاف داخل
- اين پوست زن است
- سيستم بسته شدن زيپ





مانیتور مانیتور بیمار جراحی کاشت مو مدل PORTABL



امکانات:

کد: HST.MNTR-P01

- اشباع اکسیژن، ضربان نبض (PR)، فشار خون (NIBP) و دمای بدن (OC) است و نظارت جامعی برای بیمار فراهم می کند.
- اندازه گیری دقیق در پرفیوژن کم: می تواند اندازه گیری های دقیقی را حتی در 0.05% پرفیوژن پایین انجام دهد و نتایج قابل اعتمادی را برای شرایط بحرانی ارائه دهد.
- شاخص پرفیوژن: اندازه گیری شاخص پرفیوژن به شما کمک می کند تا وضعیت پرفیوژن را با جزئیات بیشتری بررسی کنید (شاخص پرفیوژن از 0.05% تا 20% متغیر است).
- مناسب برای موقعیت های شدید: می تواند اندازه گیری های دقیقی را حتی در موقعیت های شدید مانند بیماران نوزادی و شوک انجام دهد که استفاده همه جانبه را فراهم می کند.
- دو حالت مختلف اندازه گیری: می توانید بین حالت های خود به خودی (فوری) و نظارت انتخاب کنید.
- ذخیره سازی داده ها: با ویژگی ذخیره سازی داده ها، می توانید به داده های تاریخی دسترسی داشته باشید و روند نمودار را نظارت کنید. شما می توانید 48 ساعت داده بدون وقفه در حالت نظارت دریافت کنید.

SPO 2 PROBU DİJİTAL

کد: STRP-01



- دستگاه اندازه گیری اکسیژن نوع انگشت پالس اکسی متر از Finger
- اکسی متر دیجیتالی 100% نتیجه دقیق پالس اکسی متر دستگاهی است که می تواند ضربان در دقیقه و سطح اکسیژن خون را به ساده ترین و سریع ترین روش اندازه گیری کند و همچنین آن را ثبت کند.



بالش گردن بادی

کد: BYŞ.10

- بالش گردن بادی
- گزینه های رنگی موجود است
- سطح بیرونی مخملی راحتی را فراهم می کند
- این نوع بالش راحت است که بیماران باید برای یک دوره پس از کاشت مو از آن استفاده کنند.

نوار پیشانی پیوند مو

کد: SEB.50

- ادم پس از کاشت مو
- این نواری است که برای جلوگیری از افتادگی استفاده می شود.
- ساختار الاستیک خاص منقبض نمی شود - احساس ناراحتی نمی دهد
- باند وسیع است
- قابل شستشو



گیره کاشت موی بلند

کد: SET.50

- فلز را می توان استریل کرد
- از آن برای ایجاد نواحی کار راحت تر و راحت تر با جمع آوری موها در طی مراحل طولانی کاشت مو استفاده می شود.



50 عدد



C سر سيليكونى

كد: C.SB.01



- در تمام عمليات هاى كه نياز به پشتيبانى از سر دارند استفاده مى شود.
- جراحى كاشت مو (ENT)، جراحى پلاستيك، جراحى عمومى).
- اين بود: $22 \times 8.5 \times 4.5$ سانتى متر.
- از پليمر ويسكوالاستيك ساخته شده است.
- قابل استفاده مجدد است و به راحتى تميز مى شود.
- ضد آب و ضد الكتريسيته ساكن است.
- اين امكان را به فرد مى دهد تا ساعت ها بدون ايجاد مزاحمت يا بر جاى گذاشتن اثرى در حين جراحى كاشت مو، در موقعيت هاى دراز مدت طولانى دراز بكشد.

PURON POZISYON EPEDI

كد: C.SB.02

- هواى ورودى را در وضعيت مستعد بيمار فراهم مى كند.
- : $28 * 24 * 14$ سانتى متر بود
- از پليمر ويسكوالاستيك ساخته شده است.
- قابل استفاده مجدد است و به راحتى تميز مى شود.
- ضد آب و ضد الكتريسيته ساكن است.
- در موقعيت پورون در جراحى كاشت مو؛ اين به شما امكان مى دهد تا براى مدت طولانى راحت بمانيد.
- كاملا ارتوپدى بوده و جاى زخم باقى نماند.



پد سيليكونى مخصوص گردن

كد: C.SB.03



- براى کاهش فشار، محافظت و حمايت در طول تشخيص، درمان و روش هاى جراحى در نظر گرفته شده است.
- $19 * 11 * 8$ سانتى متر بود.
- از پليمر ويسكوالاستيك ساخته شده است.
- قابل استفاده مجدد است و به راحتى تميز مى شود.
- ضد آب و ضد الكتريسيته ساكن است.
- به عنوان پشتيبان گردن در جراحى كاشت مو استفاده مى شود.
- بيمار در طى عمل هاى طولانى هيچ گونه ناراحتى احساس نمى كند، گردن او درد نمى كند و به او اجازه مى دهد تا ساعت هاى طولانى بى حركت بماند.



قلم مارک و طراحی پوست استریل

کد: SCK-10

- رنگ: نقاشی آبی تیره
- بسته بندی استریل است
- 1 قلم طراحی نشانگر پزشکی
- 1 خط کش خاص وجود دارد.
- پس از باز کردن، می توان از آن تا پایان اقامت استفاده کرد.
- از آن برای طراحی + علامت گذاری و نوشتن در طی مراحل کاشت مو استفاده می شود.
- همچنین به عنوان یک قلم نشانگر در نقاشی های جراحی پلاستیک، جراحی عمومی و درموتولوژی و همچنین در روش های خالکوبی استفاده می شود.



قلم مارک و طراحی پوست استریل

کد: CK-B.10

- رنگ: نقاشی سفید
- 1 قلم طراحی نشانگر پزشکی
- 1 خط کش خاص وجود دارد.
- پس از باز کردن، می توان از آن تا پایان اقامت استفاده کرد.
- از آن برای طراحی + علامت گذاری و نوشتن در طی مراحل کاشت مو استفاده می شود.
- همچنین به عنوان یک قلم نشانگر در نقاشی های جراحی پلاستیک، جراحی عمومی و درموتولوژی و همچنین در روش های خالکوبی استفاده می شود.



قلم مارک و طراحی پوست استریل

کد: CK-S.10

- رنگ: نقاشی سیاه
- 1 قلم طراحی نشانگر پزشکی
- 1 خط کش خاص وجود دارد.
- پس از باز کردن، می توان از آن تا پایان اقامت استفاده کرد.
- از آن برای طراحی + علامت گذاری و نوشتن در طی مراحل کاشت مو استفاده می شود.
- همچنین به عنوان یک قلم نشانگر در نقاشی های جراحی پلاستیک، جراحی عمومی و درموتولوژی و همچنین در روش های خالکوبی استفاده می شود.






روبوتو باتيك تيرناك

كد: BTR-05

- نحوه استفاده: قبل از استفاده از محصول، پاهای خود را به مدت 15 دقیقه در آب داغ قرار دهید.
- دو بازوی ابزار را یکی به لبه های ناخن فرورفته خود بچسبانید.
- قسمت تکیه گاه وسط ابزار را با یک دست روی ناخن خود ثابت کنید و پیچ قسمت تکیه گاه را بچرخانید تا احساس انبساط ایجاد شود (این عمل در آب داغ انجام می شود). مراحل چرخاندن و باز کردن پیچ را 3 بار با فاصله 10 دقیقه به مدت نیم ساعت تکرار کنید سپس پای خود را از آب داغ خارج کرده و ناخن های خود را با سشوار خشک کنید.
- ابزار را بردارید و قسمت های اصلاح شده را با قرار دادن پنبه در زیر آنها حمایت کنید.

امکانات:

فولاد ضد زنگ / ضد آب + خم نمی شود و نمی پیچد.
عرض 2. سانتی متر / طول 4 سانتی متر



باتری یخ 13 سانتی متر

كد: BZAK-13

- رنگ آبی
- باتری یخ (با مایع پر شده است).
- ابعاد 13 × 9 × 3.5 سانتی متر
- 110 گرم




13 X 9 X 3,5 CM

باتری یخ 32 سانتی متر

كد: BZAK-32

- رنگ آبی
- باتری یخ (با مایع پر شده است).
- اندازه های IT 32 X 30 X 1.4
- 1200 گرم

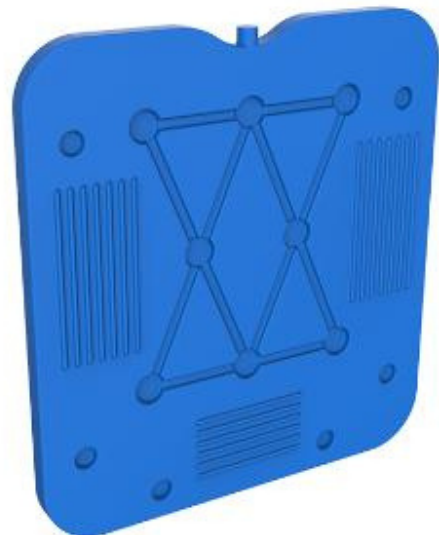



اسپرى روغن كارى نگهدارى موتور

كد: MB-S.500

نحوه استفاده:

- نوک سر اسپرى مخصوص وصل شده است.
- از انتهای موتور يا هداستارت؛
- 3 شاخه سفت شده است. موتور به مدت 30 ثانيه در دور آرام كار مى كند. اين همه چيز است.
- از گرم شدن موتور جلوگیری مى كند
- صدایی كه از موتور مى آيد را قطع كنيد
- از كار سالم تر بدون پياده روى پشتيبانى مى كند
- 500 ميلي ليتر



مزوتراپی مو


كد: HC.HCRM-6X5

- تهاجمی مزوتراپی مو
- كمپلكس سرم MULTIVITAMIN

HC HairCharm

•Sodium	3-5mEq
•Potassium	3-5mEq
•Magnesium	0,3-0,5mEq
•Calcium	2-4mEq
•Phosphorous	1-2mEq
•Zinc (Çinko)	150-200mg
•Copper	10-20mg
•Iron	1mg
•Vitamin A	233units
•Vitamin C	6mg
•Vitamin D	66units
•Vitamin E	0,66units
•Vitamin B (Thiamine)	0,055mg
•Vitamin B2 (Riboflavine)	0,07mg
•Vitamin B3 (Niacine)	0,9mg
•Vitamin B5 (Pantothenic)	0,3mg
•Vitamin B6 (Pyridoxine)	0,05mg
•Biotine (Vitamin B7)	30mg
•Folic Acid (Vitamin B9)	8mg
•Vitamin B12 (Cyanocobalamine)	0,04mg

Saçınız için Gerekli Tüm Vitamin ve Mineralleri İçerir

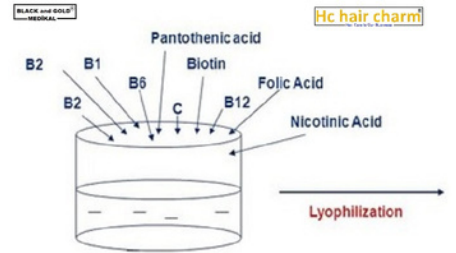

نمایندگی های
توزیع کننده ما

پزشکی بین المللی مو

در صورت داشتن شرایط لازم برای نمایندگی توزیع کننده،
نمایندگی به کشورهای دیگر داده خواهد شد.

برای جزئیات تماس
بگیرید!

پست الکترونیک

info@internationalhairmedical.com

INTERNATIONAL HAIR MEDICAL

www.internationalhairmedical.com

IHM
Since 2020

تلفن

+ 90 533 894 8843 / + 90 662 539 8924

بازرگانی بین المللی رین پزشکی مو. Şti. Ltd.

از سال 2020

مرکز تولید، ساخت، توزیع کننده، نمایندگی، مرکز فروش عمده و خرده فروشی دستگاه
ها و تجهیزات کمکی کاشت مو است.

دارای گواهینامه فروش بین المللی

ما حمل و نقل فعال را به 61 کشور در جهان ارائه می کنیم، به استثنای کشورهایهایی که در آنها نمایندگی های توزیع کننده داریم.

محموله های ما مستقیماً به آدرس تحویل داده می شود.

اگرچه بسته به کشور متفاوت است، تحویل ما از طریق هوایی در عرض 1-4 روز به آدرس تحویل داده می شود، تحویل های ما از طریق جاده در عرض 7-14 روز به آدرس تحویل داده می شود، تحویل ما از طریق دریا + زمین به آدرسی که در داخل است تحویل داده می شود. 14-28 روز.

ما همچنین با بسیاری از روش های پرداخت رسمی مانند کارت اعتباری، پرداخت کارت نقدی + پرداخت از طریق پیوند + انتقال بانکی، راحتی زیادی را به کاربران خود ارائه می کنیم.

به جز کشورهایهایی که در آنها توزیع کننده داریم، فروش سریع نیز از طریق وب سایت آنلاین ما در دسترس است.

تمامی محصولات ما دارای فاکتور و گارانتی بین المللی می باشند.