

# МЕЂУНАРОДНА МЕДИЦИНА ЗА КОСУ

Каталог трансплантације косе и медицинске естетике



**INTERNATIONAL HAIR MEDICAL**

[www.internationalhairmedical.com](http://www.internationalhairmedical.com)

Since 2020

Пружамо брзу и поуздану услугу са  
нашом широком мрежом услуга  
широм света

ГСМ Тел (+90) 539 662 8924 / (+90) 533 894 8843

Е-пошта [инфо@интернационалхаирмедицал.цом](mailto:info@internationalhairmedical.com)

[ихм@интернационалхаирмедицал.цом](mailto:ихм@интернационалхаирмедицал.цом) Веб адреса

[www.интернационалхаирмедицал.цом](http://www.интернационалхаирмедицал.цом) Адреса: Беиликдџу

/ Истанбул. Пк.34528





# Интернатионал Хаир Медицал

## НАША ФИРМА

Као Блацкандголд Медикал Хеалтх Гроуп, са нашим професионалним особљем, снабдевамо наше цењене купце многим медицинским производима, посебно за трансплантацију косе и дермокозметику, са квалитетом / брзим и приступачним ценама.

Са циљем да се специјализује за продају, маркетинг и техничке услуге, на тржишту на којем је присутан;

Успела је да постане омиљена компанија са својом поузданошћу, искуством, нивоом техничког знања и постпродајним услугама.

**ЦЕ СЕРТИФИКАТ / ЕЦ СЕРТИФИКАТ / ПАТЕНТ БРЕНДКЕ -ИСО - ТСЕ СЕРТИФИКАТИ СУ ДОСТУПНИ ЦЕ СЕРТИФИКАТ / ЕЦ СЕРТИФИКАТ / ПАТЕНТ БРЕНДКЕ -ИСО - ТСЕ ЦЕРТИФИКАТИ усаглашености**

**Наша институција; Овлашћена је и одобрена за производњу и продају материјала за трансплантацију косе и медицинских естетских производа.**

Наша институција и наши запослени имају сертификате о продаји и овлашћењу оснивања.

Сви производи које продајемо су регистровани у УТС.

Уз релевантну документацију и потребна обавештења, наша установа ради у сарадњи са системом праћења производа и релевантним смерницама

Министарства здравља у погледу јавног здравља и безбедности производа.

**Сваки производ који купите од Блацк анд Голд Медикал Хеалтх Гроуп проверава се квалитет, добијају се одобрења и документи о дозволи, дају се неопходна обавештења и затим нуде вама, нашим цењеним корисницима, на уживање и употребу.**

100% медицинских хируршких инструмената које користимо произведено је од медицинског челика. Његову тачност потврђују наши приложени документи.

## НАША ВИЗИЈА

Развојем квалитетних, иновативних и различитих производа за ЗДРАВЉЕ, које је за све нас најважније, нудимо услужни приступ животној средини и друштву, посебно вама, нашим цењеним корисницима, без икаквих граница.

## НАША МИСИЈА

Наш циљ је да наставимо са радом као најпоузданија компанија на свету сталним праћењем иновација и технологије у сектору у области трансплантације косе и медицинске естетике, нудећи нашим решењима производе оријентисане на корисника, еколошки прихватљиве и најквалитетније производе. -оријентисани



# Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa  
This certificate has been awarded to the company

**SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin  
To certify that the implemented management system complies with

## ISO 13485:2016

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.  
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN  
ÜRETİMİ VE SATIŞI  
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND  
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 13485:2016 Medikal Kalite Yönetim Sistemi gerektiren yönetim gereklilikleri  
AQC yetkili temsilcisi tarafından kontrol edilmiştir.  
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 13485:2016 and  
it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014520

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024  
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür  
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.



**INTERNATIONAL HAIR MEDICAL**  
[www.internationalhairmedical.com](http://www.internationalhairmedical.com)

Since 2020



# Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa  
This certificate has been awarded to the company

**SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin  
To certify that the implemented management system complies with

## ISO 9001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.  
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN  
ÜRETİMİ VE SATIŞI  
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND  
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 9001:2015 standardına gerektiren yönetim gereklilikleri  
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 9001:2015 and  
it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014521

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024  
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür  
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.



# Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

ATTESTATIONS OF CONFORMITY  
certifies that the company



**SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENİYURTI/ İSTANBUL

has been verified and recognized as  
manufacturer of

**800watt Hair Transplantation Training Set, Graft Shocking Laser Set,  
Hair Line Laser, Needle Free Anesthesia Device, Fox Punch Retractor or Straight,  
Implantation Forceps, Dissection Forceps, Graft Impactor Pen, Fox Micro Motor,  
Hair Analyzer Camera Microscope, Slide Handle, Hair Blade, Hair Transplantation  
Chair, Loop Sizer, Sterilizer Forceps, Scissors, Hair Drip Box Set, Operation  
Led Lamp, Hair Transplant Dressing Cream Set, Graft Tissue Transfer Barum**

according to the rules of  
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and  
of the Council of 5 April 2017 on medical devices

Certificate-no: 014522

The range of validity and details of the inspection can be taken from our  
Report no. CP-301023

CE marking can be affixed on the product after the preparation of the necessary technical  
documentation and the conformity declaration as well as the production control guaranteed  
by the manufacturer and the provision of the other directive fulfilled if any

First Registration Date : 30.10.2023 Expiry Date : 30.10.2024  
Certificate Date : 30.10.2023 Period of Registration : 3 years



Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.



# Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa  
This certificate has been awarded to the company

**SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin  
To certify that the implemented management system complies with

## ISO 45001:2018

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.  
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN  
ÜRETİMİ VE SATIŞI  
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND  
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 45001:2018 standardına gerektiren yönetim gereklilikleri  
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 45001:2018 and  
it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014518

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024  
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür  
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.



# Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa  
This certificate has been awarded to the company

**SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan Çevre yönetim sisteminin  
To certify that the implemented management system complies with

## ISO 14001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla ile aşağıdaki kapsamda verilmiştir.  
For the activities described below

**HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN  
ÜRETİMİ VE SATIŞI  
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND  
COSMETICS PRODUCTS**

Bu belge, firma ISO 14001:2015 standardına gerektiren yönetim gereklilikleri  
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirement of the standard ISO 14001:2015 and  
it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014519

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date) : 30.10.2024  
Sertifika Tarihi (Certificate Date) : 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration) 1 yıl (years)



Genel Müdür  
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşabilirsiniz.





# İnternatıonal Haır Medıcal

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR BLADE

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 12235

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : GRAFT SHOCKING LASER SET

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 3445

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : DIE IMPLANTER PEN

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 3522

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE PUNCH(SERRATED OR STRAIGHT)

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35289

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR TRANSPLANTATION CHAIR

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 38447

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : LOOP EYES

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 3522

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : FUE MICRO MOTOR

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 43915

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : EXTRACTION FORCEPS

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35798

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

**(AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV)**  
**(EU) 2017/745 DECLARATION**  
**OF CONFORMITY(ANNEX-IV)**

ÜRETİCİ ADI / SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MANUFACTURER NAME : SATÖRÜN KÖZMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44 ESENYURTI/ İSTANBUL

TİBBİ ÇHAZIN ADI / DEVICE NAME : HAIR ANALYSER CAMERA MICROSCOP

ÜRÜN SINIFI / (EK 8 Kural 1'e göre) / PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU / GMDN CODE : 35798

TEMEL ÜDÜ-DE / BASIC ÜDÜ-DE : EK II + EK III

UYGUNLUK DEĞ. YOLU / CONF. ASSESSMENT ROUTE : ANNEX II + ANNEX III

İSO 14971:2019, EN 11135-1:2014, TS EN ISO 15223-1:2021, CE EN ISO 13485:2015, EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE İNGİLANDIĞI YER / TARIH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

# Интернационал Хаир Медицал

## (AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI  
MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES  
ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D  
BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TIBBİ CİHAZIN ADI  
DEVICE NAME : NAİL DRILL BOX SET

ÜRÜN SINIFI  
(ÖLÇÜ SINIFI)  
PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU  
GMDN CODE : 35095

MODEL KODU  
MODEL CODE : \_\_\_\_\_

TEMEL ÜDÜ-DE  
BASIC ÜDÜ-DE : \_\_\_\_\_

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU  
CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III  
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı Ek 2'ye göre gerçekleştirilmiştir. Yetenek değerlendirilmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR  
STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019,  
EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021,  
CE MARKING/İNGİZ/EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZ/ANDIĞI) YER,  
TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

## (AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI  
MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES  
ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D  
BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TIBBİ CİHAZIN ADI  
DEVICE NAME : NEEDLE FREE ANESTHESIA DEVICE

ÜRÜN SINIFI  
(ÖLÇÜ SINIFI)  
PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU  
GMDN CODE : 11500

MODEL KODU  
MODEL CODE : \_\_\_\_\_

TEMEL ÜDÜ-DE  
BASIC ÜDÜ-DE : \_\_\_\_\_

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU  
CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III  
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı Ek 2'ye göre gerçekleştirilmiştir. Yetenek değerlendirilmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR  
STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019,  
EN 11135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021,  
CE MARKING/İNGİZ/EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZ/ANDIĞI) YER,  
TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

## (AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI  
MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES  
ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D  
BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TIBBİ CİHAZIN ADI  
DEVICE NAME : NAİL DRILL BOX SET

ÜRÜN SINIFI  
(ÖLÇÜ SINIFI)  
PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU  
GMDN CODE : 35095

MODEL KODU  
MODEL CODE : \_\_\_\_\_

TEMEL ÜDÜ-DE  
BASIC ÜDÜ-DE : \_\_\_\_\_

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU  
CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III  
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı Ek 2'ye göre gerçekleştirilmiştir. Yetenek değerlendirilmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR  
STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019,  
EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021,  
CE MARKING/İNGİZ/EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZ/ANDIĞI) YER,  
TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

## (AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI  
MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES  
ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D  
BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TIBBİ CİHAZIN ADI  
DEVICE NAME : FUE PUNCH/SERRATED OR STRAIGHT

ÜRÜN SINIFI  
(ÖLÇÜ SINIFI)  
PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU  
GMDN CODE : 35289

MODEL KODU  
MODEL CODE : \_\_\_\_\_

TEMEL ÜDÜ-DE  
BASIC ÜDÜ-DE : \_\_\_\_\_

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU  
CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III  
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı Ek 2'ye göre gerçekleştirilmiştir. Yetenek değerlendirilmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR  
STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019,  
EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021,  
CE MARKING/İNGİZ/EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZ/ANDIĞI) YER,  
TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

## (AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI  
MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES  
ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D  
BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TIBBİ CİHAZIN ADI  
DEVICE NAME : HAIR TRANSPLANTATION CHAIR

ÜRÜN SINIFI  
(ÖLÇÜ SINIFI)  
PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU  
GMDN CODE : 38447

MODEL KODU  
MODEL CODE : \_\_\_\_\_

TEMEL ÜDÜ-DE  
BASIC ÜDÜ-DE : \_\_\_\_\_

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU  
CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III  
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı Ek 2'ye göre gerçekleştirilmiştir. Yetenek değerlendirilmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR  
STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019,  
EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021,  
CE MARKING/İNGİZ/EN ISO 14155:2020

START OF CE MARKING : 30.10.2023

DATE (İNGİZ/ANDIĞI) YER,  
TARİH PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

## (AB) 2017/745 UYGUNLUK BEYANI(EK-IV) (EU) 2017/745 DECLARATION OF CONFORMITY(ANNEX-IV)

ÜRETİCİ ADI  
MANUFACTURER NAME : SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES  
ADDRESS : GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D  
BLK. NO:44 ESENYURT/ İSTANBUL.

TIBBİ CİHAZIN ADI  
DEVICE NAME : LOOP EYES

ÜRÜN SINIFI  
(ÖLÇÜ SINIFI)  
PRODUCT CLASS : CLASS I (according to rule 1 Annex VIII)

GMDN KODU  
GMDN CODE : Y022 44480

MODEL KODU  
MODEL CODE : \_\_\_\_\_

TEMEL ÜDÜ-DE  
BASIC ÜDÜ-DE : \_\_\_\_\_

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YOLU  
CONF. ASSESSMENT ROUTE : Ek II + Ek III  
ANNEX II + ANNEX III

Bu belge ile yukarıda bahsi geçen ürünün Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı Ek 2'ye göre gerçekleştirilmiştir. Yetenek değerlendirilmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile.

We hereby declare that the above-mentioned products meet the provisions of the medical devices regulation (EU) 2017/745. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer. This Declaration of Conformity is issued on the basis of fulfillment the requirements of Annex IV of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

UMURLANAN STANDARTLAR  
STANDARDS APPLIED : EN ISO 14971:2019,  
EN 13135:2014, TS EN ISO 15223-1:2021,  
TS EN ISO 14155:2020

CE MARKALANMA TARİHİ  
START OF CE MARKING DATE : 30.10.2023

İNİZ/ANDIĞI) YER, TARİH  
PLACE, DATE OF ISSUE : İSTANBUL, 30.10.2023 GENEL MÜDÜR

## Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTIFİKA  
ATTESTATIONS OF CONFORMITY  
certifies that the company  
**SATURIN MEDICAL**  
has been verified and recognized as  
manufacturer of  
SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENYURT/ İSTANBUL.

İzmitliğin Tabii Cihazlar Regülasyonu'na (AB) 2017/745, uygun olduğu beyan edilir. Bu beyanı destekleyici bütün dokümanlar firmamız arşivinde muhafaza edilir. Bu Uygunluk Beyanı Ek 2'ye göre gerçekleştirilmiştir. Yetenek değerlendirilmiştir. Tabii Cihaz Yürürlüğü (AB) 2017/745 ile.

By the manufacturer and the producer of the other directive fulfilled if any

CE marking can be affixed on the product after the presentation of the necessary technical documentation and the conformity declaration as well as the production control guarantee.

Executive Manager

## Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTIFİKA  
Bu sertifika aşağıdaki kuruluşta  
This certificate has been awarded to the company  
**SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.**  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENYURT/ İSTANBUL.

Uygulanmakta olan yönetmelik sistemini  
To certify that the implemented management system complies with  
**ISO 13485:2016**  
Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla bu aşağıdaki kapsama verilmektedir.  
To the activities described below  
HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN  
GÜRETİMİ VE SATIŞI  
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND  
COSMETICS PRODUCTS

By the manufacturer and the producer of the other directive fulfilled if any

Executive Manager

## Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTIFİKA  
Bu sertifika aşağıdaki kuruluşta  
This certificate has been awarded to the company  
**SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.**  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENYURT/ İSTANBUL.

Uygulanmakta olan Çevre Yürürlüğü sistemini  
To certify that the implemented management system complies with  
**ISO 14001:2015**  
Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla bu aşağıdaki kapsama verilmektedir.  
To the activities described below  
HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN  
GÜRETİMİ VE SATIŞI  
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND  
COSMETICS PRODUCTS

By the manufacturer and the producer of the other directive fulfilled if any

Executive Manager

## Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİ - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTIFİKA  
Bu sertifika aşağıdaki kuruluşta  
This certificate has been awarded to the company  
**SATURIN KOSMETİK MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.**  
GÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44  
ESENYURT/ İSTANBUL.


Uygulanmakta olan Çevre Yürürlüğü sistemini  
To certify that the implemented management system complies with  
**ISO 9001:2015**  
Standartına uygunluğunu belgelemek amacıyla bu aşağıdaki kapsama verilmektedir.  
To the activities described below  
HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOSMETİK ÜRÜNLERİN  
GÜRETİMİ VE SATIŞI  
PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND  
COSMETICS PRODUCTS

By the manufacturer and the producer of the other directive fulfilled if any

Executive Manager

### Дуз Фие Моторизе Пунцх

- Користи се немачки челик 1. класе.
- Доступна су различита мерења пречника и дужине.
- Регистрован код УББ, одобрен од Министарства здравља
- Нуди минимално инвазивну хирургију
- Посебно Схарп структура врха пружа најминималну осетљивост ткива
- Осигурава лако уклањање фоликула графта на најнежнији и неоштећујући начин.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	D625	D63	D635	D64	D65
0.6-5	D6525	D653	D6535	D654	D655
0.7	D725	D73	D735	D74	D75
0.7,5	D7525	D753	D7535	D754	D755
0.8	D825	D83	D835	D84	D85
0.8,5	D8525	D853	D8535	D854	D855
0.9	D925	D93	D935	D94	D95
0.9,5	D9525	D953	D9535	D954	D955
1	D125	D13	D135	D14	D15
1,1	D1125	D113	D1135	D114	D115
1,2	D1225	D123	D1235	D124	D125
1,3	D1325	D133	D1335	D134	D135



ТИРТИКЛИ / ИИЛДИЗ Фуге Моторизе  
Пунцх

- Користи се немачки челик 1. класе.
- Доступан у 6 назубљених и 8 назубљених модела
- Доступни су назубљени листови и назубљени тестери
- Доступна су различита мерења пречника и дужине.
- Регистрован код УББ, одобрен од Министарства здравља
- Нуди минимално инвазивну хирургију
- Посебно Схарп структура врха пружа најминималну
- Осигурава лак



ула  
ујући

ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	T625	T63	T635	T64	T65
0.6-5	T6525	T653	T6535	T654	T655
0.7	T725	T73	D735	T74	T75
0.7,5	T7525	T753	T7535	T754	T755
0.8	T825	T83	T835	T84	T85
0.8,5	T8525	T853	T8535	T854	T855
0.9	T925	T93	T935	T94	T95
0.9,5	T9525	T953	T9535	T954	T955
1	T125	T13	T135	T14	T15
1,1	T1125	T113	T1135	T114	T115
1,2	T1225	T123	T1235	T124	T125
1,3	T1325	T133	T1335	T134	T135







## КСС (екстра-безбедно) Феу Пунцх Моторизе



- Користи се немачки челик 1. класе.
- То је модел са врхом који се више савија према споља.
- Доступна су различита мерења пречника и дужине.
- Регистрован код УББ, одобрен од Министарства здравља
- Нуди минимално инвазивну хирургију
- Посебно Схарп структура врха пружа најминималну осетљивост ткива
- Осигурава лако уклањање фоликула графта на најнежнији и нештећујући начин.


ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	XS625	XS63	XS635	XS64	XS65
0.6-5	XS6525	XS653	XS6535	XS654	XS655
0.7	XS725	XS73	XS735	XS74	XS75
0.7,5	XS7525	XS753	XS7535	XS754	XS755
0.8	XS825	XS83	XS835	XS84	XS85
0.8,5	XS8525	XS853	XS8535	XS854	XS855
0.9	XS925	XS93	XS935	XS94	XS95
0.9,5	XS9525	XS953	XS9535	XS954	XS955
1	XS125	XS13	XS135	XS14	XS15
1,1	XS1125	XS113	XS1135	XS114	XS115
1,2	XS1225	XS123	XS1235	XS124	XS125
1,3	XS1325	XS133	XS1335	XS134	XS135



0.08 mm

Tip Length 5 mm

36 mm

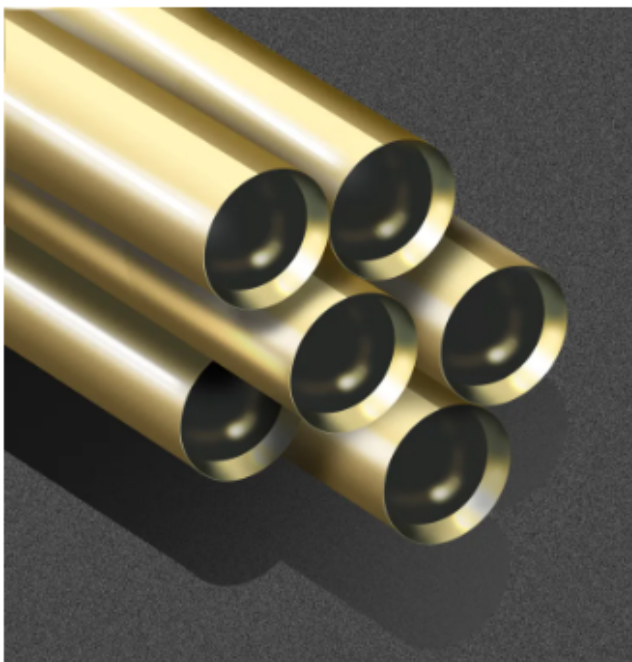



## Фуе Пунцх моторизован за дугу косу



- Користи се немачки челик 1. класе.
- Врх је посебно направљен са жлебовима да спречи ломљење дуге косе.
- Доступна су различита мерења пречника и дужине.
- Регистрован код УББ, одобрен од Министарства здравља
- Нуди минимално инвазивну хирургију
- Посебно Схарп структура врха пружа најминималну осетљивост ткива
- Осигурава лако уклањање фоликула

графта на најнежнији и нештећујући начин.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	US625	US63	US635	US64	US65
0.6-5	US6525	US653	US6535	US654	US655
0.7	US725	US73	US735	US74	US75
0.7,5	US7525	US753	US7535	US754	US755
0.8	US825	US83	US835	US84	US85
0.8,5	US8525	US853	US8535	US854	US855
0.9	US925	US93	US935	US94	US95
0.9,5	US9525	US953	US9535	US954	US955
1	US125	US13	US135	US14	US15
1,1	US1125	US113	US1135	US114	US115
1,2	US1225	US123	US1235	US124	US125
1,3	US1325	US133	US1335	US134	US135



IHM Fue Motorize



## ИХМ 25 РЕД Доубле Хандпиеце

1 стандардни насадник  
1 метални ручник десно -  
лево ротација  
35000 о/мин Компатибилян  
са 110 - 220 в



Доубле  
Хандпиеце  
Ергономска употреба  
Лагани насадник Тихи  
насадник Заменски  
насадник



## ИХМ25 РЕД

Метални ручник не цури.  
Дуготрајан, једноставан за  
употребу, ручни насадник, ултра  
тих и лаган. Омогућава вам да  
извучете здравије корене  
калемова и не умара вас.



ИХМ 25  
Доубле  
Хандпиеце

1 стандардни насадник  
1 метални ручник десно -  
лево ротација  
35000 о/мин Компатибилян  
са 110 - 220 в



Доубле  
Хандпиеце  
Ергономска употреба  
Лагани насадник Тихи  
насадник Заменски  
насадник



ИХМ25  
ПИНК

Метални ручник не цури.  
Дуготрајан, једноставан за  
употребу, ручни насадник, ултра  
тих и лаган. Омогућава вам да  
извучете здравије корене  
калемова и не умара вас.



## Маратон Х37

Л  
Стандардни насадник  
35000 о/мин десно-лијево  
ротација. Могућност ручне  
и ножне контроле на угаљ,  
ваздушно хлађење  
Компатибилно са 110 - 220 в



## Х 37 Л

Боја: Сива Порекло: Кореја  
Тежина: 236 Гр Хлађење:  
Ваздушно хлађење Систем  
угља



## Маратон Х 37

Л  
Могућност контроле рукама  
и ногама  
35000 обртаја у минути  
Подесива брзина ротације  
Десни и леви радни циклус





## Јака 210

стандардни насадник  
35000 о/мин десно-лијево  
ротација. Могућност ручне  
и ножне контроле на угаљ,  
ваздушно хлађење  
Компатибилно са 110 - 220 в



## Јака 210

Боја: Бела Порекло: Кореја  
Тежина: 236 Гр Хлађење:  
Ваздушно хлађење Систем  
угља



## Јака 210

Могућност контроле рукама  
и ногама  
35000 обртаја у минути  
Подесива брзина ротације  
Десни и леви радни циклус





## Есцорт 2 Про СХ20Н

Ручни део са металним врхом  
35000 обртаја у минути  
десно - лево ротација  
Ваздушно хлађена  
могућност ручне и ножне  
контроле Компатибилно са  
110 - 220 в

## СХ 300

Боја: Бела Порекло: Кореја  
Тежина: 190 Гр Хлађење:  
Ваздушно хлађење



## Complete set



## Цхампион СХ20Н

Могућност контроле рукама  
и ногама  
35000 обртаја у минути  
Подесива брзина ротације  
Десни и леви радни циклус



## ИХМ ГРИ

### КОД: МБОКС.ИХМ-ГРИ

Ручни део са металним врхом  
30000 обртаја у минути  
десно - лево ротација  
Ваздушно хлађена  
могућност ручне и ножне контроле  
Компатибилно са 110 - 220 в



## ИХМ ГРИ

### КОД: МБОКС.ИХМ-СИХ

Ручни део са стандардним врхом  
35000 обртаја у минути  
десно - лево ротација  
Ваздушно хлађена  
могућност ручне и ножне контроле  
Компатибилно са 110 - 220 в



## ХИМ БЛУЕ

### КОД: МБОКС.ИХМ-МВ

Ручни део са стандардним врхом  
35000 обртаја у минути  
десно - лево ротација  
Ваздушно хлађена  
могућност ручне и ножне контроле  
Компатибилно са 110 - 220 в







## ПРИЧАЈ СА ЊИМ

**КОД: МБОКС.ИХМ-  
КРМЗ**

Ручни део са металним  
врхом  
30000 обртаја у минути  
десно - лево ротација  
Ваздушно хлађена  
могућност ручне и ножне  
контроле Компатибилно са  
110 - 220 в

## БЛАЦК МЕТАЛ ПИЕЦЕСМЕН

**КОД: МБОКС.ИХМ-  
МТЛ**

Ручни део са стандардним  
врхом  
30000 обртаја у минути  
десно - лево ротација  
Ваздушно хлађена  
могућност ручне и ножне  
контроле Компатибилно са  
110 - 220 в



## ЦРНО ПЛАВИ РУЧНИК

**КОД: МБОКС.ИХМ-  
МВ-01**

Ручни део са стандардним  
врхом  
35000 обртаја у минути  
десно - лево ротација  
Ваздушно хлађена  
могућност ручне и ножне  
контроле Компатибилно са  
110 - 220 в





## М БОКС КОРЕ

### КОД: МБОКСК

Ручни део са металним врхом  
35000 о/мин десно - лево ротација Ваздушно хлађена опција ручне и ножне контроле Ергономска осетљивост рукохвата Компатибилан са 110 - 220 в

## М БОКС МЕТАЛ ПИИАСЕМЕН

Боја: Бела - Плава - Црвена - Црна  
Порекло: Кореја Тежина: 170 гр  
Хлађење: Ваздушно хлађење

### КОД: МБОКСМ



## М БОКС - Кореја

Могућност контроле рукама и ногама  
35000 обртаја у минути  
Подесива брзина ротације  
Десни и леви радни циклус



**БЕЛА + ПЛАВА + ЦРВЕНА + ЦРНА**  
**КОД: МБОКС.Б МБОКСМ МБОКСК МБОКСС**



**K38**

Portable type  
Digital speed window

**MH20**

Max. 30,000rpm  
130g

## Пуњиви преносиви фуге микро мотор

**КОД: МХ20К38**

Ручни део са металним врхом  
35000 о/мин Ротација десно-лево До 6 сати употребе са пуним пуњењем Дигитални дисплеј Индикатор Индикатор за монтажу на каиш Прикључак Компатибилан са 110 - 220 В

## Пуњиви преносни микро мотор

Боја: Бела - Зелена - Црвена - Црна  
Порекло: Кореја Тежина: 170 гр  
Хлађење: Ваздушно хлађење



## Преносни Фуге микро мотор

**КОД: ММСРЈ-01**

Дигитални индикатор дисплеја  
35000 обртаја у минути  
Подесива брзина ротације  
Десни и леви радни циклус





## ХМИ Дигитал Фуе Мицро Мотор

**КОД: БЛЦК-01 Д**

Ручни део са металним  
врхом  
35000 о/мин Ротација  
удесно - лево Дигитални  
индикатор дисплеја  
Могућност ручне и ножне  
контроле ручице од 190 гр  
Компатибилна са 110 - 220 в

## ХМИ Дигитал Фуе Мицро Мотор

Боја: Бела Порекло: Кореја  
Тежина: 190 Гр Хлађење:  
Ваздушно хлађење Дигитални  
панел



## ХМИ Дигитал Фуе Мицро Мотор

**Профосионел Фуе Мицро  
Мотор**





## ХМИ Дигитал Фуе Мицро Мотор С200

**КОД: БЛЦК-01 Д**

Ручни део са металним врхом  
35000 о/мин Ротација  
удесно - лево Дигитални индикатор дисплеја  
Могућност ручне и ножне контроле ручице од 190 гр  
Компатибилна са 110 - 220 в

## ХМИ Дигитал Фуе Мицро Мотор С200

Боја: Бела Порекло: Кореја  
Тежина: 190 Гр Хлађење:  
Ваздушно хлађење Дигитални панел



Hand Control Knob

Knee Control Cover

Digital RPM&Error Disply

On /Off Switch

Hand  
Knee  
Foot



Fwd  
Rev



Standby  
Working



## ХМИ Дигитал Фуе Мицро Мотор С200

Професионал Фуе Мицро Мотор





КОД:ОСЛСИН-Д.01



## Цхиропро Плус Осиласионлу Фуе Мицро Мотор

Најпрофесионалнији познати микро-мотор Цхиропро Плус 50000 об/мин Ротација десно - лево ОСКУЛАЦИЈА - напред-назад 360 степени Најбоље је за добијање дугих корена косе. Опције главе су вишеструке

## Цхиропро Плус Осиласионлу Фуе Мицро Мотор

Комплет каблова и насадника који се може аутоклавирати

Хируршки професионални сет



## Цхиропро Плус Осиласионлу Фуе Мицро Мотор

Пружа могућност прања радног подручја течношћу - серумом





Маратхон – Јака и универзална ручица са 3 пинског улаза, округла утичница, компатибилна са свим моторима

35000 о/мин Ротација десно-лево Модел са ваздушним хлађењем угља  
260 Гр

Универзална величина замјенски ручник

Х 37 Л Модел



marathon

Х 37 Л Модел

Боја: црна - плава





### С 30 ПИИАСЕМЕН



- Dimensions : L129 x Ø22 (mm)
- Speed : 0 - 30,000 rpm
- Max. Torque : 2.9 Ncm
- Weight : 143g
- Cord length : 1.5m

#### КОД: И.ПИСМН.М-01

35000 о/мин Ротација десно-  
лево Модел са ваздушним  
хлађењем угља  
260 Гр

### С 30 ПИИАСЕМЕН



### С 30 ПИИАСЕМЕН

Боја: сива







Врх ручника који се може аутоклавирати



40000 о/мин Ротација десно-лево  
Ваздушно хлађен модел  
угља  
95 Гр



Метални стерилизовани врх ручице који се може аутоклавирати  
Боја: гир

Кабл за аутоклавирање



40000 о/мин Ротација десно-  
лево Ваздушно хлађен модел  
угља  
95 Гр



Кабл за  
аутоклавирање



Боја: гир





### Н 30 Фондација



**КОД: ИП.Н30**

30000 о/мин Ротација десно-лево Ваздушно хлађење  
Компатибилно са свим моторима са 160 Гр+ универзалним улазом

### НБОКС ИХМ ЗАМЕНСКИ НАРУЧНИК РЕД

**КОД :ИП.МБОКС-БЛАЦК.КРМЗ**

30000 о/мин Ротација десно-лево Ваздушно хлађење  
Компатибилно са свим моторима са 160 Гр+ универзалним улазом



### НБОКС ИХМ ЗАМЕНСКИ КОМАД КОМАД ЦРНИ

**КОД :ИП.МБОКС-БЛАЦК.СИХ**

30000 о/мин Ротација десно-лево Ваздушно хлађење  
Компатибилно са свим моторима са 160 Гр+ универзалним улазом





### Размисли о томе

Голд Серис Графт Сакупљање и уклањање клешта Тип Тицкле структура може бити посебно произведена.

Дизајниран је да не оштети фоликуле графта.



### ИХМ Топлама Пенсети



Gold Serisi Toplama Penseti Size Tablosu

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755

### Екстракција злата





## ДХИ - ЦХОИ ПЕН ПЕНСЕ

Голд Сериес ДХИ ПЕН СЕРИЕС  
 ФОРЦЕТ Омогућава лако уметање  
 графта у пен.  
 Нуди једноставну употребу са својим  
 ергономским рукохватом и не умара  
 руку.



УЏ	АЏИ			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755



## Голд Тхи Имплантер Пен Арраи / Инсертион Форцеп



## Златне клешта за трансплантацију

Наше клешта за трансплантацију Голд серије су 100% медицински нерђајући челик. Персонализована опција хватања врха. Структура врха Дужина врха Доступне су опције за угао врха. Пинцете Голд серије припадају нашем бренду.

## ПОСМАТРА ЋЕ ФОРЦЕС Голд Сериес

### ГОЛД СЕРИЕС

- Дужина врха
- Угао врха
- Степен тврдоће: Грип
- Тип Структура

Има опције


УЏ			АЏИ	
	40°	45°	50°	55°
<b>4 mm</b>	TP440	TP445	TP450	TP455
<b>5 mm</b>	TP540	TP545	TP550	TP555
<b>6mm</b>	TP640	TP645	TP650	TP655
<b>7mm</b>	TP640	TP645	TP750	TP755
<b>EK</b>	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
<b>EK UЏ</b>	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT





## Пинцете за трансплантацију са златном перфорираном ручком

Пинцете за трансплантацију Голд серије су 100% медицински нерђајући челик. Персонализована опција хватања врха. Структура врха Дужина врха Доступне су опције за угао врха. Пинцете Голд серије припадају нашем бренду.

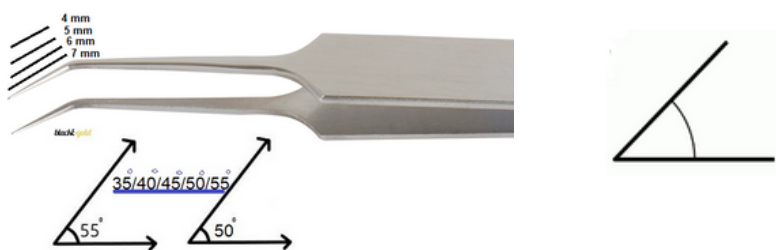

### ПОСМАТРАЊЕ СИЛА Перфорирана ручка


#### ГОЛД СЕРИЕС

- Дужина врха
- Угао врха
- Степен тврдоће: Грип
- Тип Структура

Има опције

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
<b>4 mm</b>	TP440	TP445	TP450	TP455
<b>5 mm</b>	TP540	TP545	TP550	TP555
<b>6mm</b>	TP640	TP645	TP650	TP655
<b>7mm</b>	TP640	TP645	TP750	TP755
<b>EK</b>	<b>YUMŞAK</b>	<b>ORTA</b>	<b>SERT</b>	<b>HARD</b>
<b>EK UÇ</b>	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT



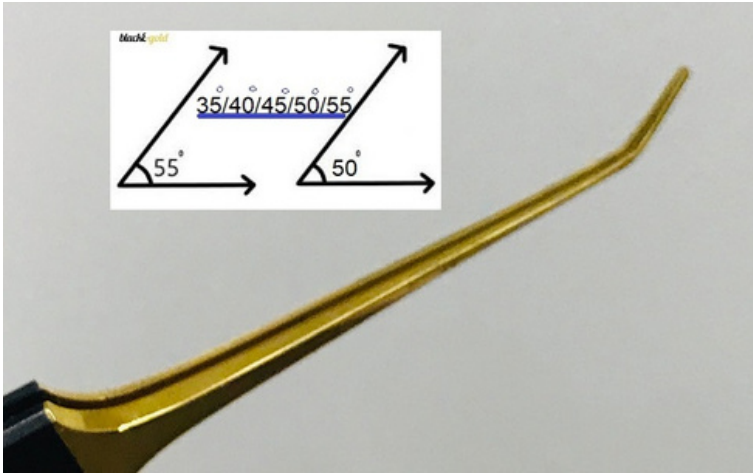

## Керамички модел кешта за трансплантацију

Керамичка верзија кешта за сетву

Грип Хандле дршка обложена керамиком;

- Не изазива знојење
- Антистатичан је, не изазива струју
- Позлаћени врх се не лепи за калем
- Пружа лаку и здраву прилику за садњу



UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
<b>4 mm</b>	TP440	TP445	TP450	TP455
<b>5 mm</b>	TP540	TP545	TP550	TP555
<b>6mm</b>	TP640	TP645	TP650	TP655
<b>7mm</b>	TP640	TP645	TP750	TP755
<b>EK</b>	<b>YUMŞAK</b>	<b>ORTA</b>	<b>SERT</b>	<b>HARD</b>
<b>EK UÇ</b>	STANDART	İĞNE	TOPUZ	KÜNT










## Пинцете за трансплантацију модела титанијума

То је модел од титанијума.  
Лакши је и издржљивији

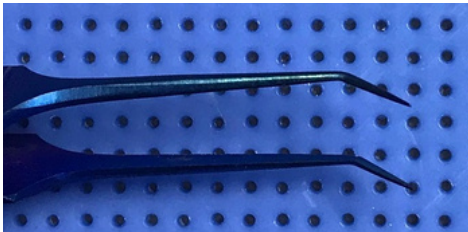

УЏ	АЏИ			
	40°	45°	50°	55°
<b>4 mm</b>	TP440	TP445	TP450	TP455
<b>5 mm</b>	TP540	TP545	TP550	TP555
<b>6mm</b>	TP640	TP645	TP650	TP655
<b>7mm</b>	TP640	TP645	TP750	TP755
<b>EK</b>	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
<b>EK UЏ</b>	STANDART	IĞNE	TOPUZ	KÜNT

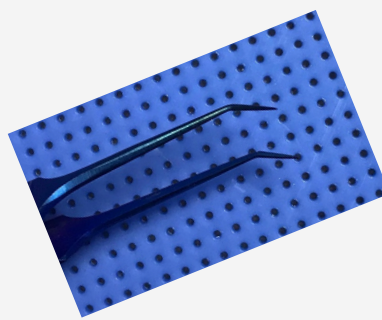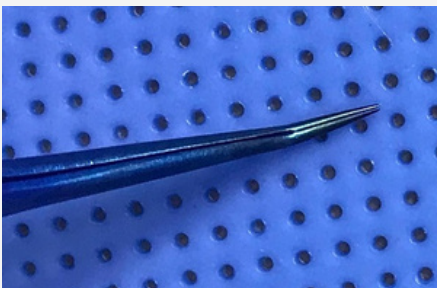




### Титаниум Моон Форцепс серија

То је серија Титаниума.  
Погодан је за вишегодишњу  
употребу. Може се  
стерилисати. То је  
медицински производ за  
вишекратну употребу.  
Користи се за уобичајене  
сврхе у трансплантацији -  
прикупљању - поравнању  
или постављању Дхи  
оловке.

### ИС ПЛИЕРС

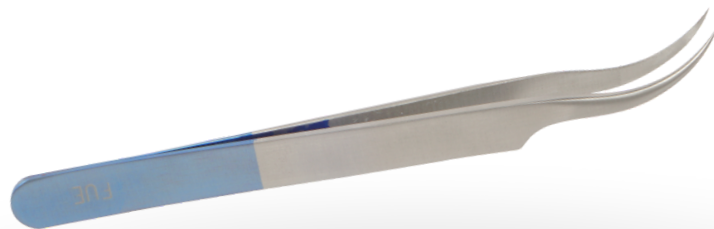

### БЛАЦК&ГОЛД ИС ОЛОВКЕ






## Голд Арраи Форцепс

То је Голд серија.  
Дизајниран је за  
распоређивање и одвајање  
фоликула у чеоним  
графтовима.  
Има структуру танког врха  
која неће оштетити ткиво.  
То је 100% нерђајући  
медицински челик.

## Софа Цхаир

Прави врх игле ГОЛД серија  
Арраи пинцета

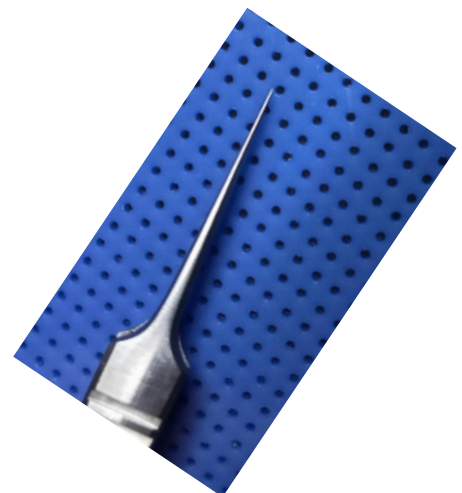



## Клизна ручка типа оловке

Шифра: СТХ-К



- То је златна серија
- Има дијамантски врх. Не клизи.
- Држи клизне ножеве свих величина
- Дугачак је 15 цм
- Тешка је 50 гр
- Обезбеђује сигурно држање помоћу компресијске копче
- Има дијамантски врх који омогућава компресију под углом.
- Омогућава ергономску и једноставну употребу

## РУЧКА ЗА ЗАКЉУЧАВАЊЕ КЛИЗНА РУЧКА

Шифра: СТХ-ДК

- То је Голд серија.
- Чврсто хвата све врсте клизних ножева, укључујући дебље клизаче, и никада не пушта.
- Има главу са дијамантским врхом
- Користи се у пластичној хирургији и хирургији трансплантације косе
- Хоризонтални грип је одличан дизајн за оне који имају радне навике.



## СТАНДАРТ СЛИДЕ ХАНДЛЕ КОД: СТХ-СМ



- Дијамантска глава златне серије
- Клизна оштрица држи све величине
- Дужина је 14-15 цм
- Не скролује
- Користи се у хирургији косе и пластичној хирургији
- То је 100% медицински нерђајући челик



## РУЧНИ ФУЕ ПУНЦХ и ДРШКА ИГЛОМ Шифра: МФПХ-02

- То је златна серија
- Универзална величина је била пунч тутар
- Универзална величина држи врх игле
- Има подесиву главу компресије
- Ручна берба калемова
- Користи се у ручним операцијама перкутаног отварања канала убацивањем игле.
- Назубљена ручка омогућава лако и неклизатуће држање
- То је 100% нерђајући медицински челик

## НОЖ - ДРШКА ИГЛ

Шифра:  
МФПХ-01

- АЛУМИНИЈСКО ТЕЛО
- Подесива глава компресије
- 4-угаона компресијска глава
- Медицински материјали који не рђају
- Користи се у операцијама које се изводе држањем игле и ножа.
- Трансплантација косе - Тетовирање - Перкутано жлебљење и Пластична хирургија су главне области употребе.



## БИСТУРИ ХАНДЛЕ КОД: БСТР-15


- 100% МЕДИЦИНСКИ ЧЕЛИК
- КОМПАТИБИЛАН ЈЕ СА ЛОПАЦИЈАМА ВАГЕ БРОЈ 11-15
- БУДУЋИ ДА ЈЕ ТИП ОЛОВКА, НУДИ ВЕОМА УДОБНУ И УДОБНУ МОГУЋНОСТ ЗА РАД





### САППХИРЕ ДРЖАЧ

ТИТАНИЈУМ МОДЕЛ ДРЖАЧ САФИРА ЈЕ КОМПАТИБИЛАН СА СВИМ БРОЈЕВИМА ЈЕ МОДЕЛ УНИВЕРЗАЛНЕ ВЕЛИЧИНЕ

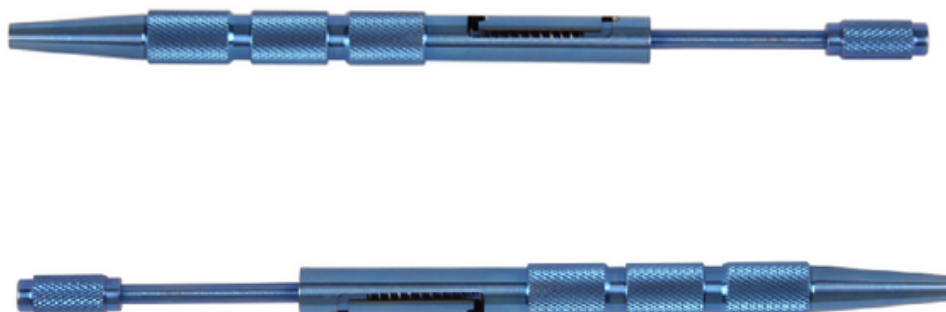

### САППХИРЕ БЛАДЕС

- САПФИРСКЕ ЛОЧИЦЕ СУ ОРИГИНАЛНИ МОДЕЛИ.
- УНИВЕРСАЛ ЈЕ КОМПАТИБИЛАН СА СВИМ ОЛОВКАМА
- АУТОКЛАВИРАЊЕ - СТЕРИЛИЗОВАНО
- АНТИАЛЕРГИЈСКИ
- МИНИМАЛНА ТРАУМА ТКИВА СА МИНИМАЛНИМ РЕЗОМ
- МНОГО БРЖИ ОПОРАВАК
- БРОЈЕВИ СУ ДОСТУПНИ ЗА ВАС



### ВЕЛИЧИНА:

**1 - 1,1 - 1,2 - 1,3 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7**






**СП 90  
СПЕЦИЈАЛН  
О ОЖИВО  
СТЕРИЛНО**

**СП 90 СМАЛЛ  
БЛАДЕ**

- 0,8мм
- 0,9 мм
- 1,0 мм
- 1,1 мм
- 1,2 мм
- 1,3 мм
- 1,4 мм
- 1,5 мм 1,6 мм 1,7 мм

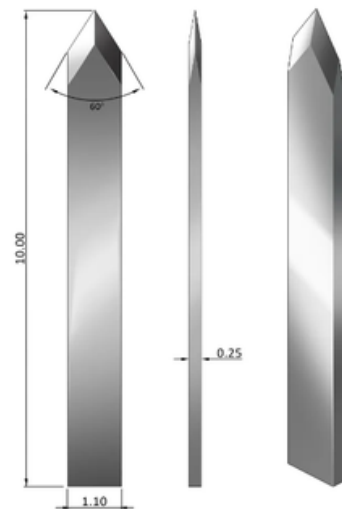

сечива за жлеbove



**ПРЕ-ЦУТ  
СЛИД**

Сече се специјалним машинама и потпуно је глатка и оштра.

**Садржај паковања: 25 комада СИЗЕ**


**08 - 1 - 1,1**

**1,2 - 1,3 - 1,4**

**1,5 - 1,6 - 1,7**



## ОКТ'нин 10 Avantajı

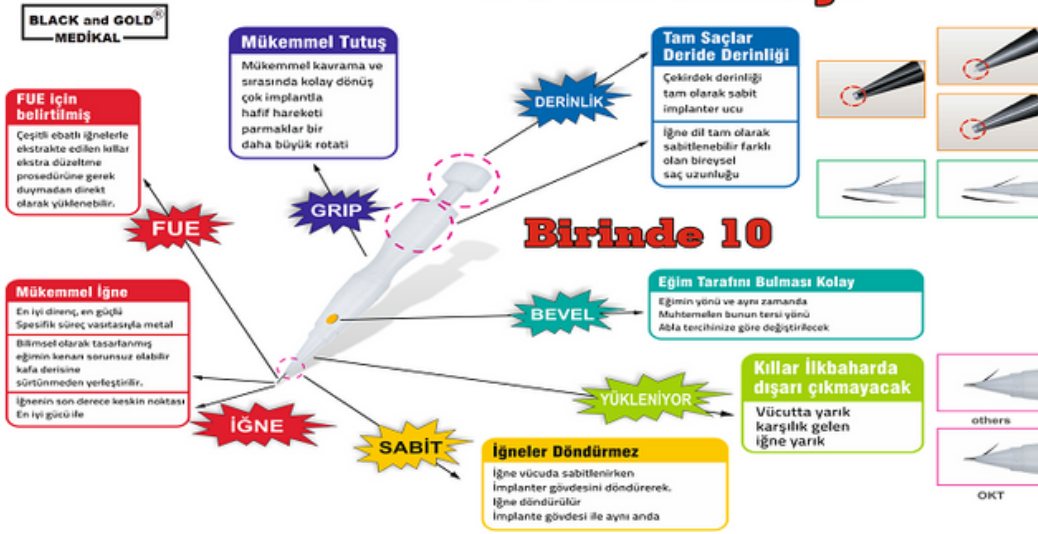

## ОКТ Цхои Имплантер Пен


- То је медицинска оловка за трансплантацију косе
- Користи се за природну трансплантацију косе
- Пружа гушћу и чешћу прилику за садњу
- Садња је лакша
- Могућност давања правца приликом постављања сваког корена
- може се стерилисати
- То је производ за поновну употребу
- Само игле се мењају како постану тупе.
- Доступан у кутијама од 10 комада
- Има разних бројева
- трансплантација косе
- Сакал Екиими
- Трансплантација обрва

## ОКТ Дхи имплантати

Подешава се окретањем круга у области хватања врха игле.  
Окретање улево: ПРОДУЖУЈЕ врх игле.  
Окретање удесно: СКРАЋА врх игле



**МАВИ - 0,9 мм**  
**ЦРВЕНА - 1,02 мм**

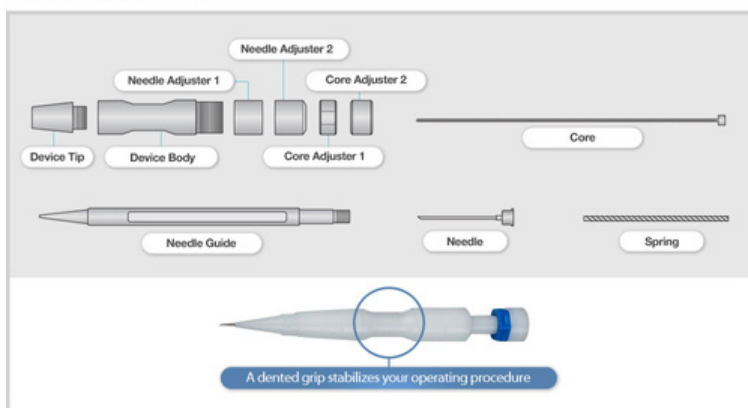

## ОКТ ДХИ КАЛЕМ НУМАРАЛАРИ

**ПЛАВА:** Погодно за појединачне и дупле калемове

Користи се у предњој линији косе, затезању, трансплантацији браде и обрва.

**ЦРВЕНА:** Погодно за 1 -2 -3 -4 -5 калемова

Користи се у интензивном узгоју.

**Напомена:** Већину времена, сет се састоји од 4 плаве + 6 црвених.

**ПОРЕКЛО:** КОРЕЈА





## МАВИ: 0,8 мм



### ИНЦУРАМ оловка за имплантацију

- То је медицинска оловка за трансплантацију косе
- Користи се за природну трансплантацију косе
- Пружа гушћу и чешћу прилику за садњу
- Садња је лакша
- Могућност давања правца приликом постављања сваког корена
- може се стерилисати
- То је производ за поновну употребу
- Само игле се мењају како постану тупе.
- Доступан у кутијама од 10 комада
- Има разних бројева
- трансплантација косе
- Сакал Екиими
- Трансплантација обрва

### Небрига о

**имплантатима** круга у области хватања врха игле.

Окретање улево: ПРОДУЖУЈЕ врх игле. Окретање удесно: СКРАЋА врх игле



## ЦРВЕНА: 0,9 мм



## БЕЛА: 1 мм





## ИНЦУРАМ оловка за имплантацију

- То је медицинска оловка за трансплантацију косе
- Користи се за природну трансплантацију косе
- Пружа гушћу и чешћу прилику за садњу
- Садња је лакша
- Могућност давања правца приликом постављања сваког корена
- може се стерилисати
- То је производ за поновну употребу
- Само игле се мењају како постану тупе.
- Доступан у кутијама од 10 комада
- Има разних бројева
- трансплантација косе
- Сакал Екиими
- Трансплантација обрва

## Резервна игла инцурам ПЛАВА: 0,8

ММ



## Резервна игла инцурам РЕД: 0,8 мм





Резервна игла инцурам: бела 1 мм

**ИНЦУРАМ**  
**Имплантер Пен**  
**Резервна игла**




Резервна игла инцурам ЦРНА: **1,1** мм



**1,1 мм 1,0 мм 0,9 мм 0,8 мм**

Садржај кутије: **10** комада за стерилизацију  
Пгодно за поновну употребу Инцурам врх игле од  
медицинског челика Порекло: Кореја.

НАПОМЕНА: Углавном се користе бела и плава

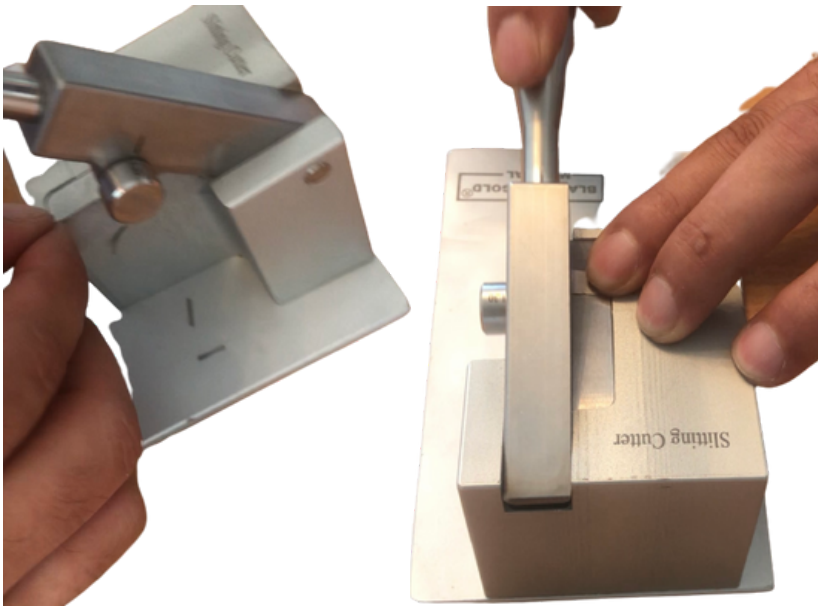

## ХИРУРШКЕ МАКАЗЕ

- МЕДИЦИНСКИ ЧЕЛИК
  - ГОЛД СЕРИЕС
  - ДИАМОНД ТИП
  - ТАЊА НА ЈЕДНОЈ СТРАНИ
  - ДРУГА СТРАНА ЈЕ СТАНДАРДНА
  - СЛИД ЦУТТИНГ
  - ДРЕССИНГ
  - ХИРУРШКИ
- Користи се на пољима

## СЛИД ЦУТТЕР МАЦХИНЕС

- ТЕЛО ОД МЕДИЦИНСКОГ НЕРђАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА
- ДВОСТРАНА ДИЈАМАНТСКА ГЛАВА
- СМООТХ ЦУТ
- ИСЕЦИ НА ЖЕЉЕНИ БРОЈ
- РЕЗАЊЕ ПОД ЖЕЉЕНИМ УГЛОМ
- МОЖЕТЕ ДИЗАЈНИРАТИ СВОЈ СЛАЈД И ИСЕЦИ ГА НА БИЛО КОЈУ ВЕЛИЧИНУ И ДУЖИНУ КОЈУ ЖЕЛИТЕ.
- МОЖЕ СЕЋЕ МИНИМАЛНО 5.000.000 ГЛАТКИХ КЛИЗНИХ СЕЧИЋА.





## ЈЕДИНИЦА ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ БЛУЕ ИЦЕ ГРАФТ

- УНУТРАШЊИ ОДЈЕЉАК ВОЛУМЕ 10 ПЕТРИЛА
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 4-12 СТЕПЕНИ
- ПОДЕШАВАЊЕ ОДНОСА ВЛАЖНОСТИ ТКИВА
- ПОДЕШАВАЊЕ ПХ ОДНОСА ТКИВА
- СПРЕЧАВАЊЕ ИНФЕКЦИЈЕ КАБИНЕТОМ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
- ШОКИРАЊЕ ГРАФТОМ И ВАКЦИНАЦИЈА + МЕЗОТЕРАПИЈА ДАВАЊЕ ГРАФТОВА СА МОТОРОМ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ

НАЈВАЖНИЈЕ, СВИ ОВИ ПРОЦЕДУРЕ;  
ПРУЖА МОГУЋНОСТ УПРАВЉАЊА И  
НАДЗОРА СА ДИГИТАЛНЕ ПЛОЧЕ

ТО ЈЕ КЛИНИЧКИ ТЕСТ ОДОБРЕН УРЕЂАЈ СА  
ИСО + ЦЕ+ ЕЦ+ ГСИ + ЕУ СЕРТИФИКАТ О  
УСКЛАЂЕНОСТИ

- ВЕЛИКИ УНУТРАШЊИ ВОЛУМЕ
- ДИГИТАЛНА КОНТРОЛА СВИХ ОПЕРАЦИЈА
- СИСТЕМ УПОЗОРАВАЊА У СЛУЧАЈУ НЕГАТИВНИХ ДОГАЂАЈА СА АУДИО АЛАРМОМ

**ГРАФТОВИ УЗИМАНИ ОВИМ УРЕЂАЈЕМ ОБЕЗБЕЂУЈУ ДА МОГУ ЗДРАВНО ПРЕЖИВЕТИ У СВОЈИМ ПРИРОДНИМ УСЛОВИМА, БАШ КАО ЖИВА ТКИВА. ПОДРЖАВА ПОВЕЋАЊЕ СТОПА ПРЕЖИВЉАВАЊА ШОКИРАЊЕМ ФОЛИКУЛА ИСТОШЕНИХ И ПРЕТВОРЕНИХ У УМОРЕНЕ КАЛЕМЕ ТОКОМ ПРОЦЕСА. МНОГО БРЖЕ ПОДРЖАВА ЗАЦЕЉЕЊЕ ГЕНЕРИСАНИХ ГРАФТОВА И ЊИХОВО ПРИЛОПЉЕЊЕ ЗА ТКИВО. ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАЈЗДРАВИЈЕ + НАЈПОУЗДАНИЈИ + НАЈПРИРОДНИЈИ ПРОЦЕДУРА ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ КОСЕ.**




## ДИМЕНЗИЈЕ

**60 Кс 60 Кс 30 ЦМ КОЛИ**  
**16 КГ УКУПНО АГИРЛИК**  
**110 / 220 В РАДНА УВЦ ДЕЗИНФЕКЦИЈА**

## САДРЖАЈ КУТИЈЕ

- Кориснички приручник
- гарантни лист
- Графтинг Енине
- главна јединица
- Кориснички приручник
- Водич за опис производа

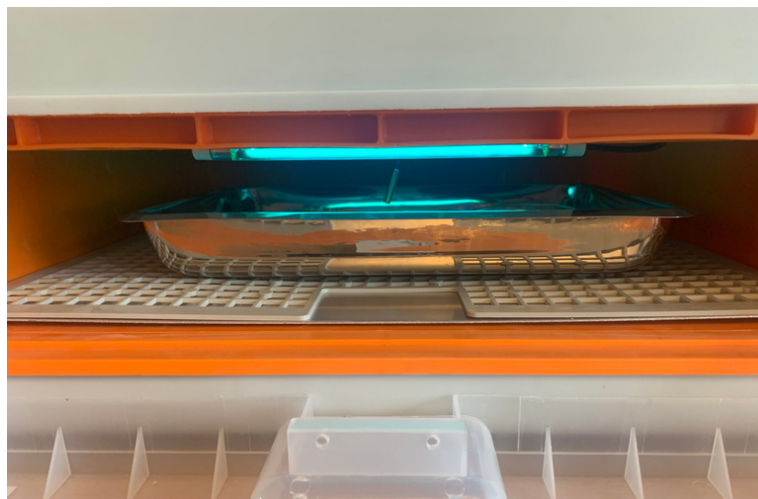



### ДЕРМОЈЕТ

Безболна ињекција  
и анестезија



Може да се стерилише Има комору за лекове од 5 кубика, нема потрошни материјал, медицински је производ, ставиш лек и користиш, нема игле, ради под притиском. Ствара сопствени притисак када повучете и отпустите крону.



### Уређај за безболну анестезију

ЕРГОНОМСКА УПОТРЕБА,  
БЕЗ СТРАХА ОД ИГАЛА, БЕЗ  
БОЛА, УШТЕДА ВРЕМЕНА  
БРЗОМ КОРИШЋЕЊЕМ, БЕЗ  
КРВАРЕЊА, НУДИ УДОБАН  
ПРОЦЕДУР





Вибрациона оловка за анестезију  
**6000 у минути**  
ВИБРАТИОН ВАВЕ

- Обезбеђује 6000 вибрација у минути
- Ради на батерију
- Активира се додиривањем подручја близу подручја непосредно прије ињекције. Како људски мозак брже и раније опажа вибрације, то ће осигурати да пацијент не осети улазак игле.
- На неки начин, преварићемо свој мозак.

## Вибрациони уређај за анестезију

- АНЕСТЕЗИЈА АПЛИКАЦИЈЕ
- ИЊЕКЦИЈНЕ ПРИМЕНЕ
- ПРИЈАВЕ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ
- АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПУЊЕЊЕ
- АПЛИКАЦИЈЕ БОТОКС-а

Главна подручја употребе



Златна  
вибрацијска  
оловка за  
анестезију



**ПРОФЕСИОНАЛ**  
**Нофра:**  
**Мцрскп.01**



2.0X Auxilliary Objective Lens



0.5X Auxilliary Objective Lens



High Temperature Resistant Working Pad



## ПРИПРЕМА ГРАФТА + МИКРОСКОП ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ФОЛИКУЛА

Опис производа :

1. Екран: Опремљен ЛЦД екраном од 7 инча, ЦМОС сензором од 26 МП, дигиталним увећањем од 2100 пута, пружајући слике добре равности и јасноће контраста.
2. Микроскоп: Микроскоп има сочиво са нагнутом главом од 45 степени и цев окулара који се окреће за 360 степени, подржава зум од 6,5:1, обезбеђујући прецизно поравнање и смањује визуелни замор.
3. Фина израда: Све компоненте оптичког стакла усвајају прецизна стаклена сочива, материјал од легуре алуминијума високе тврдоће, подесиви размак зеница, подржавају мултимедијални интерфејс високе дефиниције и УСБ видео излаз.
4. Прстенасто светло: Опремљен компактним микроскопским прстенастим светлом, обезбеђује интензивно и концентрисано осветљење без сенки са подесивим смером и интензитетом осветљења, може се користити дуго времена.
5. Широка примена: процедуре медицинске анализе + трансплантација косе Поступци одвајања графта + екстракција фоликула графта и процедуре прегледа



**Карактеристике:**

Тип артикла: Тринокуларни стерео микроскоп Материјал: легура алуминијума, АБС тринокуларни микроскоп Карактеристике:

Глава: 360° ротирајући тринокуларни конфокални микроскоп са 45° нагибом Окулар: 30 мм/1,18 ин ултра широко видно поље ВФ10Кс/20 са сочивом са великим увећањем + објектив: 0,7-4,5 Пута Опсег зумирања: 6,5:1 По: Тринокуларна веза Прибл. 23 мм/0,91 инча оптички порт Удаљеност зенице: прибл. 2 1/8 инча до 3 инча (54-76 мм) + Видно поље: прибл. 1 1/4 ин (33 мм) Радна удаљеност: 7Кс-45Кс (100мм/3.94ин), 7Кс-90Кс (40мм/1.57ин) 2.0к објектив објектива Постављање главе: прибл. Пречник 3 ин (76 мм) + Монтажа: прибл. Пречник 1 7/8 инча (48 мм унутрашњи навој).

Карактеристике камере за микроскоп од 7 инча: Сензор слике: ЦМОС сензор високе резолуције од 26 МП

**Садржај кутије :**

**МИКРОСКОП + ЛЕД ГЛАВА РАСВЕТЕ + ЛЦД ДИГИТАЛНИ ЕКРАН + РАДНИ ПОДЛОГА СИЛИКОН ПРОТИВ Огреботина + КАБЛОВИ ЗА МЕЋУСОБНИ ПОВЕЗИВАЊЕ + ПРИКЉУЧАК ЗА МИКРОСКОП КАМЕРУ + МЕЋУСОБНИ КАБЛОВИ + АДАПТЕРИ**

**Димензије: 25 к 30 к 30 цм Величина кутије**





### Графт + микроскоп за анализу фоликула

Шифра:  
МЦРСКП.02

1 ЗА ОПЕРАЦИЈУ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ КОСЕ;

- ГРАФТ СЕПАРАТИОН
  - СЛИКЕ ФОЛИКУЛА
  - РООТ ЦИВИЛИЗАТИОН
  - КОСА ПРАТИ АНАЛИЗУ
- Дигитални микроскоп са ЛЕД светлом радним столом и екраном биће ваш највећи помоћник у операцијама као што су

3Д ХД дигитални микроскоп



ПРУЖА ПРИКАЗ 3Д ЕФЕКТА Подесиви додаци: носач, ЛЦД екран и двоструко ЛЕД осветљење се могу слободно подесити

Обрада слике и ИР даљински управљач Висококвалитетно сочиво и осетљив ЦМОС сензор + Слика се брзо приказује са екрана и има добру дубину. + УВ филтер на сочиву такође помаже у смањењу рефлексије.

Уграђено 8 подесивих ЛЕД светала: Осим 2 ЛЕД светла са обе стране постоља, уграђена светла у сочиву чине светла довољнијим. Можете слободно подесити отвор бленде свих ЛЕД светала.

Снимање и снимање: Можете да снимате слике и видео записе помоћу даљинског управљача или дугмета на екрану (Видео снимци и слике се могу сачувати на микро СД картици која подржава максимално 32Г) Детаљи:

Сензор слике: 2 Мега Пикел ХД сензор Видео излаз: ФХД1920к1080 30фпс; ХД1280к720 30ФПС Видео формат: MOV Увећање: До 100 пута Резолуција фотографије: 1920Кс1080 Формат фотографије: ЈПГ Опсег фокуса: 6ЦМ-18ЦМ Брзина кадрова: Макс. 30ф/с Складиштење: Микроскоп-СД картица, до 32Г Напајање: 5В ДЦ Извор светлости: 8 уграђених ЛЕД-а и 2 ЛЕД-а на постољу Величина екрана: 7 инча Величина постоља: 20цм \* 12цм \* 19цм Сертификација: ЦЕ / ФЦЦ / РоХС Пакет укључује: микроскоп × 1 метално постоље × 1 + упутства × 1 ИР даљински управљач × 1 + кабл за прекидач × 1 адаптер за напајање × 1 + УВ филтер × 1 поклопац сочива × 1 подаци о паковању 32 \* 22 \* 10 цм / 1,55 кг



## Професионални сет за анализ Шифра: АК.01

ТЕЛЕФОН + ТАБЛЕТ +  
МОНИТОР, РАЧУНАР И  
ТЕЛЕВИЗИЈА повезани  
бежичним интернетом  
Повезивање је направљено


Можете аутоматски да  
сачувате своје картоне  
пацијената.  
Можете да снимате  
фотографије и видео записе  
једним кликом на таблету  
или камери. Има  
подешавања СВЕТЛО +  
ЗООМ + ФОКУС.

Долази са софтвером за  
инсталацију



## Опис професионалног модела за анализу косе и коже

- ТАБЛЕТ од 10,1 инча + бежична тастатура + специјални заштитни поклопац + спољна меморија
- Функција снимања фотографија Тренутни преглед једним кликом
- Пре - функција после снимања
- Бежични екран од 1600 пиксела подесив и зумирајући
- Паметна бежична Ви-Фи камера
- Стојећи статив подесиви држач таблета (подесив по висини и 360 степени)
- Са Генпа Туркије гаранцијом + Блацкандголд Медицал Ассуранце

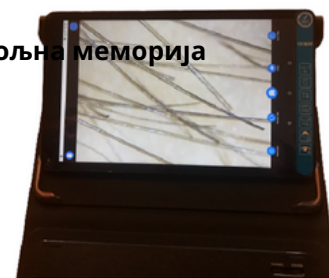

Вашим пацијентима нуди могућност да много лакше изврше анализу косе и коже уз директну употребу таблета.

Пружа могућност снимања фотографија и видео записа током анализе.

Показује јасне резултате у погледу правца, густине, броја графтова и својстава фоликула длаке.

Ако особа има медицинску болест у вези са скалпом, он/она ће водити специјалисте.


Помаже да се визуелно измери ниво масти на кожи. Јасно визуализује структуру коже и пружа детаљну слику.

Димензије кутије: 20 к 20 к 10 цм 650 гр Тежина



### УСБ камера за анализа: АК.02



УСБ повезан  
1600 к камера за анализу  
косе и коже

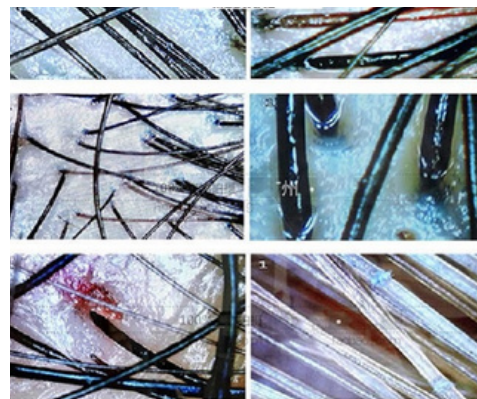

### УСБ телефон + таблет + компјутерска веза

Анализатор косе и коже 1000 Кс - 1600 Кс УСБ УРЕЂАЈ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ДИГИТАЛНИ ТЕЛЕФОН ЈЕ ДОСТУПАН У СЕТУ.

- Хаир анд Скин Анализер 1000 Кс УСБ Дигитал
- Пренос слике повезан преко УСБ-а
- Лако подешавање

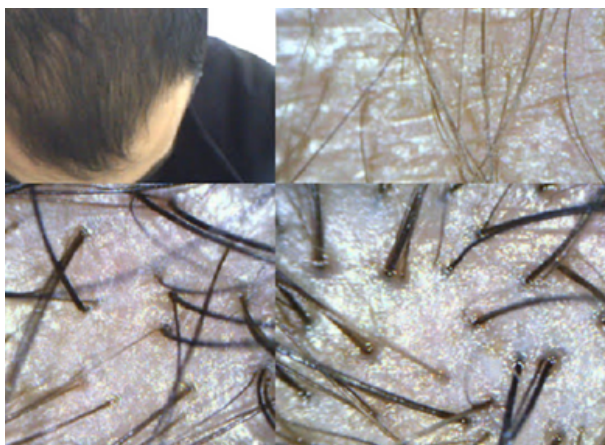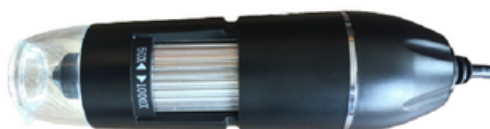

### Камера за анализу косе и коже ОБЈАШЊЕЊЕ ;

- Кориснички приручник
- адаптер за пуњење
- 1600Кс Цамера
- Адаптер за повезивање телефона+таблета

Димензије: кутија 15 к 10 к 7 цм  
340г Тежина



**ДЕРМОТОСКОП са ЛЕД СВЕТЛОМ**  
Шифра: ДРМ-01

**СЦАЛАЛИ МАНИФИЦЕНТ**

Шифра: ДРМ-02  
Сцала лупа са осветљењем дерматолошког типа која се користи у анализи коже  
Опис: 15 к 5 к 5 цм 250 гр



**Ел Типи ДЕРМОТОСКОП**  
Шифра: ДРМ - 03

Однос увећања 40Кс - Прецизност мерења: Прецизност скале од 0,05 мм Осветљење: Бела ЛЕД Боја светла: Бела  
Употреба:  
Користи се за обављање регионалних дубинских анализа у дерматологији и пластичној хирургији. Користи се за дубинску анализу дубоких формација у кожи, масном слоју и кожи.  
Скала Укупни пречник: Укупан пречник 4 мм Димензије: 140 к 45 к 23 мм 350 гр Обим паковања 1 лупа, 1 кожна торбица за ношење, напајање + 2 АА батерије (нису укључене у кутију).



## ЛАСЕРСКА ОБРАДА НАОЧАРИ

Шифра: ЛГЗЛК-01

Опис производа ;  
Реч је о комплету наочара који се користе у ласерским уређајима који се користе у центрима за трансплантацију косе и областима Естетика - медицинска естетика.  
Центри за трансплантацију косе  
Одељења медицинске естетике  
Ласерски салон Заштитне наочаре за депилацију 200-1200нм  
200нм - 1200нм

## СЕТ НАОЧАРА ЗА ЛАСЕРСКА ОБРАДА

Шифра: ЛГЗЛК-02

Сет наочара за ласерску обраду

Опис производа ;  
Реч је о комплету наочара који се користе у ласерским уређајима који се користе у центрима за трансплантацију косе и областима Естетика - медицинска естетика.  
У комплету су 2 наочаре, једна за пацијента, а друга за корисника.  
Центри за трансплантацију косе Одељења медицинске естетике Ласерска салонска епилација  
Заштитне наочаре 200-1200нм-200нм - 1200нм



IPL LAZER  
DANIŞAN KORUYUCU GÖZLÜK  
SIYAH



## ЛАСЕРСКА ПРОЦЕДУРА НАОЧАРЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

Шифра: ЛГЗЛК-03

Ласерска обрада Наочаре за пацијенте погодне за козметичке и ласерске процедуре Заштитне козметичке наочаре за пацијенте Таласна дужина: 190Нм-2000Нм све таласне дужине; Од 5+ Пластични материјали који се широко користе у ласерском и космичком пољу Апсорбују статистику, више од 9% Ув99.



## ЛООП ГЛАСЕС

ЛУП-01

Лупа са осветљењем

- Флексибилна сложена сочива са великим увећањем
- Подесиво светло горе и доле
- Подесива глава завртња горе и доле
- Двоструки објектив 3к зум
- Лако подесив и проширив каиш са капуљачом
- Објектив: 1,8к, 2,3к, 3,7к, 4,8к



## ЛООП ГЛАСЕС

ЛУП-02

Наочаре за увећање са осветљењем, серија 9

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Набавка: 1к, 1.7к, 2Кс, 2.5к, 4.5к
- Материјал: трбушњаци, акрил, лупа за ношење
- Два комада супер лед лампе + батерија: 2 ААА

УСЕ ;

- осветљена увеличавајућа лупа типа главе 5
- 2 сочива се могу користити истовремено
- У исто време, увећање може да достигне снагу од 8Кс.
- АБС материјал и прозирна акрилна сочива.
- Трака за главу је лако подесива.



## ЛООП ГЛАСЕС

ЛУП-03

3к зум Ергономско подешавање траке за главу Подешавање угла сочива





## ЛООП ГЛАСЕС

ЛУП-04

Тип шешира Лупа са ЛЕД осветљењем Наочаре за лупу са 9к зумом 5 сочива Лупа са главу са осветљењем 2 ЛЕД лупа са 5 сочива (9к пута зум).

Захваљујући својим функцији увећања слој по слој, омогућиће вам да видите објекте изван њиховим детаљима.

Захваљујући 5 различитих сочива, можете користити сочива према вашим потребама.

Објективи имају могућност зума од 1,0к - 1,5к - 2к, 2,5к и 3,5к.

Пружа додатни зум јер има могућност додавања више сочива на шешир.

Флексибилно комбиновано сочиво, велики степен увећања, подесиво светло горе и доле, подесиво стакло на две различите тачке, горе и доле.

Сектори и поља употребе:

- Клинике за трансплантацију косе - специјалисти за трансплантацију косе
- Беаути Центарс

Техничке спецификације:

- ЛЕД лампа + радијатор 3 даљинске батерије + подесива глава
- 5 сочива са различитим функцијама зума

Пакет је укључен:

- 1 шешир + 5 сочива у кутији + 3 даљинске батерије

Димензије сочива: Димензије сочива сваки 10,8 цм ширина 4 цм висина

- Димензије шешира: Ширина: 17,6 цм Дубина: Променљива Висина: Променљива

Нуди ергономску употребу + Лаган је и користан модел. Посебан је за процедуре трансплантације косе и сличне естетске медицинске интервенције.

## ЛООП ГЛАСЕС

ЛУП-05

Наочаре за увећање са осветљењем, серија 5

3 резервна професионална увећавајућа сочива ЛЕД пуњиви модел професионално осветљење

Нуди ергономску употребу Лаган и користан модел Специјално за трансплантацију косе и сличне естетске медицинске интервенције.



## ЛООП ГЛАСЕС

ЛУП-06

Тип главе са 4 резервна сочива за увећање + подесива трака за главу Покретни зглоб Подесива петља наочаре.





## ЛООП ГЛАСЕС

ЛУП-07

Много боље осветљење са двоструком ЛЕД функцијом \* 5 резервних сочива са различитим функцијама увећања.  
 \* 1,0Кс - 1,5Кс - 2,0Кс - 2,5Кс - 3,5Кс величине сочива \* Елегантан ергономски дизајн који не изазива нелагоду у глави.  
 \* Специјална производња од првокласног антиалергијског титанијум карбонског материјала.  
 Оловку напајају 3 батерије.

Димензије кутије: 24 к 20 к 7 цм 380 гр

## ЛООП ГЛАСЕС


### ЛУП-08

Много боље осветљење са ЛЕД функцијом \* 5 резервних сочива са различитим функцијама увећања.  
 \* 1,0Кс - 1,5Кс - 2,0Кс - 2,5Кс - 3,5Кс величине сочива \* Елегантан ергономски дизајн који не изазива нелагоду у глави.  
 \* Специјална производња од првокласног антиалергијског титанијум карбонског материјала.  
 То је најлакши модел



## GOZLUK TIP LED IŞIKLI BÜYÜTEÇ

### 8X / 15X VE 23 X




## ЛООП ГЛАСЕС

### ЛУП-09

Тип главе са 4 резервна сочива за увећање + подесива трака за главу Покретни зглоб Подесиво светло

- 10к увећање
- 15к увећање
- 20к увећање
- 25к увећање



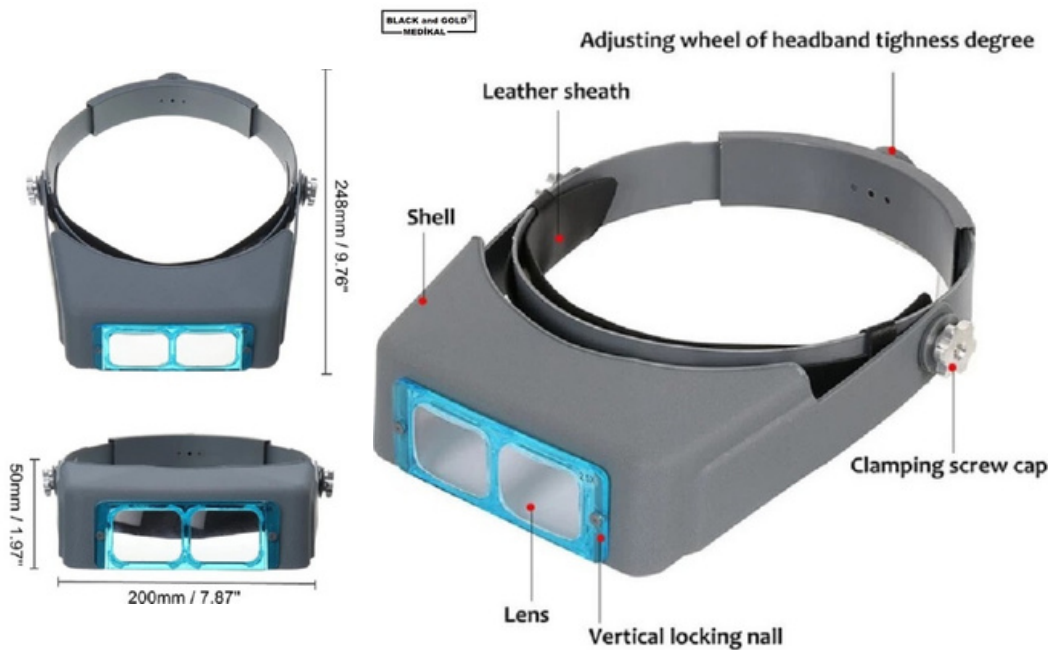

## ОПТИВИСОР

### ОПТВЗР -01

Оптивисор Блуе  
Професионал  
лупа са 5  
резервних  
сочива



## Фокусибилна ЛЕД лампа на батерије

ПУЊИВА ЛАМПА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ КОСЕ ЛЕД, ФОКУСАБИЛНА

- Има ергономски и модеран дизајн
- Лаган је и не оптерећује главу
- ЛЕД је подесив и помичан
- Има литијумску батерију и може се користити пуњењем.
- Обезбеђује у просеку 4-5 сати коришћења са једним пуњењем
- Решава проблем нестанка струје
- ЛЕД светло нуди одличну професионалну видљивост



## ЗАШТИТНЕ НАОЧАРИ

Заштитне наочаре могу се дезинфиковати. Погодан је за поновну употребу. Има бочну заштиту. Може се извршити подешавање ушију.




### ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЛООП

#### ПРФ.ЛП.01 НАОЧАРЕ

Професионалне наочаре  
Доступне плаве и црвене  
опције Подесива величина уха  
Подесиве хируршке наочаре  
Процедуре трансплантације  
косе, стоматолошка хирургија

СВЕТЛО: ЛЕД ЦХАЛИМА АЛАНИ:  
20-60 ЦМ  
3,5 - 400Кс МАГНИФИЦАТИОН



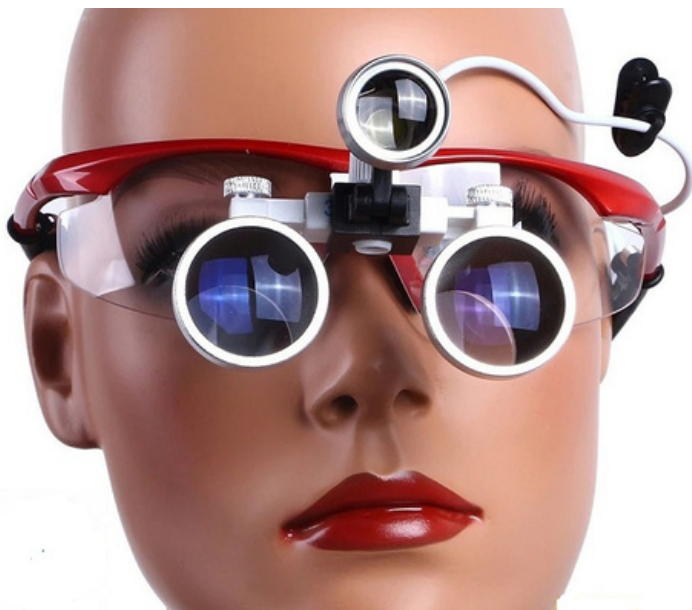

**ПРОФЕСИОНА  
ЛНЕ ЛООП**

**ПРФ.ЛП.02 НАОЧАРЕ**

Професионалне наочаре  
Професионалне ЛЕД светло  
плаве и црвене опције  
доступне на батерије Подесива  
величина уха Подесиве  
хируршке наочаре Процедуре  
трансплантације косе,  
стоматолошка хирургија

СВЕТЛО: ЛЕД ЦХАЛИМА АЛАНИ:  
20-60 ЦМ  
3,5 - 400Кс МАГНИФИЦИТИОН





### ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЛООП НАОЧАРЕ

**ПРФ.ЛП.03**

Лигхт Типе; ЛЕД  
Интензитет светлости; 60,000Лк  
Баттери; 2 стопе увећања петље;  
2к-3к-4к Температура боје; 5.500К  
Ламп Лифе; 50.000х радног  
времена; 4х Веигхт; 280гр

### ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЛООП НАОЧАРЕ

**ПРФ.ЛП.04**

Лигхт Типе; ЛЕД  
Интензитет светлости; 60,000Лк  
Баттери; 1 Лооп Магнифицион  
Ратио; 2к-3к-4к Температура  
боје; 5.500К Ламп Лифе; 50.000х  
радног времена; 4х Веигхт; 290гр



### ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЛООП НАОЧАРЕ

**ПРФ.ЛП.05**

Лигхт Типе; ЛЕД  
Интензитет светлости; 60,000Лк  
Баттери; 1 Лооп Магнифицион  
Ратио; 2к-3к-4к Температура  
боје; 5.500К Ламп Лифе; 50.000х  
радног времена; 4х Веигхт; 290гр  
Трака за главу Халф моон  
подесива





## ДЕРМО КОД ХДП.01 ЛАЗЕР




- Ласерски уређај за косу 650 Нм Ножни Дермо ласерски уређај за косу Поријекло: Италија ГС1+ИСО+ЦЕ+ЕЦ+ЕУ усклађеност + клинички одобрен
- Ласер за косу стимулише циркулацију крви.
  - Ласер за косу Цапиллари подржава регионалну ефикасност повећањем капиларне циркулације
  - Ласер за косу стимулише и ревитализује фоликуле длаке
  - Ласер за косу стимулише и активира факторе раста
  - Ласер за косу повећава површинску оксигенацију повећавајући регионално задржавање кисеоника.
  - Ласер за косу подржава прелазе од ћелије до ћелије отварањем пора (дилатацијом) и подржава задржавање кисеоника.

## Ласерска јединица за косу

Користи се под надзором лекара. Третмани  
које су так косе. Након трансплантације косе;

- Убрзава зарастање
- Повећава стопу преживљавања трансплантата
- Убрзава настанак нових фоликула длаке
- Превазилази фазу осипања шока без осипања.
- Симптоми мушког опадања косе се примењују код жена
- Шокови заустављају губитак косе изазван стресом

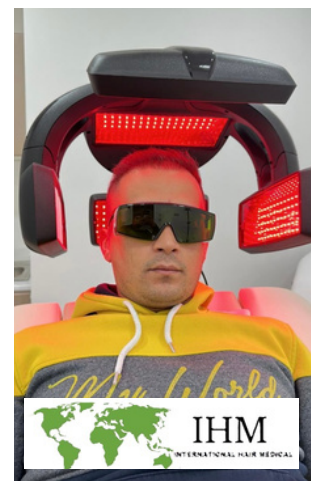

## Хаир Дермо Леисуре

Под контролом и препоруком лекара;  
Обично 2 сене недељно  
Препоручује се 6-8 недеља лечења.  
Наплаћује се по сесији.  
Свака сесија траје 15 минута.  
Трајање сенаса се може изабрати на уређају.  
5 Главно тело се састоји од главе.  
Потпуно покрива главу.  
Постоји 250 Медицал 710 Нмлазер  
ЛЕД диода





### ХАИР ЛИНЕ ДЕСИГНЕР ЛАЗЕР

КОД: ХЦЛ.01

#### ЛАСЕР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ЦРТАЊЕ

- Тело од 100% медицинског челика
- Литијумска батерија (приближно 3 месеца употребе са једним пуњењем)
- Универзални прикључак за пуњење (могуће пуњење чак и са мобилним телефоном)
- Медицински ласер је причвршћен

#### Употреба:

Користи се за козметичку презентацију и за одређивање анатомске средње линије подручја чела.

Може се пунити на било ком пуњачу уз приложени УСБ кабл за пуњење.


Пружа лагану и ергономску употребу.

Трака за подешавање у области обележавања чела може се проширити или скупити.

Треба избегавати продужени директан контакт са очима.



Треба га очистити чистом влажном крпом.

Нема штете ако га обришете дезинфекционим средством.

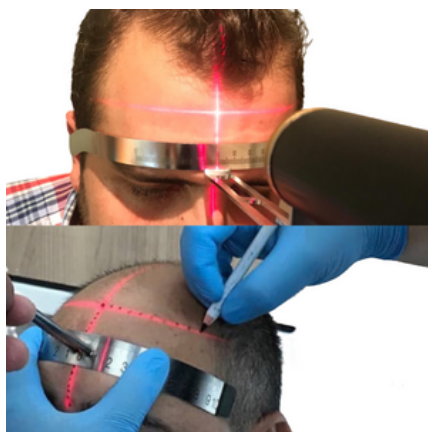



## НЕЦРОСИЗ КОМПЛЕТ ЗА ПРВУ ПОМОЋ

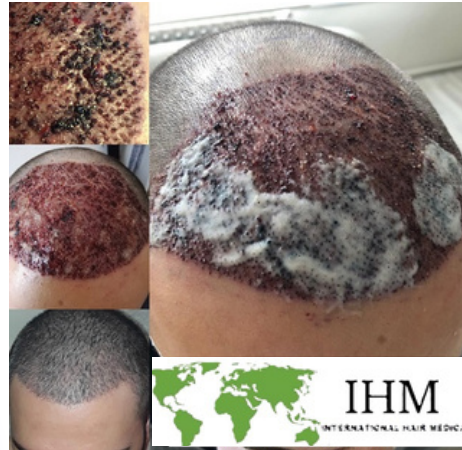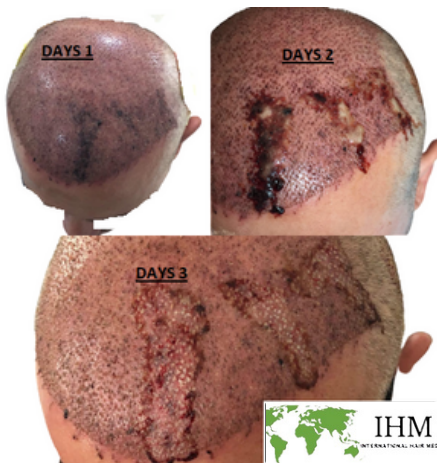

## КОМПЛЕТ ЗА ПРВУ ПОМОЋ

Лосион за некрозу - Лосион за некрозу Лосион за некрозу хц хаир цхарм клиничка поправка Лосион за црни и златни лосион за некрозу У тубама је од 125 мл.

Употреба: Примењује се на сумњиво, инфицирано или некротично ткиво. (Претходно се мора очистити и осушити) Уноси се палпацијом врхом прста, без притискања. Тако је остављено. Пошто се раствара у води, нормално прање се обавља следећег дана (након 24 сата).

Видљиво побољшање ће бити приметно након прања. У тешким случајевима, као што су дубока некроза, инфицирана некроза или касно откривена некроза, препоручује се да се настави на исти начин до 1 недеље. У сумњивим или новоформираним случајевима који се одмах уоче, даје 99,9% резултата у првој сесији. И нема губитка трансплантата.

- Делује воском на ткиво и са ћелијама повлачи циркулацију нагоре.
- Пружа ефекат јачања циркулације
- Обезбеђује високо задржавање кисеоника
- Одржава је стално влажном
- Штити интегритет ћелија и помаже у поправљању оштећеног ткива
- Садржи садржај који има за циљ спречавање инфекције и решавање постојеће инфекције.
- Неалерген је са својом посебном формулом и једини је производ у својој области.
- Упозорења: 4-6 сати након наношења ће доћи до малих цурења крви у том подручју. (То је зато што јача циркулацију и ревитализује некротично подручје)
- У области примене ће се појавити изглед сличан жућкастом пражњењу. (Усисивачи уклањају некрозу и прљаво, инфицирано, мртво ткиво изазивајући повраћање)
- Нема губитка графта у новооткривеним случајевима, али се неки губитак графта (у зависности од области) може видети у касној фази некрозе или некрозе до периоста.
- Ниједан други третман не треба примењивати док користите ове сесије примене.



## Стандард Мерцес

- Са ЛЕД светлом - 30000 ЛУКС
- 3-степенно подешавање светла
- Екран осетљив на додир
- Подешавање висине и правца
- лед операција - интервентна лампа
- Дермокозметичке процедуре
- Процедуре за негу коже
- Медицинске процедуре
- Хирургија
- Мултифункционална преносива лампа за интервенцију на

точковима пожељна у областима за трансплантацију косе

## ИНТЕРВЕНЦИОНА ЛАМПА СА ПЕТЉОМ СА НОЖОМ

### МУД.Л.02

- ЛООП МАГНИФИЦЕНТ
- 90 ЛЕД БЕЛО СВЕТЛО
- 35000 ЛУКС ЛИГХТ
- РАДНА ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ 20-60 ЦМ
- СТАНДАРД СА ТОЧКОВИМА
- СТОПАЛО И ТЕЛО МОГУ ДА СЕ ОДВОЈИТЕ
- МОЖЕ СЕ НАПРАВИТИ 360 СТЕПЕНИ



## ЛИВАЧКА СТОПА ПРФ СА 108 ЛЕД МУД.Л.03

- Лампа за трансплантацију косе Лооп 108 ЛЕД диода
- Модел против превртања са ногама од ливеног гвожђа
- То је интервентна лампа са највећом главом.
- Назив производа: Лампа за трансплантацију косе са базом од ливеног гвожђа са петљом 108 ЛЕД
- Шифра производа: МДЛД-02
- Димензије: 35 -40 -96 + Нога од ливеног гвожђа 60 цм + КОЧНИ ТОЧАК
- Карактеристике: Ноге од ливеног гвожђа против нагињања + Покретни





## Спирал Спот Серис

МУД.Л.04

- Разнобојна интервентна лампа са спиралним ногама без врха
- ЛЕД светло од 24 вати - 5.000 сати ЛЕД век - Могућност кретања у било ком правцу захваљујући флексибилној спирали - Мобилни точкови - Електростатичка боја
- Наш производ; Хирургија за трансплантацију косе је погодна за болнице, клинике, центре лепоте и све радне области које захтевају фокусирано светло.
- 40000 Лук.
- Црно - Плаво - Бело - Жуто - Сиво

## ПРОФЕСИОНАЛНИ АБС ФООТ СПОТ РЕФЛЕКТОР

МУД.Л.05

- Лампа за инспекцију рефлектора са пластичним стопалима од абс 50000 ЛУКС
- 1. Мрежни прикључак: 100-240 В АЦ, 50-60 ХЗ 0,65 А
- 2. Потрошња енергије: 10В
- 3. Осигурач: Ф2АЛ250В
- 4. Излаз: 15В=0.65А
- 5. Радна температура: до +5 / +40 Ц
- 6. Живот сијалице: 10000 сати
- Величине производа:
- Димензије: 60 к 60 к 200 цм
- Тежина: 5 кг



## ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕД ИНТЕРВЕНЦИОНА МУД.Л.06 ЛАМПА

- СА ЛЕД СВЕТЛОМ (ЖУТА И БЕЛА ЛЕД МЕШАНА)
- СПРЕЧАВА ОБИЉАВАЊЕ И БЛАС
- ДИГИТАЛНО ПОДЕШАВЉЕНО НА ДОДИР, СА ЕКРАНОМ
- ДЕО ГЛАВЕ ЈЕ ПОКРЕТАН 360 СТЕПЕНИ
- ВРАТНИ ДЕО ЈЕ ПОКРЕТАН ЗГЛОБ И МОЖЕ СЕ ПОДЕСИТИ.
- ДОСТУПНА ЈЕ ДОСТУПНА СТРУКТУРА СТОПАЛА МОДЕЛ ОПЕРАЦИЈЕ НА ТОЧКОВИМА
- **ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ**
- густина 55.000 лукса
- Пречник тачке 100-150 мм, пречник дубине 10 -25 цм, температура боје 3800 - 4800 К
- Индекс приказивања боја 91 Ра ЛЕД Просечан животни век >50000 сати
- Број ЛЕД диода 12 Пречник светла 150 мм Контрола интензитета 10~100 Дигитал Тоуцх
- Напајање 220В/50Хз АЦ Потрошња енергије 12В






## Лампа за професионалну интервенцију у Швајцарској

МУД.Л.07

Muayene Aydınlatma'da Yeni Nesil LED Teknolojisi

YENİ ÜRÜN

Derungs

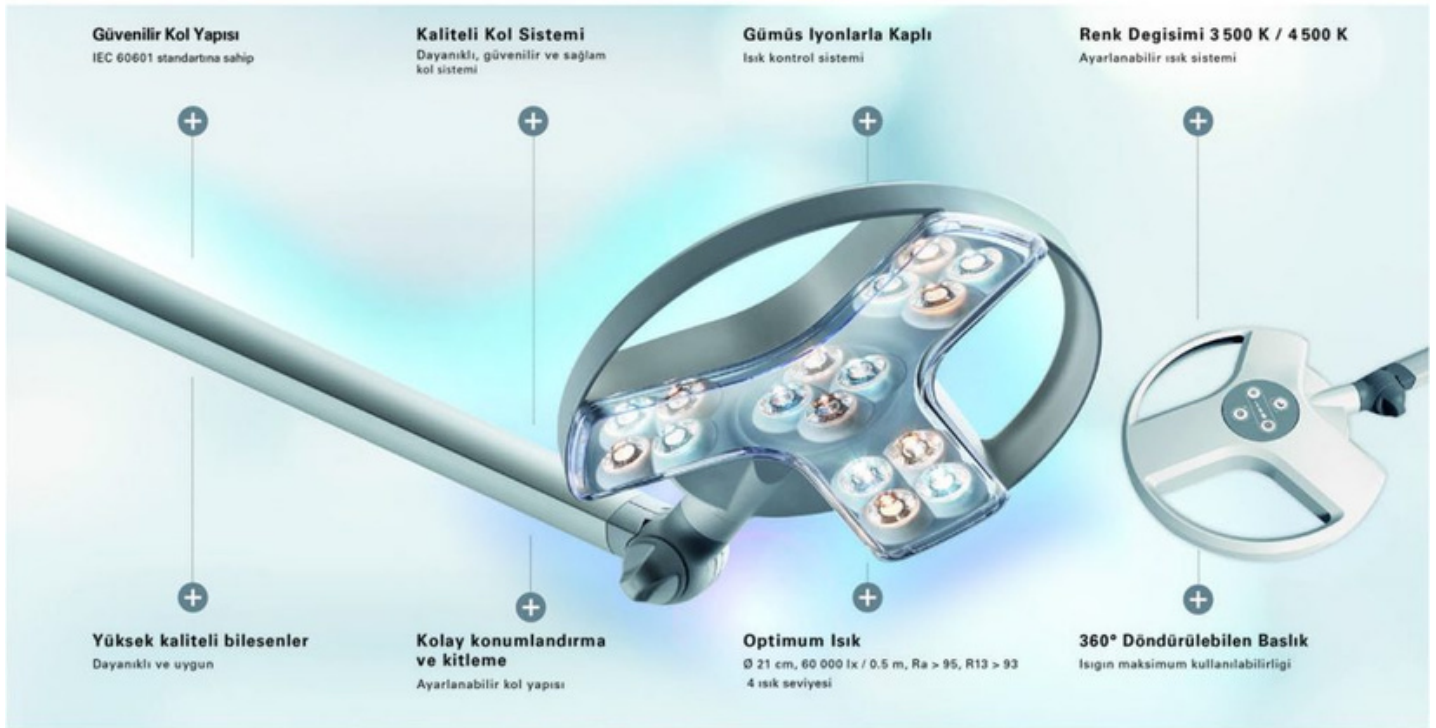

**Kullanım Opsiyonları**  
tavana monte, tekerlekli ayak  
raya monte, duvara monte  
masaya monte



- muayene odası
- sac ekim odası
- acil servis

- yoğun bakım ünitesi
- neonatoloji
- jinekoloji

- pratisyen
- dermatolog
- kulak burun boğaz



- ЛЕД технологија
- Велика снага осветљења 60'000 лк / 0,5 м
- Живот ЛЕД диода је загарантован на 60.000 сати на оптималном нивоу.
- Осветљена површина 210 мм
- Прецизан приказ боја Ra > 95, R9 > 90
- Температуре боје (3500K и 4500K) омогућавају индивидуални приказ контраста. Јачина осветљења је у 4 степена
- Највећи квалитет светлости захваљујући дијамантској оптици
- Антимикробна хигијенска функција на важним компонентама лампе
- Једноставна јединица на глави
- Максимални радни радијус (глава се може ротирати за 360°)
- Одлична ергономија са системом алуминијумских руку балансираним опругама
- Минимални трошкови одржавања захваљујући ЛЕД технологији
- У складу са стандардима ЕН 60601-1 и ЕН 60601-2-41
- Производ је прекривен јонима сребра. У року од 8 сати.
- Сама себе стерилише.
- Може се монтирати на зид, на шину и





## Лампа за професионалну интервенцију

МУД.Л.08

### Немачка

- **Техничке спецификације хируршких лампи**
- **Интензитет централног осветљења (ЕЦ):** Да би се обезбедио добар вид и спречило визуелно напрезање хирурга, идеалан интензитет светлости треба да буде између 40.000 и 160.000 лукса, у средини светлосног снопа, један метар удаљен од извора светлости.
- **Температура боје (К):** Пошто хируршка светла генерално осветљавају тамноцрвена ткива, видљиво црвено светло мора бити обезбеђено да би се нагласио контраст и диференцијација ткива. Температура боје од 4000К обезбеђује довољну осветљеност и омогућава хирургу да разликује праве боје ткива уз минималан замор очију. Прихватаљиви опсег за хируршка светла треба да буде између 3000 - 6700К.
- **Дубина осветљења (Л1+Л2):** Растојање између тачака интензитета осветљења од 20% изнад и испод централне тачке. Од тачке максималног осветљења, која је центар светлосног поља удаљеног 1 метар од површине која емитује светлост, фотометар се помера ка светлости све док измерени интензитет светлости не падне на 20% максималне вредности. Растојање између центра и ове тачке је дефинисано као Л1. Слично измерено растојање од светлости је Л2. Дубина осветљења без потребе за поновним фокусирањем је збир два растојања Л1 и Л2. У другом издању ИЕЦ стандарда објављеном 2009. године, вредност прага је ревидирана са 20% на 60%. У пракси, то је израз који се користи за оптимално снимање малих објеката ниског контраста на различитим дубинама у телесним шупљинама. Хируршке главе лампе са великом дубином поља пружају радну површину изнад стандарда без скраћивања радног подручја.
- **ЦРИ Ра вредност:** Хируршка лампа са високом вредношћу ЦРИ значи да боје изгледају природније. Опсег вредности варира између 0 и 100. Дневно светло се сматра 100. ЦРИ вредности од 85 и веће од 85 указују на добар приказ боја. Укратко, што је вредност ближа 100, добија се природније и квалитетније светло.
- **ЦРИ Р9 вредност:**
- **Спектри рефлексије су вредност посебно релевантна за објекте који садрже црвене таласне дужине.** ЛЕД осветљење не може у потпуности да постигне црвену боју. Приликом хируршких интервенција треба користити осветљење високе вредности Р9 које може у потпуности да покаже црвену боју.
- **Тип материјала:** Тип материјала који ће се користити у главама хируршких лампи мора бити одабран као чврст материјал који је отпоран на температуру, ударце и огреботине.
- **Пречник области осветљења (Д10):** Завршава се тамо где радна лампа достигне 10% интензитета светлости. Широко се односи на пречник тачке.
- **Мерење дистрибуције светлости (Д50):** Завршава се тамо где радна лампа достигне 50% свог интензитета светлости. Уско се односи на пречник тачке.
- **Ламинарни проток ваздуха:** Ламинарни проток ваздуха је обезбеђен у операционим салама и хируршким операцијама како би се спречило да се бактерије, вируси и клице настањују на отвореном хируршком простору и изазову инфекцију. Турбуленција ваздуха није пожељна ситуација јер може изазвати несмерно дување честица, што може довести до инфекције хируршког подручја, које мора остати стерилно. Да би се минимизирала контаминација у лампама у операционој сали, требало би да се користе хируршке главе које обезбеђују турбуленцију ваздуха.
- **Хигијена:** Ојачана изолациона структура и тело обложено антибактеријском бојом ЛЕД лампи за операционе сале не би



Mobil  
Mobile



## МЕЗОТЕРАПИЈСК И ПИШТОЉ ДИГИТАЛ

КОД: МЗТРП.01-ЕЗ

- ДИГИТАЛНА ПОДЕШИВА ГЛАВА
- ВРХ ЗА ВИШЕ ИГЛА ЗА ЈЕДНОМ УПОТРЕБУ СТЕРИЛАН
- МЕЗОТЕРАПИЈА КОСЕ
- ПРП ЛИЦЕ - ВРАТ - ДЕКОЛЕТЕ И ТЕЛО
- Произведено у КОРЕ-у



*Doz Ayarı Yapılabilir*





**INSTATBEAUTY** in minutes  
**NEEDLE-FREE MESOTHERAPY**  
MINI VANADIUM TITANIUM MESOTHERAPY GUN FOR MOISTURIZING

INSTATBEAUTY mezoterapi tabancası intradermal uygulamalar için geliştirilmiştir. Mezoterapi işlemlerinin güvenli, garantili ve konforlu uygulanmasına olanak sağlar.

Hava kompresörüyle çalışan mezoterapi tabancası **INSTATBEAUTY MESOGUN**; enjeksiyon derinliği, enjeksiyon modu ve her noktaya bırakılacak ürün miktarı için bar basıncının ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Dakikada seri 500 atış özelliği sayesinde oldukça hızlı enjeksiyona olanak verir. Manuel uygulamalarda yaşanan ağrı, acı riskini ortadan kaldırır.

Tek kullanımlık iğne kiti ile kullanılan **INSTATBEAUTY MESOGUN**; ürün kaybını engeller. Kontrollü, rahat uygulama özelliği sayesinde hasta konforunu da sağlar.

## МЕЗОТЕРАПИЈСК И ПИШТОЉ ДИГИТАЛ

### МЗТРП.02-ИНСТАДБЕАУТИ

- ДИГИТАЛНА ПОДЕШИВА ГЛАВА
- СТЕРИЛНО ПАКОВАЊЕ СИЈЕКТОР ЗА ЈЕДНУ УПОТРЕБУ И ВРХ ИГЛИЦА
- МЕЗОТЕРАПИЈА КОСЕ
- ПРП ЛИЦЕ - ВРАТ - ДЕКОЛЕТЕ И ТЕЛО
- Произведено у КОРЕ-у



### DERİN TEMAS

Teknolojik Yapısı ile en derine temas ve ikmal imkanı.



Yaşlanma ile birlikte başlayan çizgi ve kırışıklıklar üzerinde etkin uygulama ve Anti-Aging Seansları

### KIRISIKLIK UYGULAMALARI




### GÖZENEK KÜÇÜLTME

Gözenek uygulamalarında ve yağlı ve yağlıya dönük cilt tiplerinde etkin sonuçları



Güneş Lekeleri  
Cilt Lekeleri  
Akne Lekeleri  
Çil ve Yarık İzleri  
Gibi leke sorunları ve cilt renk/ton dengesizlikleri için uygulamalar.

### RENK/TON DENGESİZLİKLERİ CİLT LEKELERİ

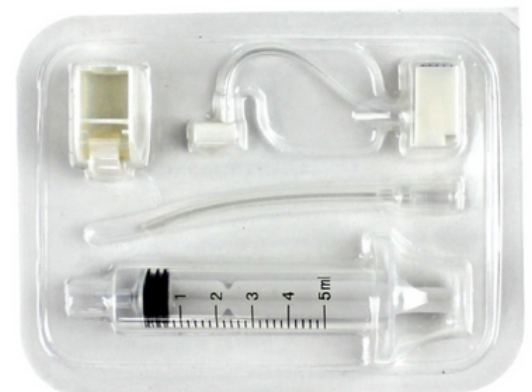



## Центрифуга 6 Еиес

КОД: СНТРФ.06

- 30 МИНУТА ТИМЕД
- 4000 РПМ
- ПЛАСТИЦ АКС
- ВАКУУМ НОГА против тресања
- ТИХ РАД
- КОМПАТИБИЛАН СА А.С.М И ПРП
- 6 ГЗОЛУДУР

Димензије кутије: 35 к 35 к 35  
цм 4 кг

## Елецтромаг 8 Еиес

ШИФРА: СНТРФЈ-  
Е.М.08

- Özel platform üzerine oturtulan bakım gerektirmeyen induksiyon motor sessiz ve titreşimsiz çalışır.
- Çalışırken kapağın açılmasını önleyen özel kilit sistemi vardır. Kapak kapatılmadan cihaz çalıştırılmaz.
- Kısa süreli çalışmalar için pulse seçeneği bulunmaktadır. Cihazlar Hız veya Savurma gücü girilerek çalıştırılabilir.
- Ayrıca kullanıcı tarafından istenilen çalışma anında savurma gücü (RCF) veya hız dönüşümü yapılarak ekranda gösterilir

- Tüpleri taşıyan 35° sabit açılı rotorlar polikarbonat malzemeden yapılmıştır.
- Ağırlı başlıklı santrifüjlerde rotor malzemesi elektrostatik fırın boyalı alüminyumdur.
- Tüp yuvaları değiştirilerek çeşitli tüp hacimlerine uygun çalışma sağlanır.
- Medikal santrifüj cihazlarının dış gövdeleri çelik sacdan imal edilmiştir ve fırın boya ile kaplanmıştır.
- Cihazlar akım emniyet sigortası ile koruma altına alınmıştır.



Ağırlık : 9 KG



Dijital Kontrol Paneli

- 0-99 dakika Arasında Ayarlanabilen Mekanik Zaman Ayarı
- Dijital Hız Kontrolü




8x 15ml Tüp Kapasiteli

Teknik özellikleri:

Tüp Kapasitesi	8x15ml
Rotor Tipi	Düşeyle 35° sabit açılı rotor
Hız Kontrolü	PID Dijital Mikroprosesör kontrol
Kontrol Paneli	Hız,RCF ve Zaman Kontrolü
Max. Dönme Hızı	5000 rpm
Max. Savurma Gücü (RCF x g)	2515xg
Hız Ayarlama Adımı	10rpm
Hız Ayarlama Aralığı	500-5000rpm
Zaman Başlangıcı	Ayarlanan Hıza Ulaştığında
Zaman Aralığı	1-99 dk
Sürekli Çalışma Modu	Var
Savurma Gücü Girilerek Çalışma	Var
Kısa Süreli Çalışma	Pulse Tuşuyla
Program Sayısı	10
Sigorta	1 Amper
Toplam Güç	100 W
Emniyet Sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak Kilidi	Var
Harici Hız Okuma	Var
Döner Başlık Malzemesi	Polikarbonat
Tüp yuvası (gode) malzemesi	ABS (sert plastik)
Dış Gövde Malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
Besleme	AC 190-240V / 50-60 Hz
Dış Ölçüler (g x y x d)	29x25x36 cm
Net Ağırlık	9 kg
Paketli Ağırlık	10 kg


## ПРП ГЕЛ ТУБЕ ПАКОВАЊЕ 50 КОМ



**КОД: ПРП.Т-Ј.50**

САДРЖИ 50 МЕДИЦИНСКИХ  
10 МЛ ГЕЛ ПРП ПРИПРЕМА  
ТУБЕ

КРВ УЗЕТА ОД ПАЦИЈЕНТА  
ПРЕНОСИ СЕ У СПЕЦИЈАЛНУ  
ВАКУУМ ТУБУ СА ГЕЛОМ И  
КОРИСТИ СЕ НАКОН  
ЦЕНТРИФУГИРАЊА У  
ЦЕНТРИФУЖНОМ УРЕЂАЈУ

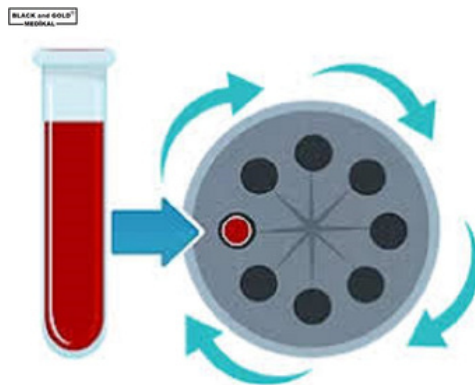


## ПРП ЦИТРОВАНЕ ТУБЕ ПАКОВАЊЕ 50 КОМАДА ПРП.Т-С.50

САДРЖИ 50 МЕДИЦИНСКИХ 10  
МЛ ЦИТРОВАНА ТУБА ЗА ПРП  
ПРИПРЕМУ

КРВ УЗЕТА ОД ПАЦИЈЕНТА  
ПРЕНОСИ СЕ У СПЕЦИЈАЛНУ  
ВАКУУМ ТУБУ СА ГЕЛОМ И  
КОРИСТИ СЕ НАКОН  
ЦЕНТРИФУГИРАЊА У  
ЦЕНТРИФУЖНОМ УРЕЂАЈУ

### BLOOD STRUCTURE

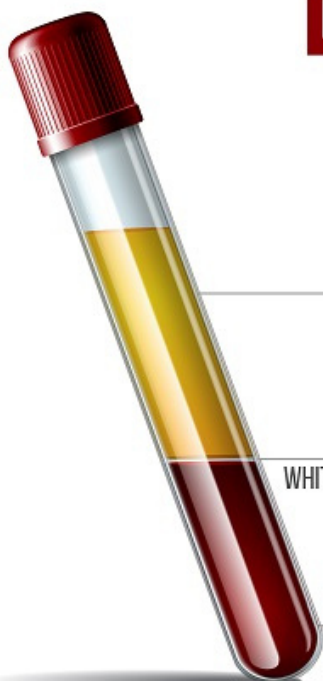

PLASMA



WHITE BLOOD CELLS AND PLATELETS



RED BLOOD CELLS





## ДЕРМОРОЛЛЕР ЕР

КОД: ДРМРЛ-500.01

- ТРЕТМАНИ ЗА КОСУ
- МЕЗОТЕРАПИЈА КОСЕ
- МЕЗОТЕРАПИЈА ЛИЦА
- АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ЊЕГУ КОСЕ
- АПЛИКАЦИЈЕ ЗА НЕГУ ЛИЦА
- АПЛИКАЦИЈЕ ЗА НЕГУ КОЖЕ
- СТЕРИЛНИ ПАКЕТ ПЕРСОНАЛИЗОВАНО
- 500 ТИТАНИЈУМСКИХ ИГЛА
- УЛОГЕ НАПРЕДОВАЊЕ ПРЕЦИЗНОСТ



## ПРАЗНА СТЕРИЛНА БОЦА СА КАПАЦОМ

### ДРМРЛ-300.02

#### Опис производа

Садржај сета: Хидра ваљак, течност за чишћење Дермароллер-а, средство за дезинфекцију коже, турско упутство за употребу Хидра ваљак: То је алат за микро-игле са 64 титанијумске игле на глави ваљка.

Састоји се од 3 главна дела: главе, цеви и поклопца. Захваљујући заштитном поклопцу, игле се чувају без оштећења.

Стимулише механизам зарастања рана и обезбеђује производњу синтезе колагена без оштећења коже. Олакшава апсорпцију активних састојака испод коже захваљујући микро каналима које отвара у кожи.

Користи се за подочњаке, боре и fine линије, отворене поре, акне и ожиљке, флеке на кожи, губитак косе, стрије при рођењу, целулит и многе друге проблеме.

Поступак се изводи скенирањем подручја апликације у облику звездице (плус-цросс) 6-10 пута.

У зависности од величине игле која се користи, апликација се врши у 1 сесији сваких 2-3 дана.

Хидра ваљак треба очистити са Дермароллер Цлеанинг Флуид-ом пре и после сваке сесије.

#### Димензије игле Хидра Роллер:

0,25 мм - може се користити испод и око очију.

0,50 мм - може се користити на лицу или коси.

1,00 мм - може се користити на делу тела или на коси.

#### Интервали сесија Хидра Роллер:

0,25 мм - Може се применити у 1 сесији свака 2 дана.

0,50 мм - може се применити у 1 сесији у 3 дана.

1,00 мм - може се применити у 1 сесији за 5 дана.



ПРАЗНА БОЦА ОД ЛЕКОВА

64 ТИТАНИЈУМСКИ ПОКЛОПАЦ ЗА ИГЛИЧАН ВАЉАК

ЗАШТИТНИ ПОКЛОПАЦ





## ТРАНСПЛАНТАЦИЈА КОСЕ и МЕДИЦИНСКА ЕСТЕТСКА СТОЛИЦА

- ЛУКС СЕРИЈА ОПЕРАТИВНА СТОЛИЦА СА 3 МОТОРА
- ЛАСЕРСКО СЕЧЕНА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
- НЕ ТРРЕСЕ
- 32 ДЕНСИТИ СПЕЦИЈАЛНА СЕРИЈА ФОАМ ЦОМФОРТ
- АСАН ВИВА СЕРИЈА ВИНЛЕКС КОЖНА ОБЛОГА
- ПЕРФОРИРАНА ГЛАВА (И ЗАТВОРНИ ЈАСТУК)
- Антибактеријски је
- БОЈА ЈЕ ОПЦИОНАЛНА

НАПОМЕНА: Опционо се праве столице и радна колица исте боје Екперт Процес.

ДИМЕНЗИЈЕ: 185 Кс 61 Кс 60 ЦМ НЕТО: 35 КГ





## ОРТХОПЕДИЦ СТРУЧНА ОПЕРАЦИЈА СТОЛИЦА

КОД: ТБР.01

- Процедура Ортопедска столица са наслоном за леђа
  - Има амортизере и диже се и спушта.
  - Има хромиране ноге
  - Доступан је систем кочионих точкова
  - Има наслон за леђа
  - Погодан за дуготрајну употребу, ергономски
  - Ергономски је за употребу
  - Доступне опције боја.
- ДИМЕНЗИЈЕ: 40 Кс 40 Кс 50 ЦМ НЕТО: 9

КГ





### ПОСТУПАК СТОЛИЦА СА НАСЛОНОМ

**КОД: ТБР.02**

- Процедура Ортопедска столица са наслоном за леђа
- Има амортизере и диже се и спушта.
- Има хромиране ноге
- Доступан је систем кочионих точкава
- Има наслон за леђа
- Погодан је за дуготрајну употребу,
- Ергономски је за употребу
- Доступне опције боја.

ДИМЕНЗИЈЕ: 35 Кс 40 Кс 40 ЦМ

**НЕТО: 8 КГ**

### ИФ СТООЛ СЕРИЈА

**КОД: ТБР.03**

- Процедура Стоол Ортопедски
- Има амортизере и диже се и спушта.
- Има хромиране ноге
- Доступан је систем кочионих точкава
- Има наслон за леђа
- Погодан је за дуготрајну употребу,
- **ТО ЈЕ СВОЈИМ ОБЛИКОМ ПЕРСОНАЛИЗОВАНА** Серија, хвата за бокове и отклања осећај умора и поспаности.
- Опција боје је **САМО ЦРНА**

ДИМЕНЗИЈЕ: 40 Кс 40 Кс 40 ЦМ НЕТО: 7

КГ



### БАЦКЛЕСС СТООЛ

**КОД: ТБР.04**

- Процедура Стоол Ортопедски
- Има амортизере и диже се и спушта.
- Има хромиране ноге
- Доступан је систем кочионих точкава
- Има наслон за леђа
- Погодан је за дуготрајну употребу,
- **ЈЕ МОДЕЛ БЕЗ ПОВРШИНЕ**
- Опције боја **ДОСТУПНЕ**

ДИМЕНЗИЈЕ: 40 Кс 35 Кс 38 ЦМ МРЕЖА:  
5,5 КГ





### СТОЛИЦА ЗА ВАЂЕЊЕ КРВИ ПРОФЕСИОНАЛНА

КОД: ЕРП.Е-220-Б

- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- антибактеријски подови
- Тренделенбург карактеристика
- Покретни наслон за главу и руке
- Истовремено кретање леђа и стопала
- ручна контрола
- Површина за седење: 60 к 50 цм
- 28 густина 5 цм сиви сунђер
- Димензије: 80 к 175 к 48 цм
- Тежина: 40 кг

### СПЕЦИЈАЛНИ ОРМАЧ ЗА ЛЕКОВЕ ЗАКЉУЧАН

КОД: ЕРП.Е-112

- Кабинет за наркотике
- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- зелене црвене капице
- Дкп иза
- Поклопци који се могу закључати
- Димензије: 18 к 60 к 50 цм
- Тежина: 9 кг



### НОСИЛА ЗА ОДМОР

КОД: ТБР.04

- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- антибактеријски подови
- Кретање главе и стопала са гасним клипом
- ноге мирне
- Дужина софе са затвореним ногама: 145 цм
- Дужина дела главе: 40 цм
- дужина седећег дела: 100 цм
- дужина дела стопала: 40 цм
- Димензије: 56 к 185 к 70 цм
- Тежина: 22 Кг



## МАИО МАСАСИ ХИДРОЛИКЛИ МОДЕЛ

КОД :ММ.Х.01

- 304 квалитетни нерђајући челик
- Три АБС антистатичка точка, два са кочницама
- Подешавање висине хидрауличном педалом
- 360 степени ротирајући горњи сто
- То је медицински производ
- Тежина: 22 Кг Паковано: 25 Кг



## МАЈ РУЧНА ТАБЛА ЗА МАСАЖУ

КОД :ММ.Х.02

- 304 квалитетни нерђајући челик
- Три АБС антистатичка точка, два са кочницама
- Ручно подешавање висине
- 360 степени ротирајући горњи сто
- То је медицински производ
- Тежина: 17 Кг Паковано: 20 Кг

## РЕЧНА МАСАЖА ТИББИ ПРИРУЧНИК

КОД :ММ.Х.03

- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- Три АБС антистатичка точка, два са кочницама
- Горња плоча од нерђајућег челика 304
- Ручно подешавање висине
- Употребна површина унутар

стола: 57к38 цм

ДИМЕНЗИЈЕ: 60Кс40Кс70 ЦМ 18 КГ





## СТОЛ ЗА ПАЦИЈЕНТ

КОД : ЕРП.Е-273.А

- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- Четири АБС антистатичка точка, два са кочницама
- АБС антибактеријска горња плоча
- Покрет са амортизером

Димензије: 40 к 80 к 80-100 цм Тежина: 10 кг



## СТОЛ ЗА ПАЦИЈЕНТ

КОД : ЕРП.Е-273

Антибактеријска електростатичка боја у праху  
АБС антистатик Четири точка,  
два са кочницама Дрвени  
горњи сто Покрет са  
амортизерима Димензије: 40 к  
80 к 80-100 цм Тежина: 10 кг

## ПОСИТИВЕ ЦАБИНЕТ

КОД: ЕРП-271-А

- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- Четири АБС антистатичка точка, два са кочницама
- АБС горња плоча, тело од лима
- Фиока и ормарић

Димензије: 37 к 44 к 80 цм

Тежина: 15 кг





## КОЛИЦА ЗА ОДЕВАЊЕ

**КОД: ЕРП.Е251**

- 1 Антибактеријска електростатичка боја у праху
  - Четири АБС антистатичка точка, два са кочницама
  - метално тело
  - Троммел 29к24 цм, када 40 цм, умиваоник 20 цм
  - потисну ручку
- Димензије: 36 к 87 к 82 цм

Тежина: 10 кг



## МАТЕРИЈАЛИ И ЛЕКОВА КОЛИЦА

**КОД: ЕРП.Е-257**

- Антибактеријска електростатичка прашкаста боја на кућишту од лима
  - Четири АБС антистатичка точка, два са кочницама
  - АБС антибактеријски горњи пулт
  - Држач датотека и корпа за смеће
  - 32 антибактеријске провидне кутије за лекове
  - Две фиоке
  - потисну ручку
- Димензије: 50 к 90 к 110 цм
- Тежина: 47 кг



## КОШИЦА УРЕЂАЈА СА СУСПЕНЗИЈОМ СЕРУМА

**КОД: ЕРП.Е-233А**

- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- Четири АБС антистатичка точка, два са кочницама
- метално тело
- Са фиокама и вјешалицама
- Дубина фиоке: 11 цм
- Димензије: 40 к 50 к 82 цм
- Тежина: 10 кг





### ВАСХ СЕАТ ЛУКСУРИ

КОД: И-КЛТК.01

- ЛУКС СЕРИЈА СЕДИШТА ЗА ПРАЊЕ
- ЕРГОНОМСКА ЈЕ И УДОБНА
- СУДОПЕР + КОМПЛЕТ МЕКСА УКЉУЧЕН
- САМО ПРИКЉУЧАК ЗА ВОДУ И ПРИКЉУЧАК ОДВОДА И ЈЕ СПРЕМАН ЗА ДИРЕКТНУ УПОТРЕБУ.

ВЕЛИЧИНА: 140Кс65Кс65 ЦМ

- 45 КГ



### ВАСХИНГ СЕАТ

КОД: И-КЛТК.02

- ПРАЊЕ СЕДИШТА СТАНДАРД
- ЕРГОНОМСКА ЈЕ И УДОБНА
- СУДОПЕР + КОМПЛЕТ МЕКСА УКЉУЧЕН
- САМО ПРИКЉУЧАК ЗА ВОДУ И ПРИКЉУЧАК ОДВОДА И ЈЕ СПРЕМАН ЗА ДИРЕКТНУ УПОТРЕБУ.



### СТОЛИЦА ЗА ПРАЊЕ ПРЕНОСНА

КОД: И-КЛТК.03

- СТОЛИЦА ЗА ПРАЊЕ ПРЕНОСНА
- ЦРЕВО ЗА ОДВОД ВОДЕ СЕ БАЦИ У ОДВОД ИЛИ СУДОПЕР
- У КУПАТИЛУ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋОЈ ПРОСТОРИ, ЦРЕВО ЗА ОТПАД МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНОСИ И У КОРТУ ИЛИ СЛИЧАН ПРОСТОР.
- МОЖЕ ДА СЕ НОСИ И КОРИСТИ БИЛО ГДЕ КАО ПРЕНОСНИ

ВЕЛИЧИНА: 100-160 ЦМ 20 КГ







### З ОПЕРАЦИЈСКИ СТО СА ФОКАЛИЦАМА

ШИФРА: 3.СХП-01

- Табела за обраду 3 Модел фиоке
- Димензије: 40 к 65 к 71 цм
- Тежина: 15 кг
- 2 полице и фиоке
- То је медицински модел на точковима.
- ТОЧАК СА КОЧНИЦОМ
- МЕДИЦИНСКА ЕЛОКСИРАНА СТАТИЧКА БОЈА у праху

### ОПЕРАЦИЈСКА ТАБЛИЦА 3 МОДЕЛ СА 2 ПОЛИЦЕ

ШИФРА: 3.СХП-02

- Операција Станд 3 Модел
- Димензије: 40 к 65 к 71 цм
- Тежина: 12 кг
- 2 полице
- То је медицински модел на точковима.
- ТОЧАК СА КОЧНИЦОМ
- МЕДИЦИНСКА ЕЛОКСИРАНА СТАТИЧКА БОЈА у праху



### ОПЕРАЦИЈСКА ТАБЛИЦА 3 МОДЕЛ СА 3 ПОЛИЦЕ

ШИФРА: 3.СХП-03

- Операција Станд 3 Модел
- Димензије: 40 к 65 к 71 цм
- Тежина: 12 кг
- 2 полице
- То је медицински модел на точковима.
- ТОЧАК СА КОЧНИЦОМ
- МЕДИЦИНСКА ЕЛОКСИРАНА СТАТИЧКА БОЈА у праху





### СЕРУМ АСКИСИ АХТАПОТ АИАКЛИ

**КОД: ЕРП.Е288**

- Антибактеријска електростатичка сребрна боја у праху
- Пет АБС антистатичких точкава, два са кочницама
- Одељак за вешање никловани са четири куке
- са ногама од ливеног гвожђа

Величина: 60 к 60 к 130-220 цм  
Тежина: 9 кг

### СЕРУМ АСКИСИ СТАНДАРД МОДЕЛ

**КОД: ЕРП.Е287**

- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- Четири АБС антистатичка точка, два са кочницама
- Одељак за вешање никловани

Величина: 50 к 50 к 105-187 цм  
Тежина: 3 кг



### ИВ ПОСЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВИШЕ МОДЕЛ

**КОД: ЕРП.Е-289.Б**

- Тело од нерђајућег челика квалитета 304
- Пет АБС антистатичких точкава, два са кочницама
- Четири вешалице
- Погодност за ношење инфузионе пумпе
- Никлована пет стопа

Димензије: 60 к 60 к 115-210 цм

Тежина: 6 кг



### Hastabaşı Monitör Şehpası ZRV-097

- Krom Nikel Kaplama Gövde
- Alüminyum Cihaz Sabitleme Tablası
- Paslanmaz Aksesuar Sepeti
- 2'si Frenli 4 Tekerlek



### УРЕЂАЈ МОНИТОР КОЛИЦА МЕДИЦАЛ

КОД: Ц.АРБ-01

- Преносно постоље за монитор
  - Тело са хромираним никлом
  - Алуминијумски сто за причвршћивање уређаја
  - Корпа за прибор од нерђајућег челика
  - 4 точка, 2 са кочницама
- ДИМЕНЗИЈЕ: 140 Кс 50 Кс 40 10 КГ

### ПРОФЕСИОНАЛНИ МОДЕЛ СТАНИЦА ЗА УРЕЂАЈ

КОД: Ц.АРБ-02

- ПРООФТИОНАЛ СЕРИЕС КОЛИЦА ЗА РУКОВАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ УРЕЂАЈИМА
- Антибактеријска електростатичка боја у праху
- Четири АБС антистатичка точка, два са кочницама
- ДЕО ЗА УПОТРЕБУ 3-Спрата
- КАИДИРМАЗ ТАБЛАЛАР
- **3-НАПАЈНА ЕЛЕКТРИЧНА Утичница НА УРЕЂАЈУ**
- ПОВУЧНА РУЧКА



Димензије: 80 к 40 к 40 Тежина: 8 кг



### УРЕЂАЈ КОЛИЦА МОДЕЛ ИНОКС ФОЛИЦА

КОД: Ц.АРБ-03

- Нерђајући челик
  - Тело са хромираним никлом
  - 2 полице + фиоке
  - 4 точка, 2 са кочницама
  - Серија медицинских операционих сала
- ДИМЕНЗИЈЕ: 60 Кс 50 Кс 65 28 КГ



**ЕТУВ  
СТЕРИЛИЗАТОР 50  
ЛИТАР**

**КОД: ЕТВ.50**

- Уређај за стерилизацију Суви ваздух 50ЛТ Дигитал
- Термостат: 20Ц - 250Ц
- Осетљивост: + 2%
- Отпор: 600 В + Унутрашња запремина: 50ЛТ
- Унутрашње димензије:
- Ширина: 40 цм - Висина: 40 цм
- Дубина: 32 цм

Има вишенаменску употребу

Може се користити у клиникама за трансплантацију косе, стоматолозима и мањим хируршким операцијама.

**СТЕРИЛИЗАТОР за  
пећницу 10 Л**

**КОД: ЕТВ.10**

- Уређај за стерилизацију Суви ваздух 10 ЛТ Дигитал
- Термостат: 20Ц - 250Ц
- Осетљивост: + 2%
- Отпор: 600 В + Унутрашња запремина: 50ЛТ
- Унутрашње димензије:
- Ширина: 30 цм - Висина: 30 цм
- Дубина: 24 цм

Има вишенаменску употребу


Може се користити у клиникама за трансплантацију косе, стоматолозима и мањим хируршким операцијама.



**СТЕРИЛНИ УРЕЂАЈ  
ЗА ЗАТВАРАЊЕ  
ПАКОВА**

**КОД: ПК.01**

- Технички подаци уређаја за затварање за сечење ролне за стерилизацију:
- - 230 В / 50 Хз напон
- - Снага 500В
- - Максимална ширина затварања 250 мм
- - Ширина вара 12 мм

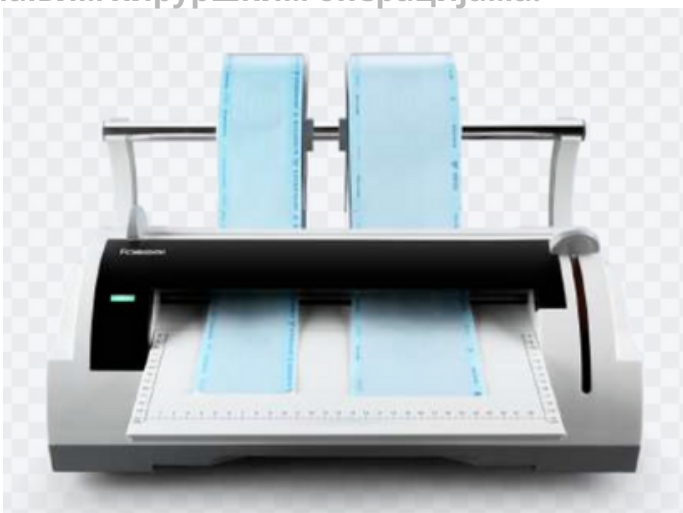



## УРЕЂАЈ ЗА УЛТРАЗВУЧНО УНИШТАВАЊЕ 8 КОД: УЛТРСНЦ-8

- Дигитални ултразвучни чистач
- Жичана корпа од 8 Л са славином за испуштање
- Различити начини коришћења + рад са ниским нивоом буке
- Лако чишћење
- ИМА КАЗНУ И ПРУЖА ЛАКО ИСПУШТАЊЕ.
- Уређај за ултразвучно чишћење стерилизације
- Очистите све своје производе ултразвучним вибрационим таласима.

Прањем га можете заштитити од корозије и хабања и обезбедити детаљно чишћење.

## ДИГИТАЛНИ УЛТРАЗВУЧНИ УРЕЂАЈ ЗА УНИШТАВАЊЕ 700 Мл



### ТЕХНИК ÖZELLİKLER

Аçıklaması	Dijital Ultrasonik Temizleyici
Modeli:	CD-7940
Tank Kapasitesi	750 ml ±10% / 0.79 qt (ABD) Maks. 600 ml ±10% / 0.63 qt (ABD)
Tank Boyutları	14.9x12.7x4.6 cm / 5.9"x5.0"x1.8"
Güç Kaynağı	CD-7940: AC100V~ 50/60Hz, 26W AC100-120V~ 60Hz, 35W AC220-240V~ 50Hz, 50W
Dijital Zamanlayıcı Ayarları	(3dk) (5dk) (8dk) (1.5dk) (10dk) →180s → 300s → 480s → 90s → 600s
Ultrasonik Frekansı	CD-7940: 42 KHz ±10%
Tank Malzemesi	Paslanmaz Çelik SUS304
Gövde Malzemesi	ABS
Güç Kablo Uzunluğu (Yaklaşık)	1.5 m
Net Ağırlık	1.1 kg / 2.4 lb
Brüt Ağırlık	1.5 kg / 3.3 lb
Cihaz Boyutları	19.5x19.5x17.8 cm / 7.7"x7.7"x7.0"
İç Karton Boyutları	24.2x24.2x21.2 cm / 9.5"x9.5"x8.3"
Master Karton Başına Miktar	6 adet/karton
Master Karton Boyutları	75.0x26.0x45.0 cm/29.5"x10.2"x17.7"
Aksesuarlar	1 adet plastik sepet, 1 adet saat standı, 1 adet CD standı

### КОД: УЛТРСНЦ-700



## СТЕРИЛИЗАЦИЈА ФОРМАЛДЕХИД ТАБЛЕТЕ 800 КОМ

### КОД: ФРМ.800



- Представљен је у 800 пластичних штитника.
- Процедуре стерилизације и дезинфекције морају да спроводе овлашћена лица.
- Користи се у складу са процедуром и упутствима.
- Таблете формалдехида у затвореним херметичким кутијама
- Алати мале величине могу се направити бацањем неколико комада.
- Користи се у стерилизацији.
- Назив производа: Формалдехид 800 таблета
- Димензије: 24 к 15 к 14 цм 1 кг
- Карактеристике: Таблет спреман за употребу у закључаној пластичној кутији



### ДРУМ МЕДИЦИНЕ

КОД: ТРМ.24

- 24 ЛУКЕ МЕДИЦАЛ ДРУМ
- СТЕРИЛНИ ГАСНИ КОМПРЕС
- СТЕРИЛНИ РУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
- СТЕРИЛНЕ КЕСЕ ЗА ГАС
- СТЕРИЛНЕ ВЕНЕ

Осигурава да производи као што су производи остану стерилни. Димензије: 24 к 24 к 24 3 кг

### МЕДИЦИНСКИ КОЛАЦ СА ПОКЛОПКОМ 30 ЛУКА

ШИФРА: Т.Т.К-30

- МЕДИЦИНСКИ ИНОКС
- СТАНДАРДНИ МОДЕЛ У А4 ВЕЛИЧИНИ
- СА ПОКРИВОМ

ВЕЛИЧИНА: 30 Кс 22 Кс 6 цм 0,750 гр



### МЕДИЦИНСКА ПОСУДА 500 Мл

КОД: Т.Т.Т-500

- МЕДИЦИНСКИ ИНОКС
- СОЛУТИОН БОВЛ
- 400 МЛ



**МЕДИЦИНСКА  
ПОСУДА 150 МЛ**

**КОД: Т.Т.К-150**

- МЕДИЦИНСКИ ИНОКС
- СОЛУТИОН БОВЛ
- 150 МЛ

**МЕДИЦИНСКО  
СТАКЛО 150 МЛ**

**КОД: Т.Т.Т-150**


- МЕДИЦИНСКИ ИНОКС
- СОЛУТИОН ГЛАСС
- 150 МЛ




**МЕДИЦИНСКИ БУБРЕГ  
ТАС 500 Мл**

**КОД: ТБТ-500**

- МЕДИЦИНСКИ ИНОКС
- РЕШЕЊЕ + ДЕЛОВИ КАДА 400 МЛ

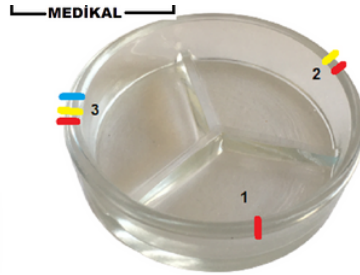

0,3 mm Kalınlık x 100 mm Çap

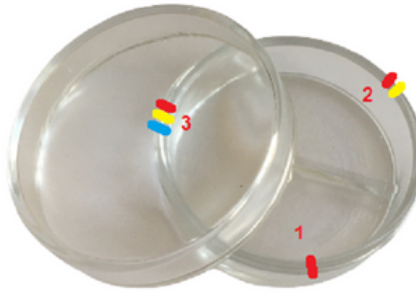

## 3 ПРЕТИКА ГЛАСС ПЕТРИЕ

КОД: Ц.П-3Кс100

- 3 СЕЦИОНС
- КАЛИН ЦАМ
- МОДЕЛ
- ПЕТРИЈСКА ЈЕЛО
- 100 ММ Кс 100 ММ

## ГРАФТ ПЕТРИ ЦООЛЕР 150 ММ


КОД: ПТР.СГТЦ-150



## ЦАМ ПЕТРИ 100-120


ШИФРА: Ц.П-150

- ТИИБИ 150 ММ ЦАМ ПЕТРИ
- ЦОВЕРЕД МОДЕЛ
- 150 Кс 150 МЛ

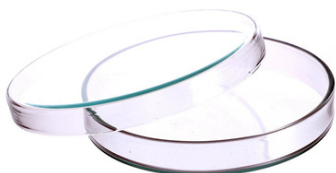


ШИФРА: Ц.П- 120

- ТИИБИ 120 ММ ЦАМ ПЕТРИ
- ЦОВЕРЕД МОДЕЛ
- 120 Кс 120 МЛ

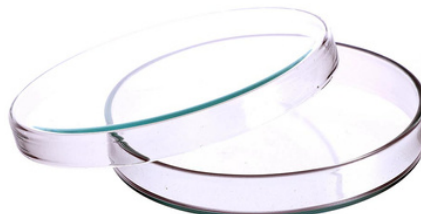

ШИФРА: Ц.П- 100

- ТИИБИ 100 ММ ЦАМ ПЕТРИ
- ЦОВЕРЕД МОДЕЛ
- 100 Кс 100 МЛ

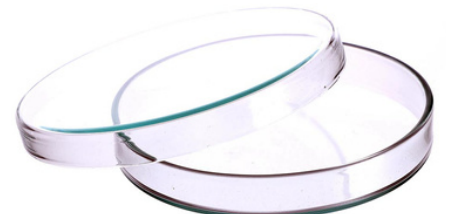





## УВ Ц ПРЕНОСНИ КАСЕТНИ АУТОКЛАВ

### УВЦ - ОТЦЛВ-1


- УВ Ц преносиви касетни аутоклав СТЕРИЛИЗАЦИЈА ЗА САМО 3 МИНУТА
- НУДИ МОГУЋНОСТ ПУЊЕЊА ЧАК И СА ТЕЛЕФОНОМ, ЗАХВАЉУЈУЋИ УНИВЕРЗАЛНОМ АДАПТЕРУ ЗА ПУЊЕЊЕ.
- ОМОГУЋАВА ВАМ ДА ОБЕЗБЕЂИТЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈУ СВИХ ВАШИХ ПРОИЗВОДА СА ПЛАСТИЧНИМ - МЕТАЛНИМ - МИКРО МОТОРИМА - ФУЕ ПУНЦХ - САПФИРСНИМ ОЧИВОМ ИТД. ЗА САМО 3 МИНУТА.
- Преносни аутоклав за пресађивање косе је одобрен ЦЕ / ФДА - РОСХ.
- Ултравиолер таласна дужина: 253,7 Нм
- Воркинг Метход; Компатибилан је са свим пуњачима телефона, а стерилизацију можете да обезбедите и тако што ћете га прикључити директно у утичницу.
- Ефикасан је против свих бактерија и вируса, укључујући серолошке болести (хепатитис А-Б-Ц-ХИВ 9), посебно Цовид. Нуди потпуну и сигурну стерилизацију.
- Ергономија ; Мали је, са електронским зујалом, преносив, може се поставити поред процесора у свакој просторији током процедуре и нуди практичнију употребу.
- Како се користи: Након чишћења (одстрањивањем крви итд.) и сушења, потребно је само да га ставите унутра и притиснете дугме за покретање, на њему су знакови и гласовна упутства.

ВЕЛИЧИНА: 30 Кс 20 Кс 8 ЦМ 350 ГР





SIZE ;  
29 x 20 x 4 cm  
21 x 16 x 4 cm  
20 x 10 x 4 cm  
19 x 8 x 4 cm

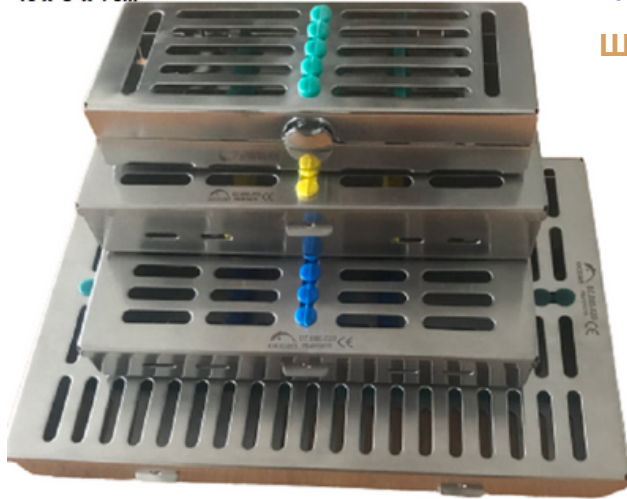

**ВЕЛИКИ : СКСТ-01 СРЕЊИ : СКСТ-02 МАЛИ : СКСТ-03**

**ШИФРА: СКСТ-01 + 02 + 03**



## КАСЕТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ВЕЛИКЕ ВЕЛИЧИНЕ

- МЕДИЦИНСКА СТЕРИЛИЗАЦИЈСКА КАСЕТА
- ВЕЛИКИ ДЕЧАК
- ИМА ПОСЕБАН СИЛИКОНСКИ КРЕВЕТ
- ПОСЕБНО СЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ КОСЕ И ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ



## КАСЕТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ШИФРА: СКСТ-05

- Димензије: 16 Кс 7 Кс 2 цм
  - Операција трансплантације косе
  - Пластична операција Користи се на пољима.
- Касета за стерилизацију је посебна серија.

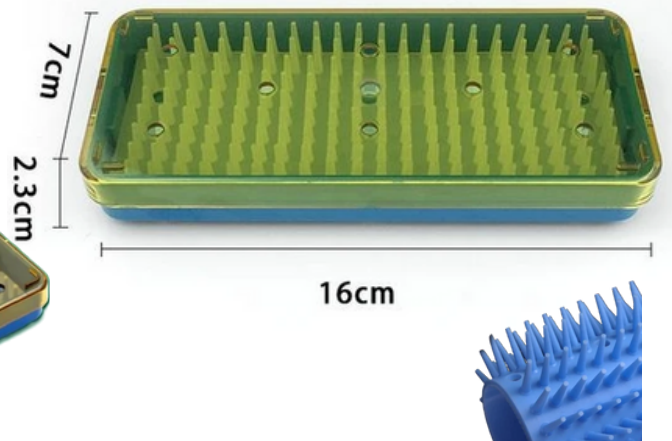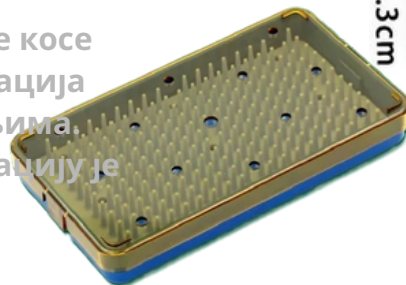

## КАСЕТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ШИФРА: СКСТ-05

- Димензије: 24 Кс 15 Кс 7 цм
  - Операција трансплантације косе
  - Пластична операција Користи се на пољима.
- Касета за стерилизацију је посебна серија.





## МЕДИЦИНСКИ УВЦ СТЕРИЛНИ СОБНИ УРЕЂАЈ 36 КВАДРАТНИХ МЕТАРА ЈЕ ЕФИКАСНО


**КОД: Т.УВЦ-36**

- Медицинска УВ Ц лампа за стерилну собу је ефикасна за 36 квадратних метара.
- У складу са медицинским сертификованим прописима.
  - То је производ спреман за употребу са малим и модерним дизајном.
  - Може се монтирати било где са опремом укљученом у кутију.

## МЕДИЦИНСКИ ЧЕЛИК ЛЕЊИР 30 ЦМ

**КОД: Т.Ц.Ц-30**

- Лењир за мерење и обележавање медицинског челика
- То је медицински челик
- Дужина је 30 цм
- Углови и ивице су овални глатко резани и неће се огревати.
- Може се стерилисати
- То је нерђајући челик.

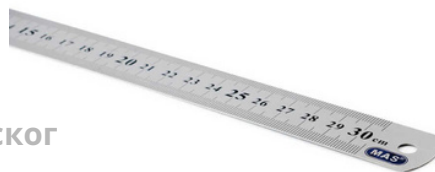

## ЧЕШАЉ ОД МЕДИЦИНСКОГ ЧЕЛИКА Стерилизован

**ШИФРА: Т.Т- 01**



- Челични медицински чешаљ
- Метални чешаљ је модел који се може аутоклавирати и стерилизовати.
- Својом металном структуром обезбеђује дуге године употребе.
- Спречава контаминацију



## ПРСТЕН ЗА САКУПЉАЊЕ ГРАФТ

**КОД: ГРФТ.И-01**

- Графт Ринг Медицал Стеел
- 100% медицински челик
- Величина прстена за прсте је подесива
- Највећи проблем у прикупљању графтова и трансплантацији  
Дизајниран да буде ваш помоћник

## КАШИЦА ЗА САКУПЉАЊЕ КАДЕПА

**КОД: ГРФТ.К-01**

- Графт Споон Медицал Стеел
- 100% медицински челик
- Величина прстена за прсте је подесива
- Највећи проблем у прикупљању графтова и трансплантацији  
Дизајниран да буде ваш помоћник



## МЕДИЦИНСКА МЕТАЛНА БОЦА ЗА СПРЕЈ

**КОД: МССС-300**

- Метална спреј боца 300 мл
- То је метално тело
- Може се стерилисати - аутоклавирати
- То је медицински модел који је у складу са прописима.



## МЕДИЦИНСКА МАШИНА ЗА БРИЈАЊЕ КОЈА СЕ МОЖЕ ПЕРИТИ ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ



**КОД: ТМ.Б-01**

- МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ + КОМПЛЕТНО ПРИВ
- МОЖЕ РАДИТИ У ВОДИ
- ТО ЈЕ БАТЕРИЈА
- ДОСТУПНЕ СУ СВЕ ВЕЛИЧИНЕ И БРОЈЕВИ СЕЧАЊА
- РАДИ МИНИМАЛНО 120 МИНУТА

## МЕДИЦИНСКИ СИЛИКОН ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ГРАФТА КОД: ГРФТ.П-30

- Сет за припрему графта силикон
- Може се стерилисати
- То је производ на коме можете одвојити, пребројати и поделити калемове.



**0,01 mm**  
mm ve inch



**150 mm**



## ДИГИТАЛНИ МЕРНИ АЛАТ

**КОД: ДЈТЛ.КПС-01**

- Дигитални мерни лењир
- То је дигитални мерни инструмент на батерије који се користи за трансплантацију косе и пуњење ботокса или мерења симетрије.



### КИТ ЗА ХИТНУ ПОМОЋ КОД: ЕРП.ЕС514-Б

- Ларингоскоп сет
- Хируршки сет: Пинцете-Форце-Скалпел дршка-Португалске-маказе
- ПВЦ амбу сети
- аутоматска окретница
- интубационе цеви
- Аирваи
- Боца кисеоника од 1 литра и манометар
- Димензије: 33 к 45 к 15 цм
- Тежина: 3 кг

### МЕДИЦИНСКИ СИЛИКОН ЗА ПРИПРЕМАЊЕ

#### КОД: ЕРП.С14-Е

- алуминијумско тело
- Претинци унутра
- Подови од сунђера
- Систем закључавања
- Димензије: 33 к 45 к 15 цм
- Тежина: 2 кг
- Важни документи - Алати - Ваши материјали

Сигурна и заштићена торба за



### АЛАТ ЗА ТРАНСплантацију КОСЕ - ПЕНСЕТ ЗАШТИТНА ВРЕЋА

#### КОД: ПЦ-6

- ДИЗАЈН ЈЕ ЗА ЧУВАЊЕ И НОШЕЊЕ КЛИЈЕСТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ КОСЕ И СЛИЧНИХ ОСЕТЉИВИХ УРЕЂАЈА.
- ИМА 6 ОЧИЈА
- ГЛАТКИ сомот УНУТРА
- ТО ЈЕ ЖЕНСКА КОЖА
- СИСТЕМ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ЗАШТИТА



## ХИРУРГИЈА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ КОСЕ МОНИТОР ПАЦИЕНТ МОНИТОР ПРЕНОСНИ МОДЕЛ



### Шифра: ХСТ-МНТР-П01

- СПО2, ПР, НИБП, мерење телесне температуре: Овај монитор је способен да мери СПО2 (засићење кисеоником), брзину пулса (ПР), крвни притисак (НИБП) и телесну температуру (оЦ), пружајући свеобухватно праћење пацијента.
- Прецизно мерење при ниској перфузији: Може да изврши тачна мерења чак и при ниској перфузији од 0,05%, пружајући поуздане резултате за критичне ситуације.
- Индекс перфузије: Мерење индекса перфузије вам помаже да детаљније пратите статус перфузије (Индекс перфузије се креће од 0,05% до 20%).
- Погодно за екстремне ситуације: Може да изврши тачна мерења чак и у екстремним ситуацијама као што су неонатални пацијенти и шок, што пружа разноврсну употребу.
- Два различита режима мерења: Можете бирати између спонтаног (тренутног) и режима надгледања.
- Складиштење података: Са функцијом складиштења података можете приступити историјским подацима и пратити трендове графикана. Можете да примате 48 сати непрекидних података у режиму надзора.

## СПО 2 ПРОБУ ДИЈИТАЛ

### КОД: СТРП-01

- Пулсни оксиметар Тип прста  
Уређај за мерење кисеоника са прста
- Дигитални прстни оксиметар  
100% ТАЧАН РЕЗУЛТАТ Пулсни оксиметар је уређај који може да мери откуцаје у минути и ниво кисеоника у крви на најлакши и најбржи начин и такође то забележи.





## ЈАСТУК ЗА ВРАТ НА НАДУВАЊЕ

КОД: БИС.10

- ЈАСТУК ЗА ВРАТ НА НАДУВАЊЕ
- ДОСТУПНЕ ОПЦИЈЕ БОЈА
- СОШУШНА СПОЉНА ПОВРШИНА ПРУЖА УДОБНОСТ
- ОВО ЈЕ ВРСТА УДОБНОГ ЈАСТУКА КОЈИ БИ ПАЦИЈЕНТИ ТРЕБАЛО ДА КОРИСТЕ У ПЕРИОДУ НАКОН ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ КОСЕ.

## ТРАКА ЗА ЧЕЛО ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ КОСЕ

КОД: СЕБ.50

- ЕДЕМ НАКОН ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ КОСЕ
- ТО ЈЕ ТРАКА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПУЊЕЊА.
- ПОСЕБНА ЕЛАСТИЧНА СТРУКТУРА НЕ СТИСКА - НЕ ДАЈЕ ОСЕЋАЈ НЕЛАГОДА
- ШИРОКОПОЈАСНА ЈЕ
- ВАСХАБЛЕ



## ШИПКЕ ЗА ПРЕСАЂИВА ЊЕ ДУГЕ КОСЕ

КОД: СЕТ.50

- МЕТАЛ СЕ МОЖЕ СТЕРИЛИЗОВАТИ
- КОРИСТИ СЕ ЗА СТВАРАЊЕ КОМФОРНИЈИХ И КОМФОРНИЈИХ РАДНИХ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ КОСЕ ТОКОМ ПРОЦЕДУРА ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ ДУГЕ КОСЕ.



50

Пиецес





## Ц СИЛИКОНСКА ГЛАВА

**КОД: Ц.СБ.01**

- Користи се у свим операцијама које захтевају подршку за главу.
- Хирургија трансплантације косе (ОРЛ, пластична хирургија, општа хирургија)
- Било је: 22 Кс 8,5 Кс 4,5 цм.
- Направљен је од вискоеластичног полимера.
- Може се поново користити и лако се чисти.
- Водоотпоран је и антистатичан.
- Омогућава особи да сатима лежи у дуготрајним лежећим положајима без узнемиравања или остављања трага током операције трансплантације косе.

## ПУРОН ПОЗИСИОН ЕПЕДИ

**КОД: Ц.СБ.02**

- Обезбеђује унос ваздуха у склоном положају пацијента.
- Било је :28 \* 24 \* 14 цм
- Направљен је од вискоеластичног полимера.
- Може се поново користити и лако се чисти.
- Водоотпоран је и антистатичан.

У положају пурона у операцији трансплантације косе;  
Омогућава вам да останете удобно током дужег временског периода.

Потпуно је ортопедски и не оставља ожиљке.



## СПЕЦИЈАЛНИ СИЛИКОНСКИ ПОДЛОГА ЗА ВРАТ

**КОД: Ц.СБ.03**



- Намењен је за ублажавање притиска, заштиту и подршку током дијагнозе, лечења и хируршких процедура.
- Било је 19 Кс 11 Кс 8 цм.
- Направљен је од вискоеластичног полимера.
- Може се поново користити и лако се чисти.
- Водоотпоран је и антистатичан.
- Користи се као подршка за врат у операцији трансплантације косе.
- Пацијент не осећа нелагодност током дугих процедура, не боли га врат и омогућава му да остане удобно непомичан дуги низ сати.



## ОЛОВКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ЦРТАЊЕ СТЕРИЛНЕ КОЖЕ

**КОД: СЦК-10**

- БОЈА: ТАМНО ПЛАВИ ЦРТЕЖ
- СТЕРИЛНО ЈЕ ПАКОВАНО
- 1 оловка за цртање МЕДИЦИНСКИ МАРКЕР
- ПОСТОЈИ 1 ПОСЕБАН ВЛАДАР.
- НАКОН ОТВАРАЊА МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ДО СТАНКА.
- КОРИСТИ СЕ ЗА ЦРТАЊЕ + ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПИСАЊЕ ТОКОМ ПРОЦЕДУРА ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ КОСЕ.
- КОРИСТИ СЕ И КАО ОЛОВКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ У ЦРТЕЖИМА ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ, ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ И ДЕРМОТОЛОГИЈЕ, ТАКОЂЕ И У ПРОЦЕДУРАМА ТЕТОВИРАЊА.

## ОЛОВКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ЦРТАЊЕ СТЕРИЛНЕ КОЖЕ

**КОД: ЦК-Б.10**

- БОЈА: БЕЛИ ЦРТЕЖ
- 1 оловка за цртање МЕДИЦИНСКИ МАРКЕР
- ПОСТОЈИ 1 ПОСЕБАН ВЛАДАР.
- НАКОН ОТВАРАЊА МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ДО СТАНКА.
- КОРИСТИ СЕ ЗА ЦРТАЊЕ + ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПИСАЊЕ ТОКОМ ПРОЦЕДУРА ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ КОСЕ.
- КОРИСТИ СЕ И КАО ОЛОВКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ У ЦРТЕЖИМА ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ, ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ И ДЕРМОТОЛОГИЈЕ, ТАКОЂЕ И У ПРОЦЕДУРАМА ТЕТОВИРАЊА.



## ОЛОВКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ЦРТАЊЕ СТЕРИЛНЕ КОЖЕ

**КОД: ЦК-С.10**

- БОЈА: ЦРНА ЦРТЕЖ
- 1 оловка за цртање МЕДИЦИНСКИ МАРКЕР
- ПОСТОЈИ 1 ПОСЕБАН ВЛАДАР.
- НАКОН ОТВАРАЊА МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ДО СТАНКА.
- КОРИСТИ СЕ ЗА ЦРТАЊЕ + ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПИСАЊЕ ТОКОМ ПРОЦЕДУРА ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ КОСЕ.
- КОРИСТИ СЕ И КАО ОЛОВКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ У ЦРТЕЖИМА ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ, ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ И ДЕРМОТОЛОГИЈЕ, ТАКОЂЕ И У ПРОЦЕДУРАМА ТЕТОВИРАЊА.



## БАТИК ТИРНАК РОБОТУ

**КОД: БТР-05**


**Како се користи :**

- Пре употребе производа, потопите ноге у топлу воду 15 минута.
- Причврстите два крака алата на ивице вашег ураслог нокта, једну по једну,
- Једном руком причврстите средњи потпорни део алата на нокат и завртите завртањ потпорног дела док се не појави осећај ширења (овај процес ће се обавити у врућој води). Поновите поступак окретања и ширења шрафа 3 пута са интервалом од 10 минута по пола сата, затим извадите ногу из вреле воде и осушите нокте феном.
- Уклоните алат и подуприте исправљене делове тако што ћете испод њих ставити памук.

**Карактеристике :**

То је нерђајући челик. + Не савија се и не увија.

Ширина 2,5 цм / дужина 4 цм



13 X 9 X 3,5 CM

## ИЦЕ БАТЕРИЈА 13 ЦМ


**КОД: БЗАК-13**

- БОЈА: ПЛАВА
- ЛЕДЕНА БАТЕРИЈА (ПУЊЕНА ЈЕ ТЕЧНОЋУ).
- МЕРЕ 13 Кс 9 Кс 3,5 ЦМ
- 110 Гр

## ИЦЕ БАТЕРИЈА 32 ЦМ

**КОД: БЗАК-32**

- БОЈА: ПЛАВА
- ЛЕДЕНА БАТЕРИЈА (ПУЊЕНА ЈЕ ТЕЧНОЋУ).
- ИТ МЕРЕ 32 Кс 30 Кс 1.4
- 1200 Гр

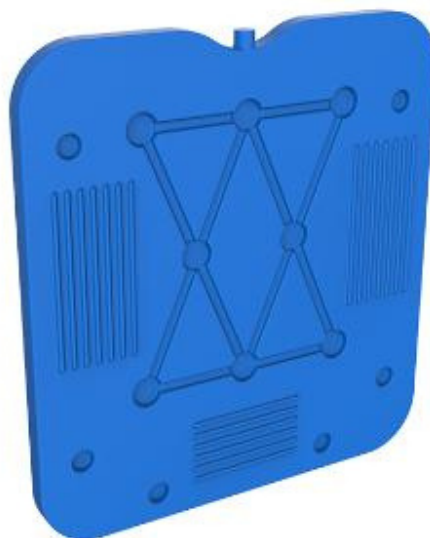



## СПРЕЈ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ МОТОРА

**КОД: МБ-С.500**

### Како се користи :

- СПЕЦИЈАЛНИ ВРХ ГЛАВЕ СПРЕЈ ЈЕ ПРИЛОЖЕН,
- СА КРАЈА МОТОРА ИЛИ ГЛАВЕ;
- 3 ЧЕПА СУ ЗАТЕГНУТА. МОТОР РАДИ 30 СЕКУНДИ НА ПРАЖЕНОМ ходу. ТО ЈЕ СВЕ.
- СПРЕЧАВА ЗАГРЕВАЊЕ МОТОРА
- ИСЕЧИТЕ ЗВУК КОЈИ ЈЕ ИЗ МОТОРА
- ПОДРЖАВА ЗДРАВИЈИ РАД БЕЗ ХОДАЊА
- 500 МЛ



**HC HairCharm**


•Sodium	3-5mEq
•Potassium	3-5mEq
•Magnesium	0,3-0,5mEq
•Calcium	2-4mEq
•Phosphorous	1-2mEq
•Zinc (Çinko)	150-200mg
•Copper	10-20mg
•Iron	1mg
•Vitamin A	233units
•Vitamin C	6mg
•Vitamin D	66units
•Vitamin E	0,66units
•Vitamin B (Thiamine)	0,055mg
•Vitamin B2 (Riboflavine)	0,07mg
•Vitamin B3 (Niacine)	0,9mg
•Vitamin B5 (Pantothenic)	0,3mg
•Vitamin B6 (Pyridoxine)	0,05mg
•Biotine (Vitamin B7)	30mg
•Folic Acid (Vitamin B9)	8mg
•Vitamin B12 (Cyanocobalamine)	0,04mg

**Saçınız için Gerekli Tüm Vitamin ve Mineralleri İçerir**

## МЕЗОТЕРАПИЈА КОСЕ

**КОД: ХЦ.ХЦРМ-6Кс5**

- ХАИРМЕСОТХЕРАПИ
- ИНВАСИВЕ
- МУЛТИВИТАМИН СЕРУМ КОМПЛЕКС

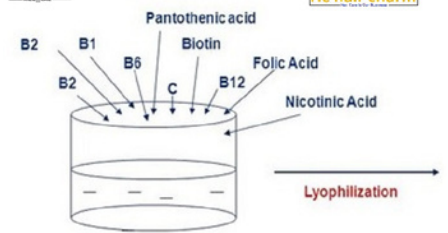

**НАШИ  
ДИСТРИБУТЕРИ**

**Интернационал Хаир Медицал**

**Ако испуњавате неопходне услове за  
Дистрибутерско заступство, заступства ће  
бити додељена другим земљама.**

**Контактирајте за  
детаље!**



**ЕМАИЛ**

инфо@интернационалхаирмедицал.цом

**ТЕЛЕФОН**

+90 539 662 8924 / +90 533 894 8843

**Интернационал Хаир Медицал Реигн Траде. Лтд.  
Сти.**

**ОД: 2020**

*ТО ЈЕ УРЕЂАЈИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ КОСЕ И ПОМОЋНА ОПРЕМА  
ПРОИЗВОДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУТЕР, ДИЛЕР, ВЕЛИКО И  
МАЛОПРОДАЈНИ ЦЕНТАР*

**СЕРТИФИКОВАНО МЕЂУНАРОДНО ОРГАН ЗА  
ПРОДАЈУ**

Пружамо активну испоруку у 61 земљу у свету, искључујући земље у којима имамо дистрибутере. Наше пошиљке се достављају директно на адресу.

Иако се разликује у зависности од земље, наше испоруке авионом се испоручују на адресу у року од 1-4 дана, наше испоруке друмом се достављају на адресу у року од 7-14 дана, наше испоруке морем + копном се достављају на адресу у року од 14-28 дана.

Такође нудимо велику погодност нашим корисницима са многим званичним методама плаћања као што су кредитна картица, плаћање дебитном картицом + плаћање путем везе + банковни трансфер.

Осим у земљама у којима имамо дистрибутере, брза продаја је доступна и преко наше интернет странице.

Сви наши производи имају фактуру и међународну гаранцију.